


MEDVIE

Date du test: 09/09/2024 13:52:50

Durée: 5mn 27s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

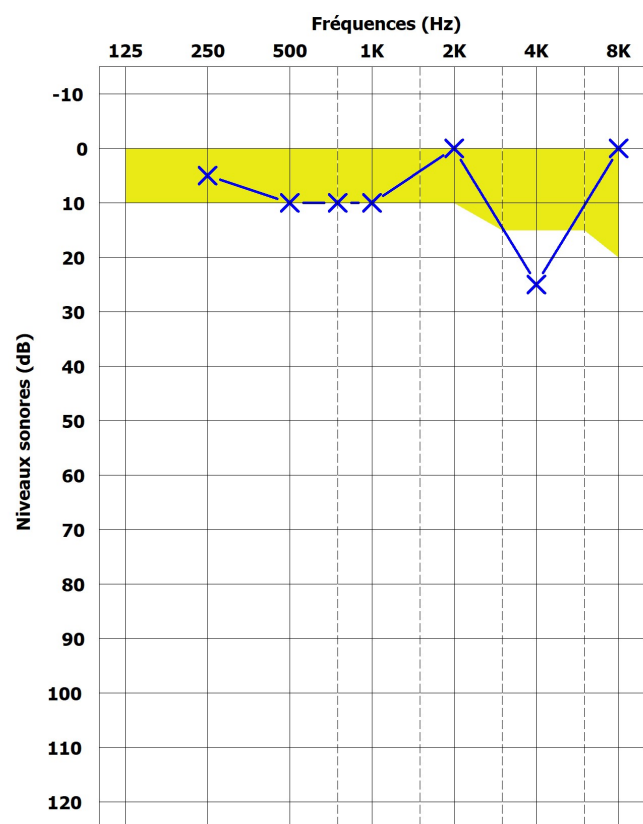

Oreille Gauche

Données Patient	
BAH ZAKARIAOU	
Date de naissance	01/01/1988
Age	36
Société	BETELCOM
ID	24090913503996028

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

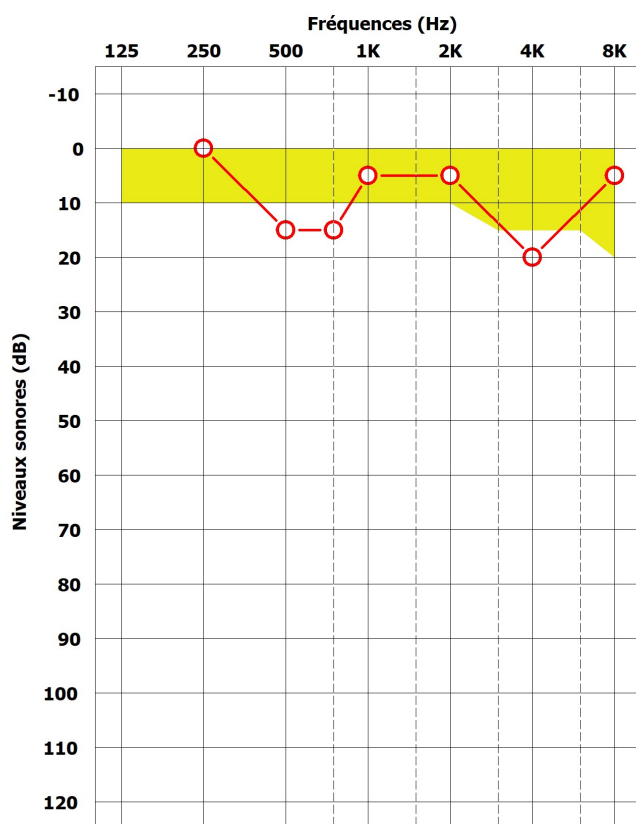

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	10		0		25		0
CA Droit		0	15	15	5		5		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes