


MEDVIE


Date du test: 18/09/2024 13:30:07
Durée: 5mn 21s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA ALHASSANE
Date de naissance	11/12/1993
Age	30
Société	BETELCOM
ID	24091813023946205

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

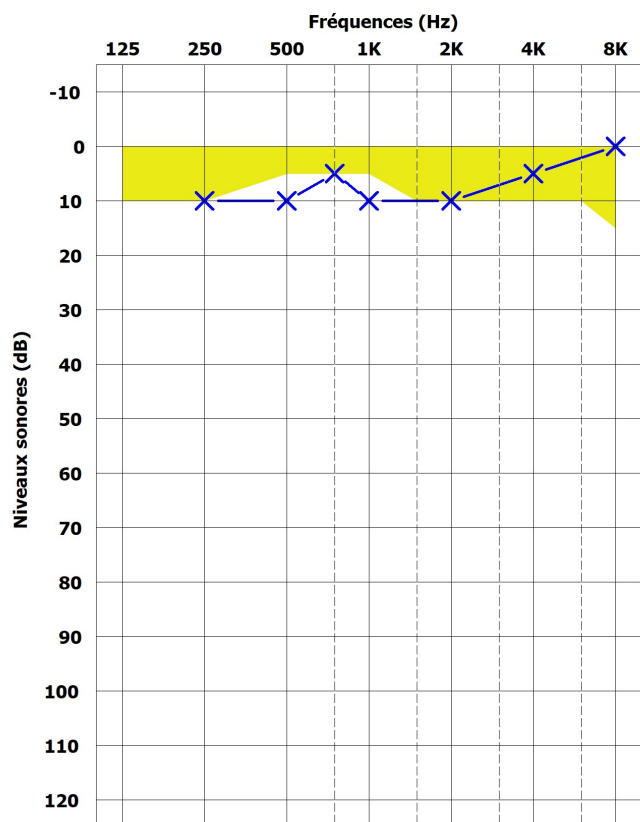

Oreille Gauche

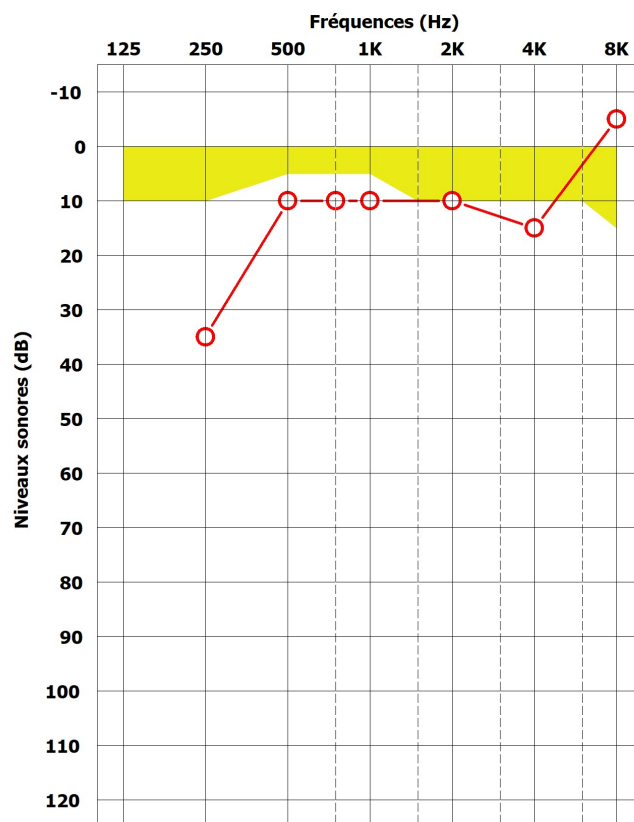

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	5	10		10		5		0
CA Droit		35	10	10	10		10		15		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes