

MEDVIE


Date du test: 30/07/2025 10:08:02

Durée: 4mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONTE YAYA
Date de naissance	10/05/1980	
Age	45	
Société	BETELCOM	
ID	25073009494610750	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

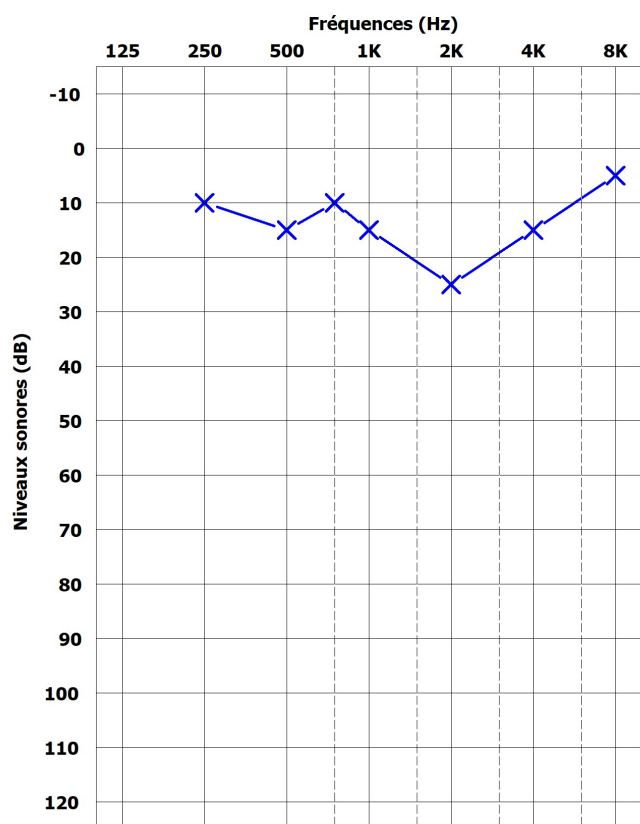

Oreille Gauche

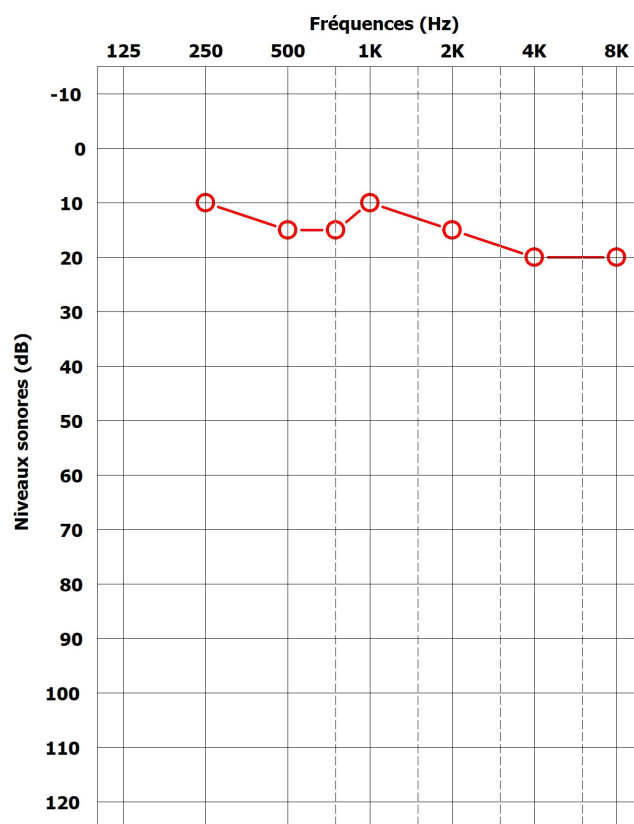

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	15		25		15		5
CA Droit		10	15	15	10		15		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes