


MED VIE


Date du test: 09/09/2024 10:12:37
Durée: 4mn 55s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO ELHADJ YAYA	
Date de naissance	06/04/1988
Age	36
Société	BETELCOM
ID	24090910080447887

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

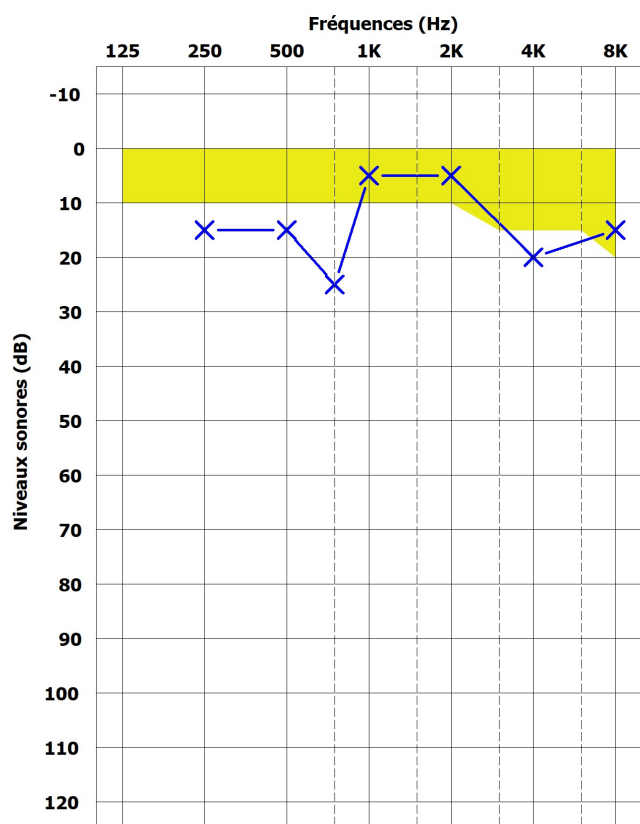

Oreille Gauche

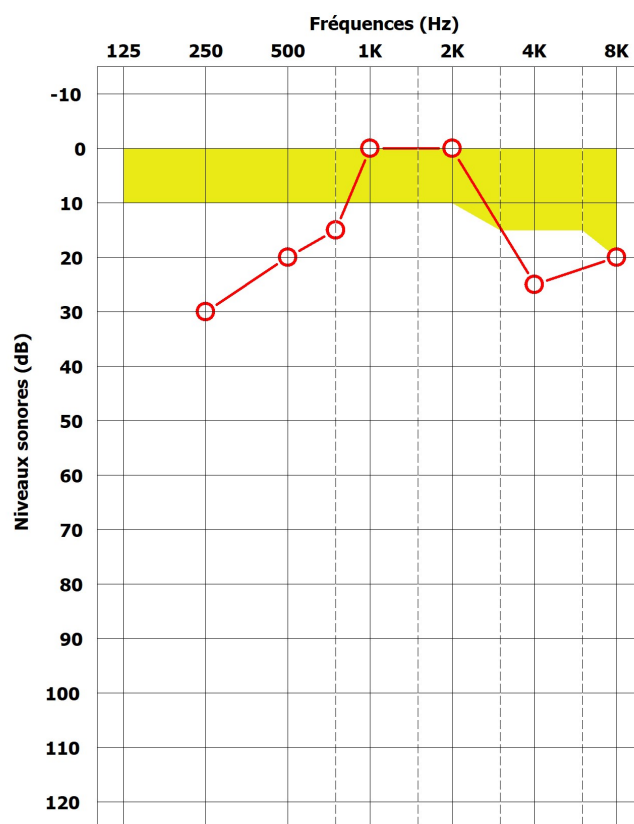

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	25	5		5		20		15
CA Droit		30	20	15	0		0		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes