

MEDVIE


Date du test: 12/09/2024 11:48:08

Durée: 5mn 08s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KEITA AMADOU
Date de naissance	12/09/1986
Age	38
Société	BSSG
ID	24091211404455059

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

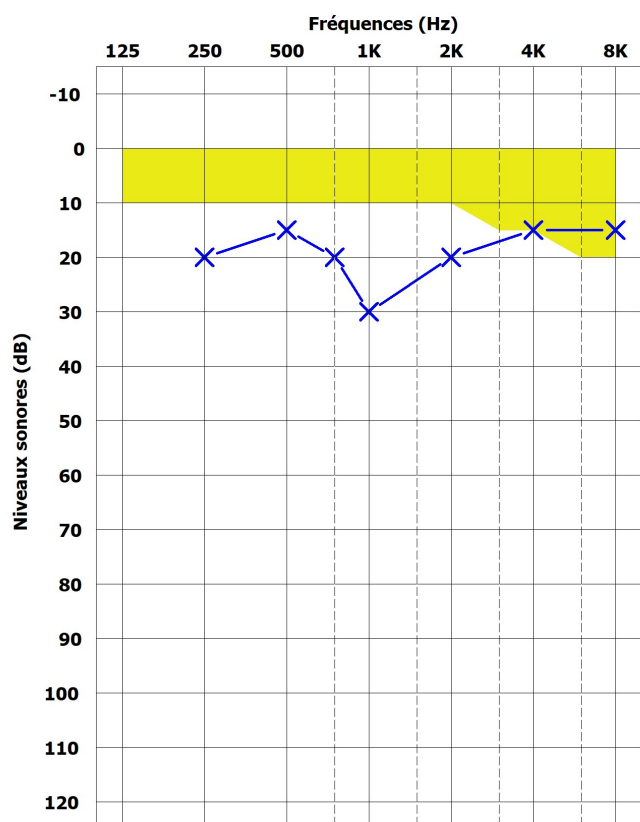

Oreille Gauche

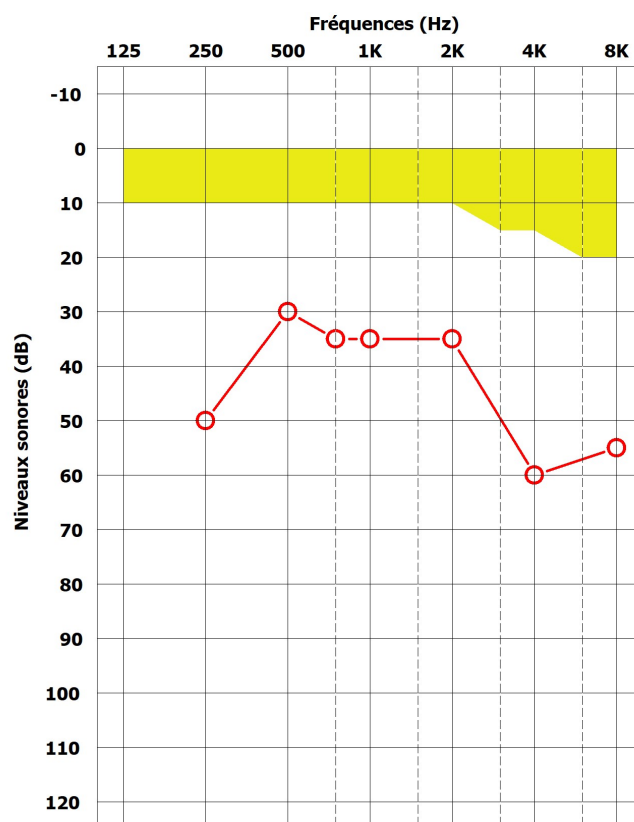

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	20	30		20		15		15
CA Droit		50	30	35	35		35		60		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	40,0 dB	---

Notes