


MEDVIE


Date du test: 17/08/2024 15:34:34

Durée: 3mn 18s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

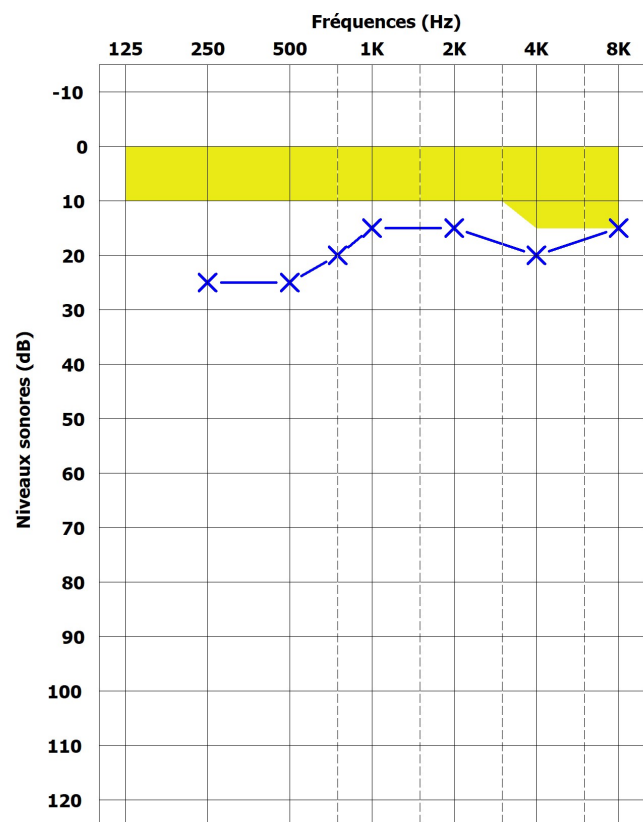

Oreille Gauche

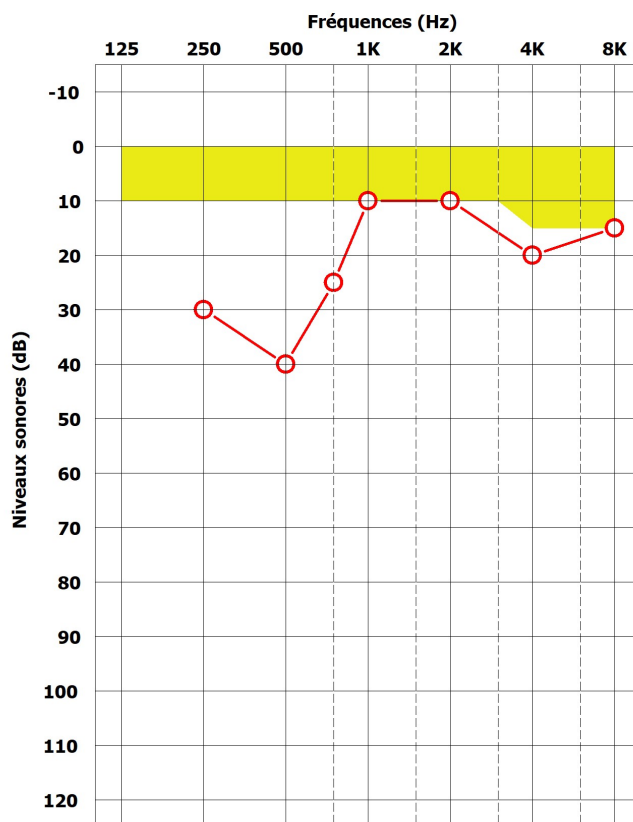

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	20	15		15		20		15
CA Droit		30	40	25	10		10		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient	BANGOURA IBRAHIMA SORRY
Date de naissance	04/02/1991
Age	33
Société	SGMC
ID	24081715321561973

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021