

MEDVIE


Date du test: 08/10/2024 16:13:21

Durée: 5mn 19s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOHAMED
Date de naissance	09/03/1997
Age	27
Société	ALATRACH
ID	24100816065853532

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

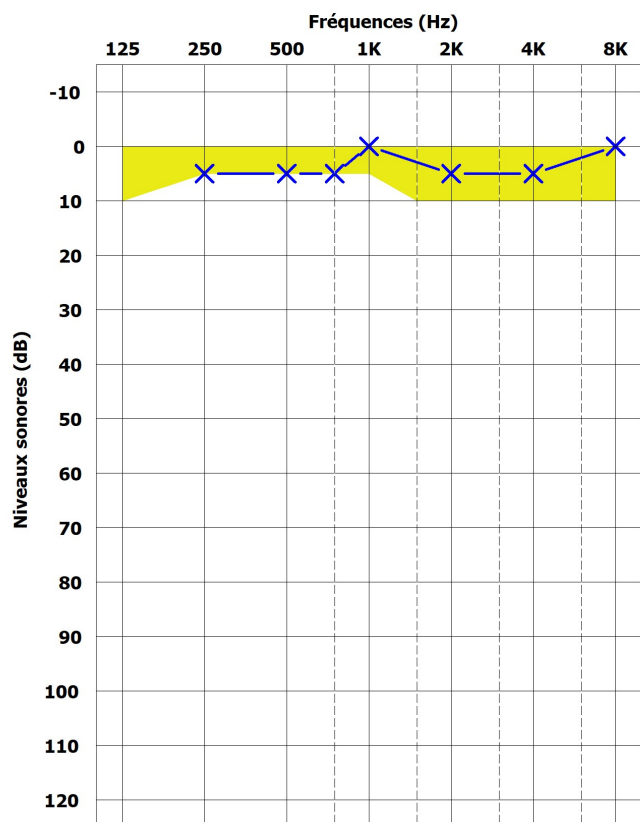

Oreille Gauche

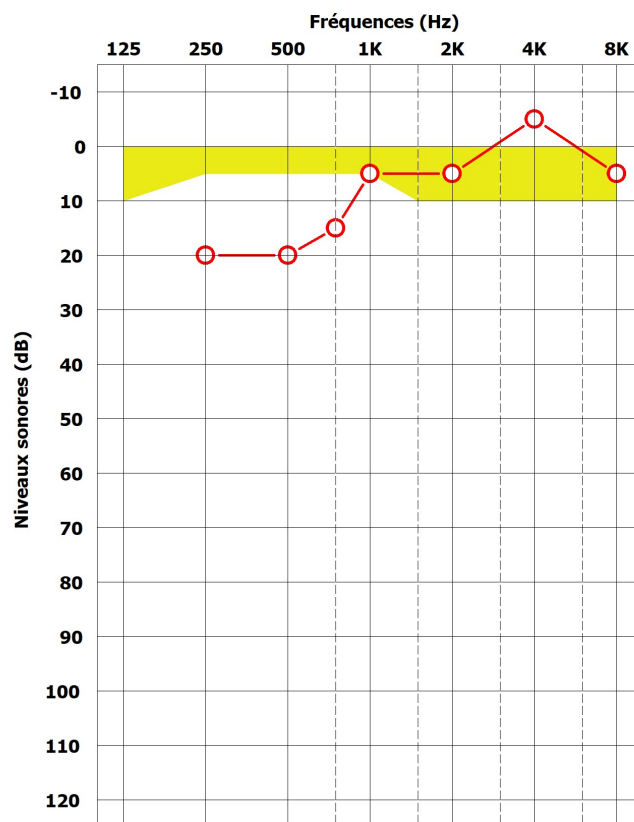

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	5	0		5		5		0
CA Droit		20	20	15	5		5		-5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes