

MEDVIE


Date du test: 26/09/2024 13:34:51

Durée: 4mn 10s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | BLEMOU CHARLE     |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 19/11/1987        |
| Age               | 36                |
| Société           | OLEA GUINEE       |
| ID                | 24092613320596127 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690092 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

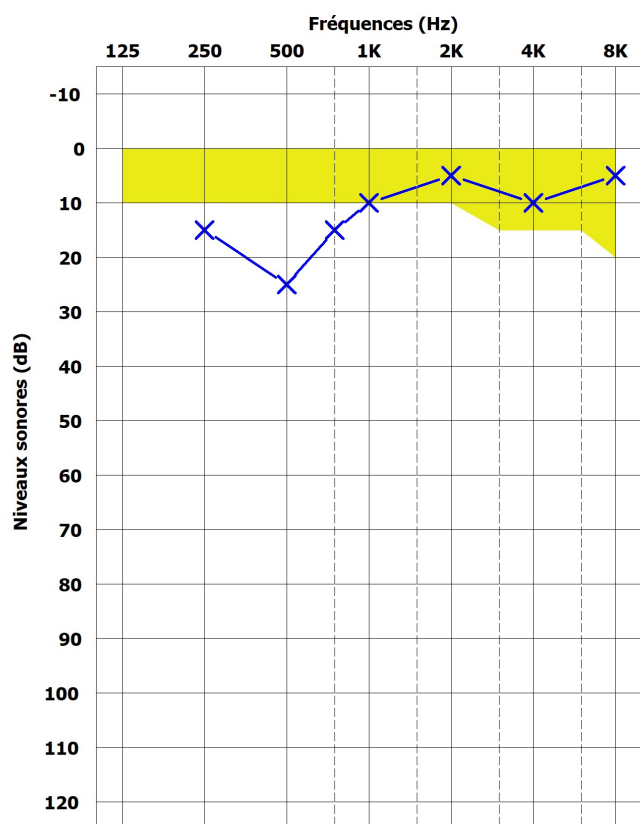

Oreille Gauche

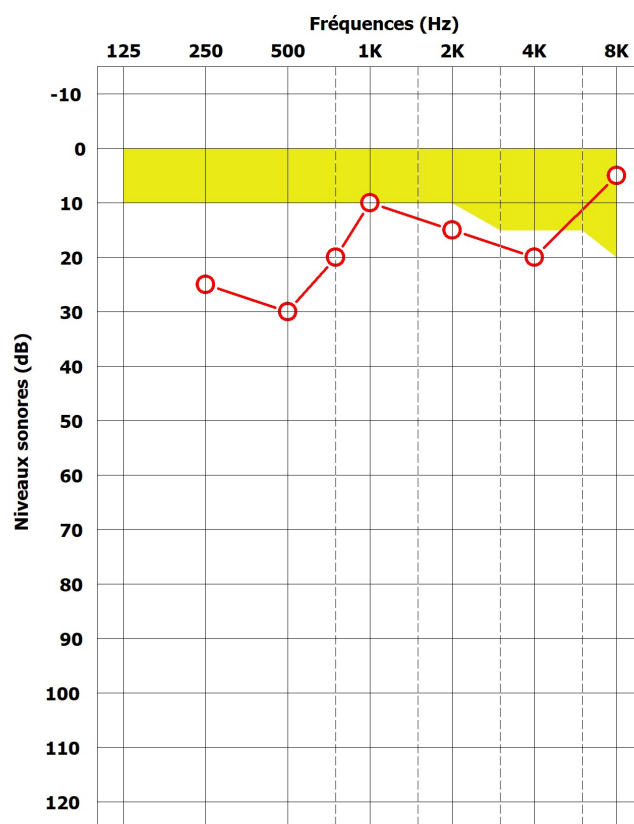

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 25  | 15  | 10 |     | 5  |    | 10 |    | 5  |
| CA Droit  |     | 25  | 30  | 20  | 10 |     | 15 |    | 20 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 12,5 dB | --- |
| CA Droit        | 18,8 dB | --- |

Notes