

MEDVIE


Date du test: 19/03/2025 11:01:49

Durée: 4mn 50s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	HUANG MINGLONG
Date de naissance	07/04/1983
Age	41
Société	CHALIE
ID	25031910593346951

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

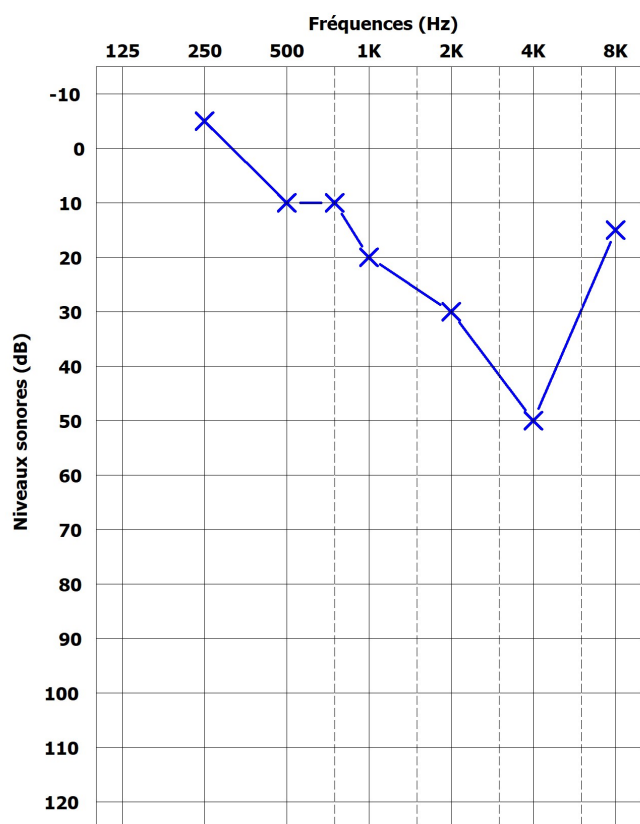

Oreille Gauche

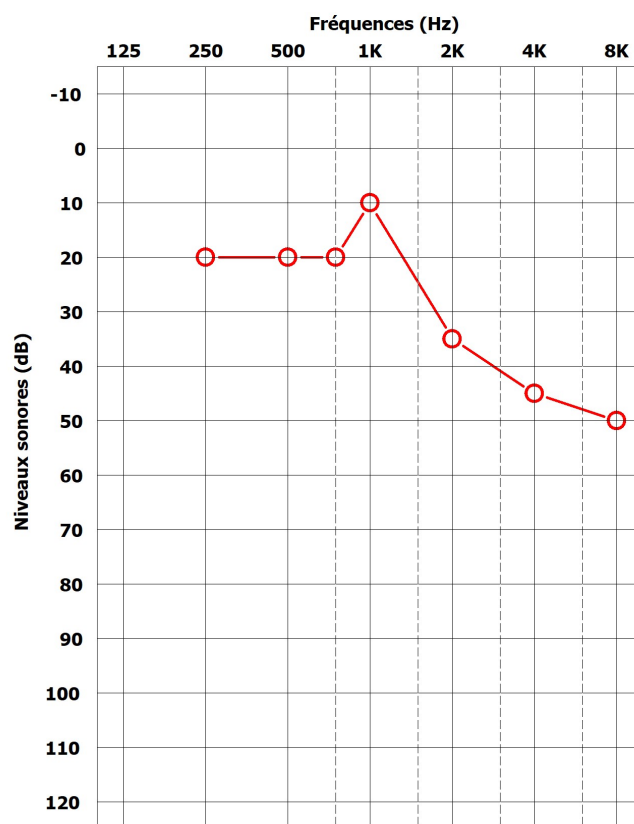

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	10	10	20		30		50		15
CA Droit		20	20	20	10		35		45		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes