

MEDVIE


Date du test: 21/02/2025 11:03:28

Durée: 3mn 57s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAH MOUSSA	
Date de naissance	27/08/1980
Age	44
Société	NEEMBA
ID	25022111012462065

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

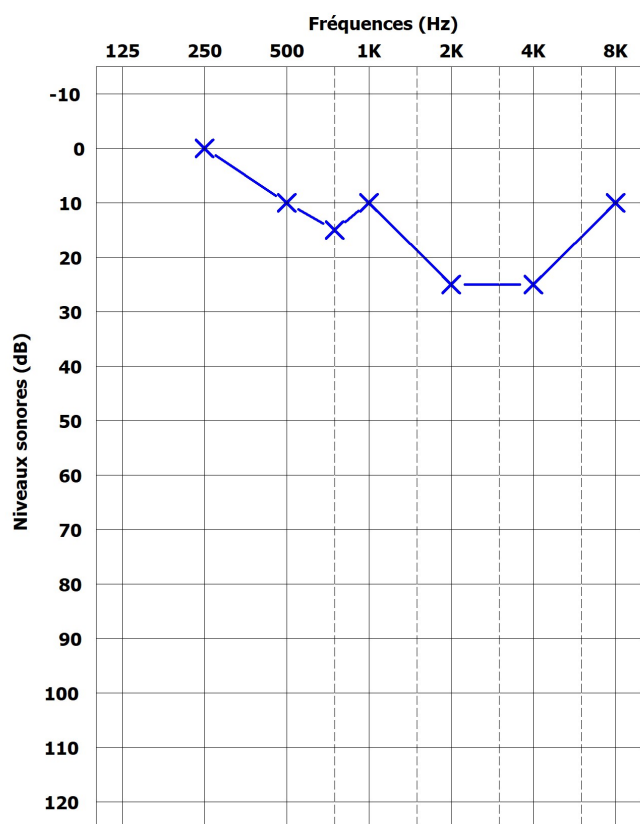

Oreille Gauche

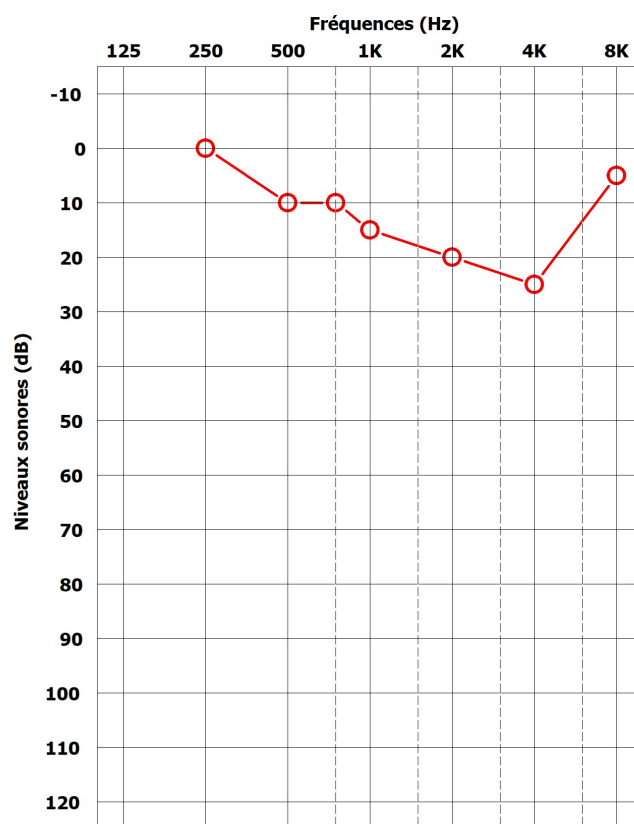

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	15	10		25		25		10
CA Droit		0	10	10	15		20		25		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes