


MEDVIE


Date du test: 09/09/2025 10:00:58
Durée: 5mn 00s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA SEKOU KALIL	
Date de naissance	11/10/1996
Age	28
Société	NEEMBA GUINEE
ID	25090909591847052

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

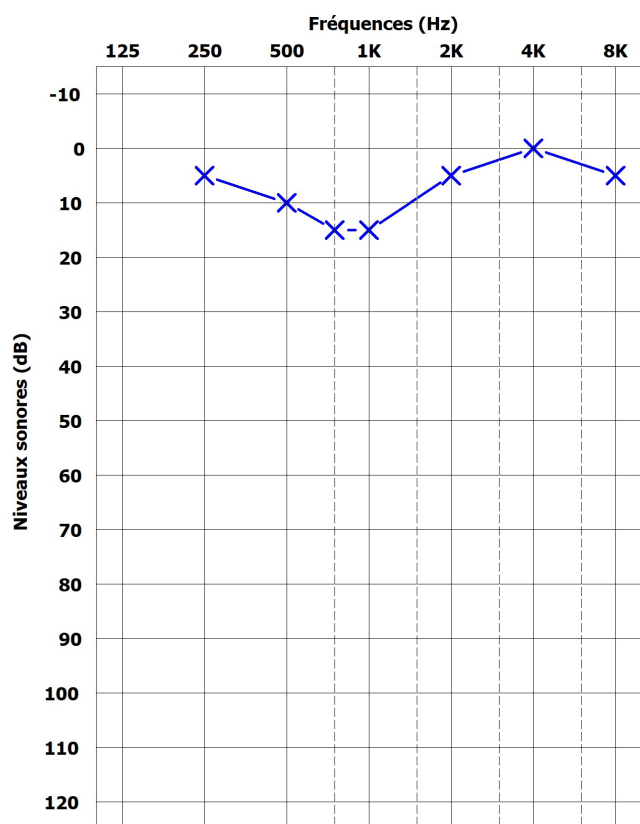

Oreille Gauche

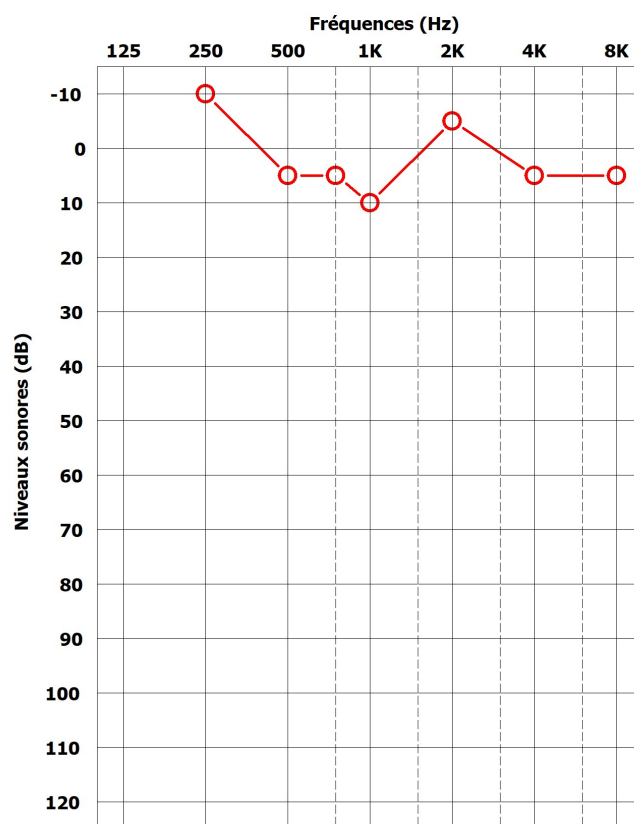

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	15	15		5		0		5
CA Droit		-10	5	5	10		-5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes