



Données Patient	MOLMOU DOYE
Date de naissance	01/07/1992
Age	32
Société	CHEC ADMIN
ID	24122015024401763

Date du test: 20/12/2024 15:04:24
 Durée: 5mn 33s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

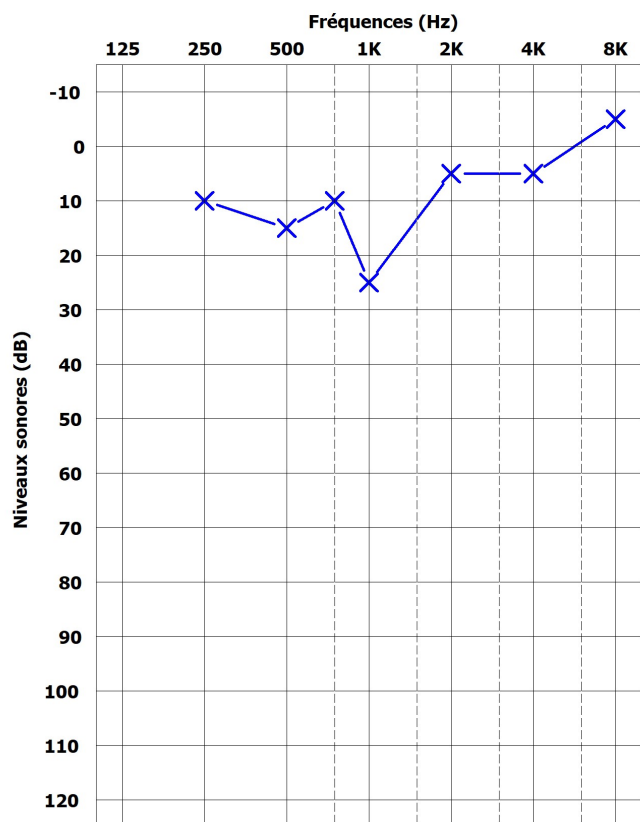

Oreille Gauche

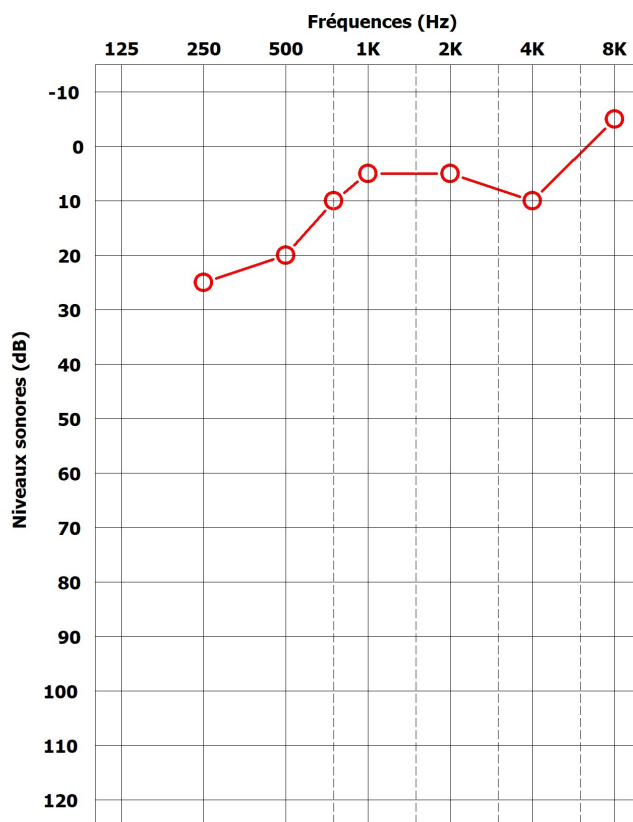

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	25		5		5		-5
CA Droit		25	20	10	5		5		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes