



Données Patient


ZOGBELEMOU BENOIT

Date de naissance 01/01/1997
Age 28
Société CHEC EPC3
ID 25010213551232795


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 02/01/2025 13:57:05
Durée: 2mn 34s
Type test Manuel
Continu

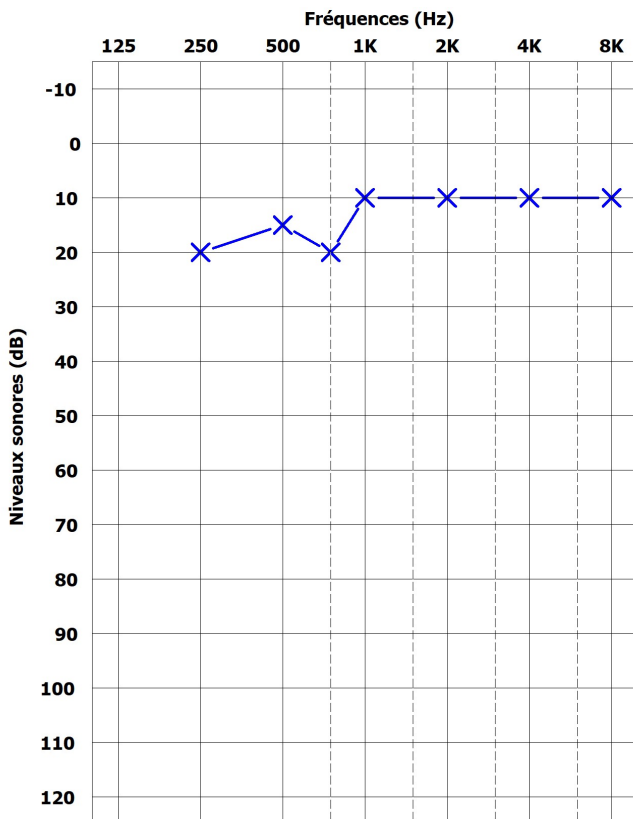

Oreille Gauche

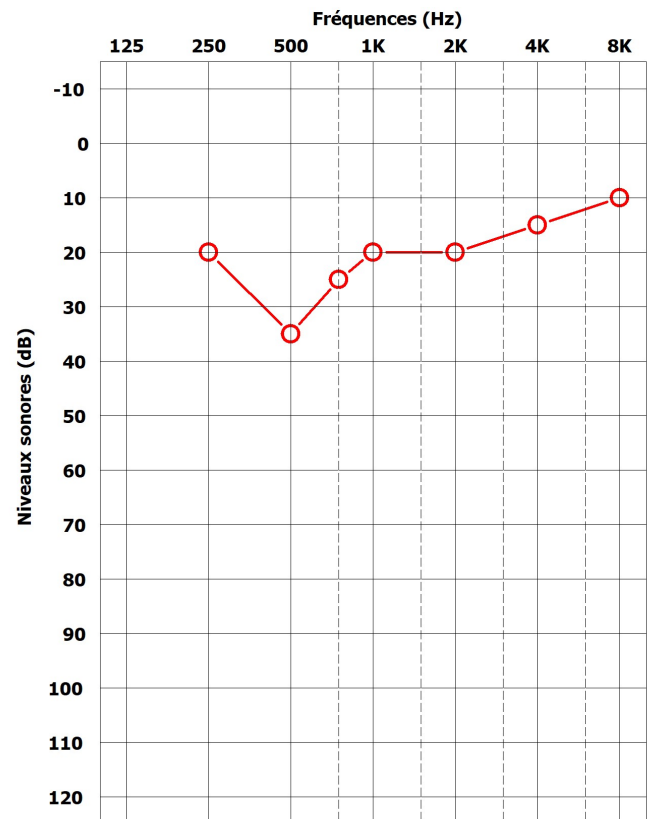

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	20	10		10		10		10
CA Droit		20	35	25	20		20		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes