



| Données Patient       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>KOLAMOU FASSOU</b> |                   |
| Date de naissance     | 28/02/1993        |
| Age                   | 31                |
| Société               | CHEC EPC3         |
| ID                    | 24122614543195818 |

Date du test: 26/12/2024 15:24:48  
 Durée: 4mn 24s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

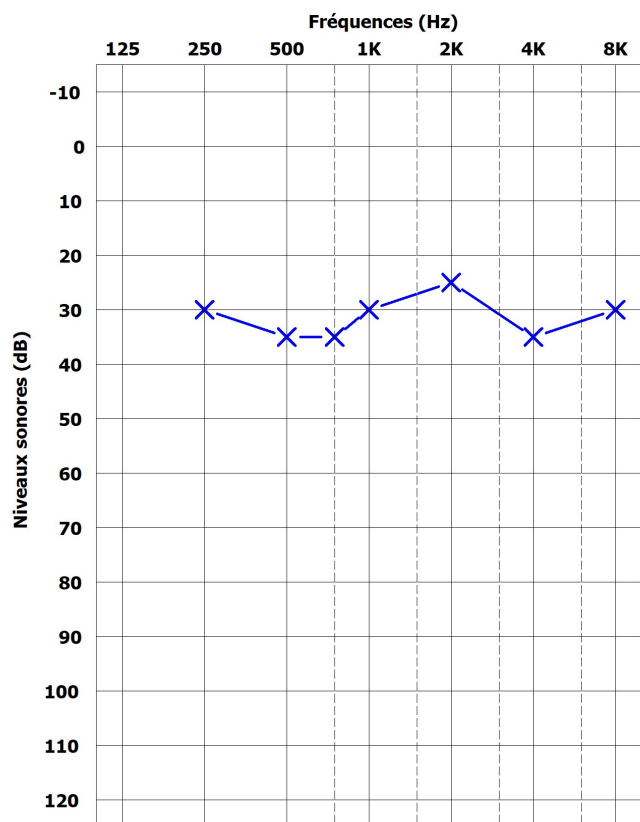

Oreille Gauche

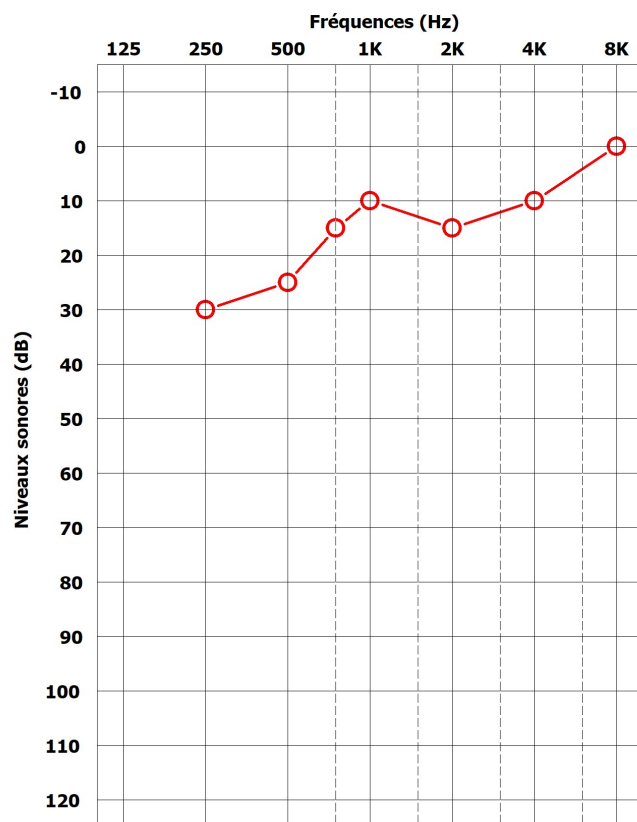

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 30  | 35  | 35  | 30 |     | 25 |    | 35 |    | 30 |
| CA Droit  |     | 30  | 25  | 15  | 10 |     | 15 |    | 10 |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 31,3 dB | --- |
| CA Droit        | 15,0 dB | --- |

Notes