


Données Patient		GAO HONGJIE
Date de naissance	20/06/1978	
Age	47	
Société	CHEC EPC3	
ID	25072114522433605	


MEDVIE

Date du test: 21/07/2025 14:54:45
 Durée: Omn 54s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

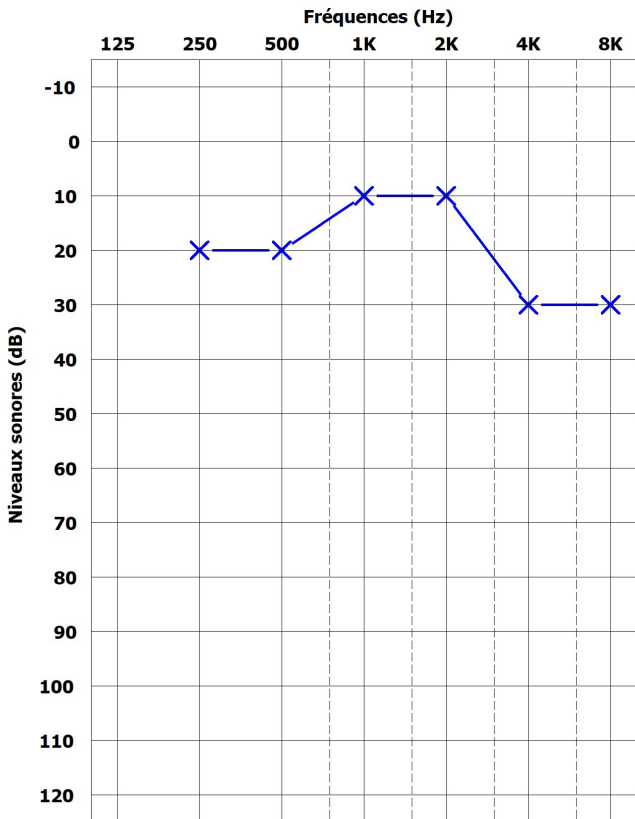

Oreille Gauche

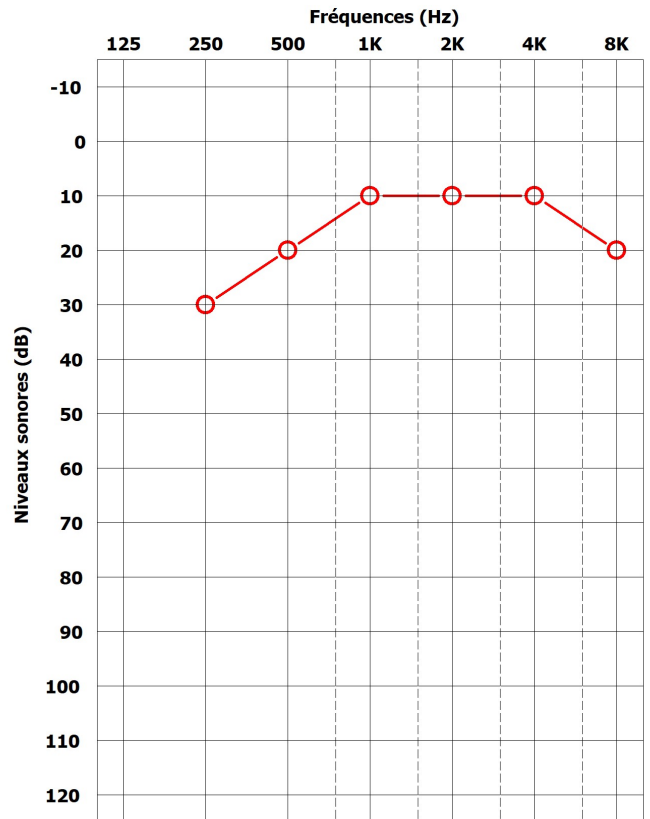

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20		10		10		30		30
CA Droit		30	20		10		10		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	17,5 dB
CA Droit	12,5 dB	---

Notes