



Données Patient	
KEITA SAYON	
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	CHEC EPC3
ID	24121015144416103

Date du test: 10/12/2024 15:24:03
 Durée: 6mn 19s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

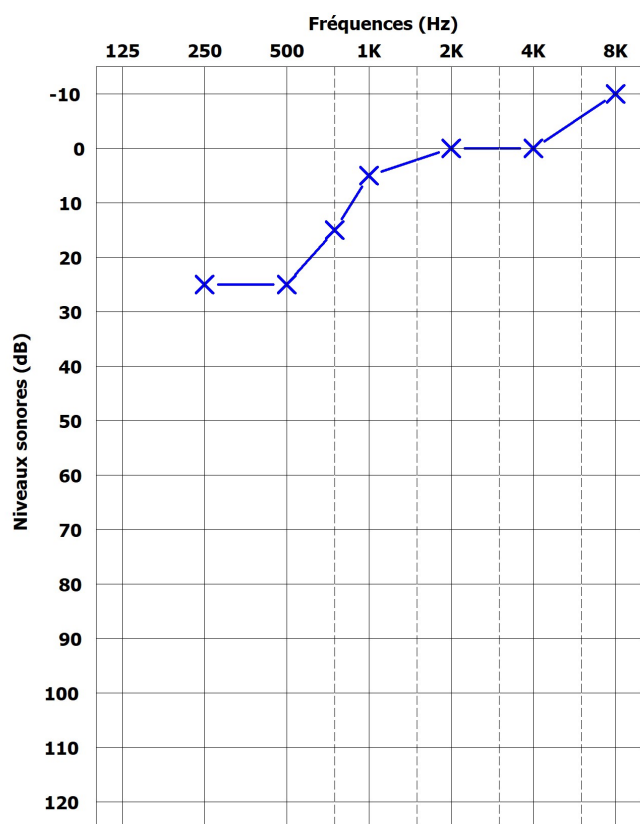

Oreille Gauche

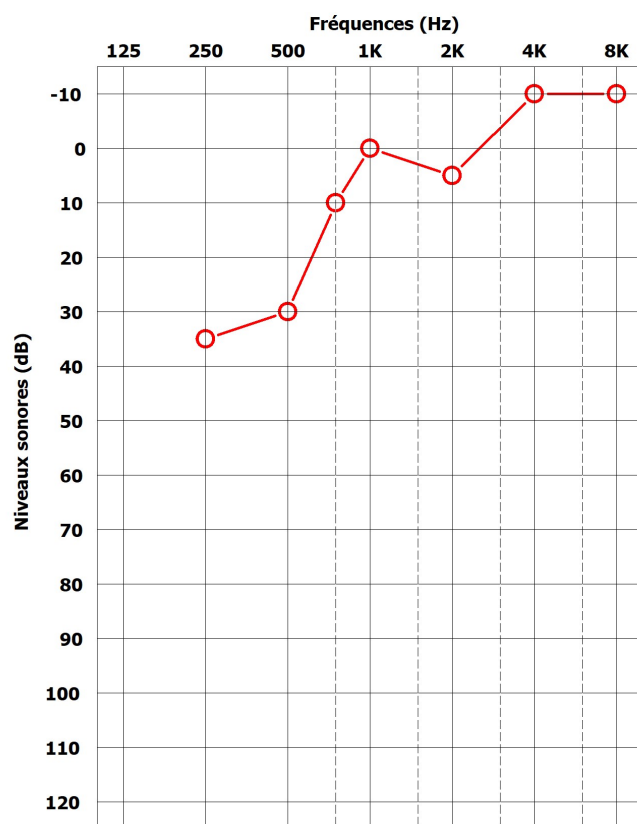

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	5		0		0		-10
CA Droit		35	30	10	0		5		-10		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes