


MEDVIE

Date du test: 07/09/2024 13:05:41

Durée: 5mn 12s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

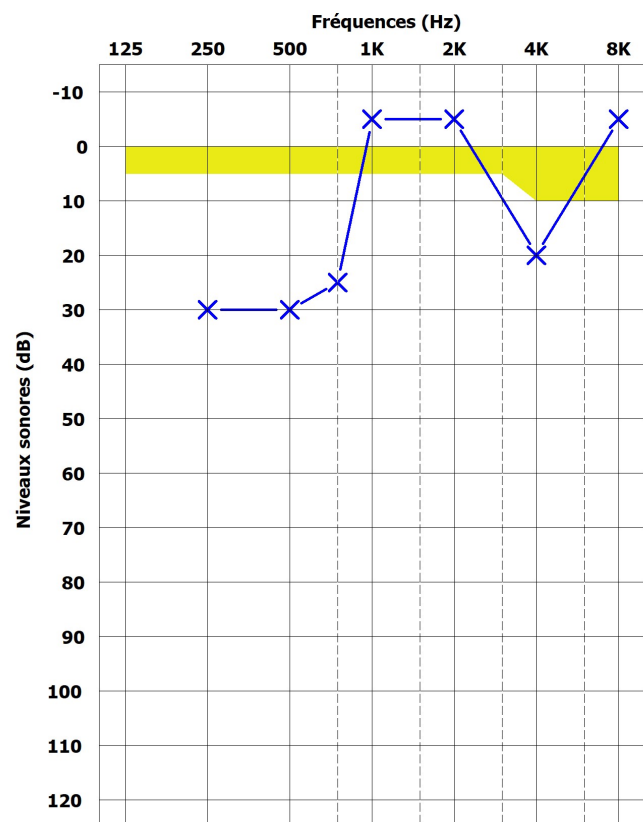

Oreille Gauche

Données Patient	
SOUMAH MOHAMED	
Date de naissance	01/01/2003
Age	21
Société	CHEC
ID	24090618502407055

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

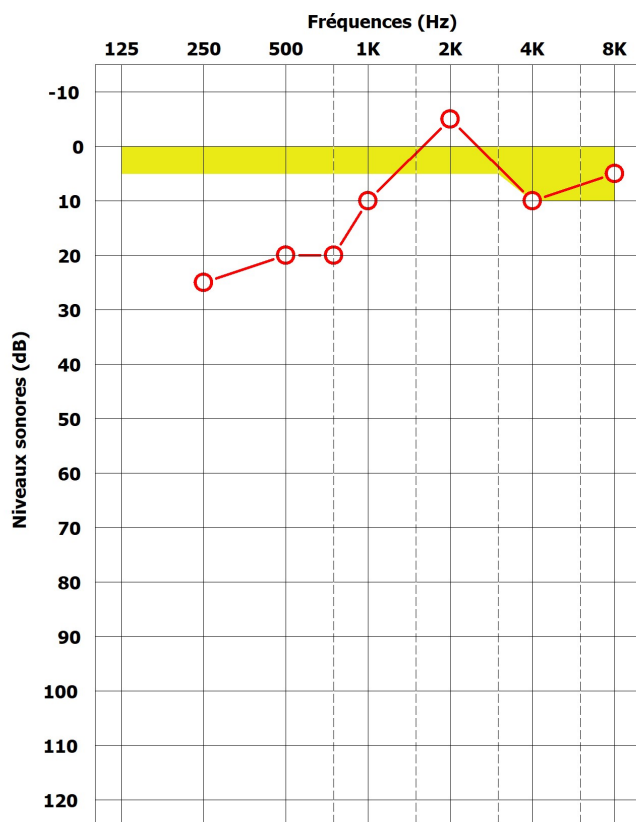

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	-5		-5		20		-5
CA Droit		25	20	20	10		-5		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes