



<b>Nom</b> DOUMBOUYA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 17/03/1983	<b>Profession</b> OPRATEUR REHABILITATIO
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b> RIO TINTO
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 123	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 83 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,7 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 62 %

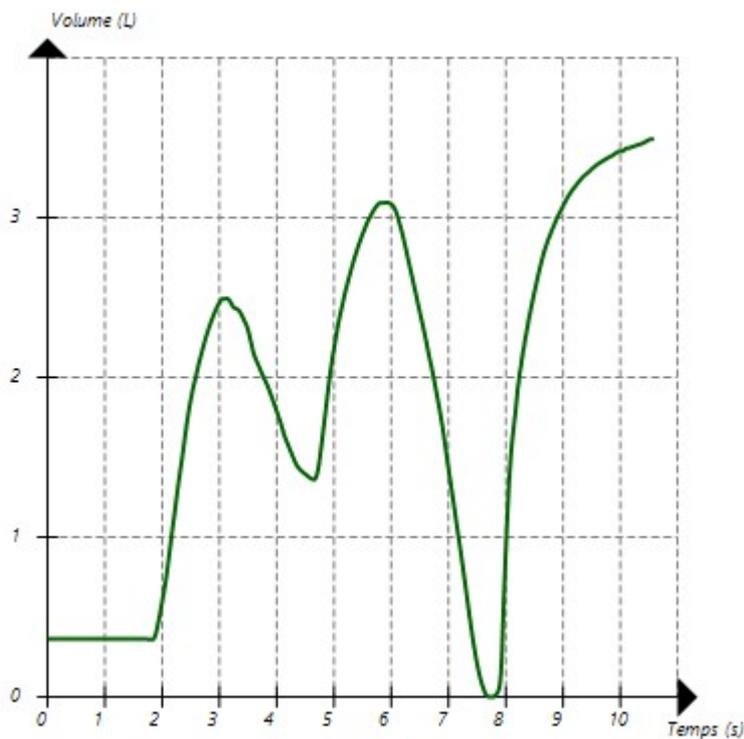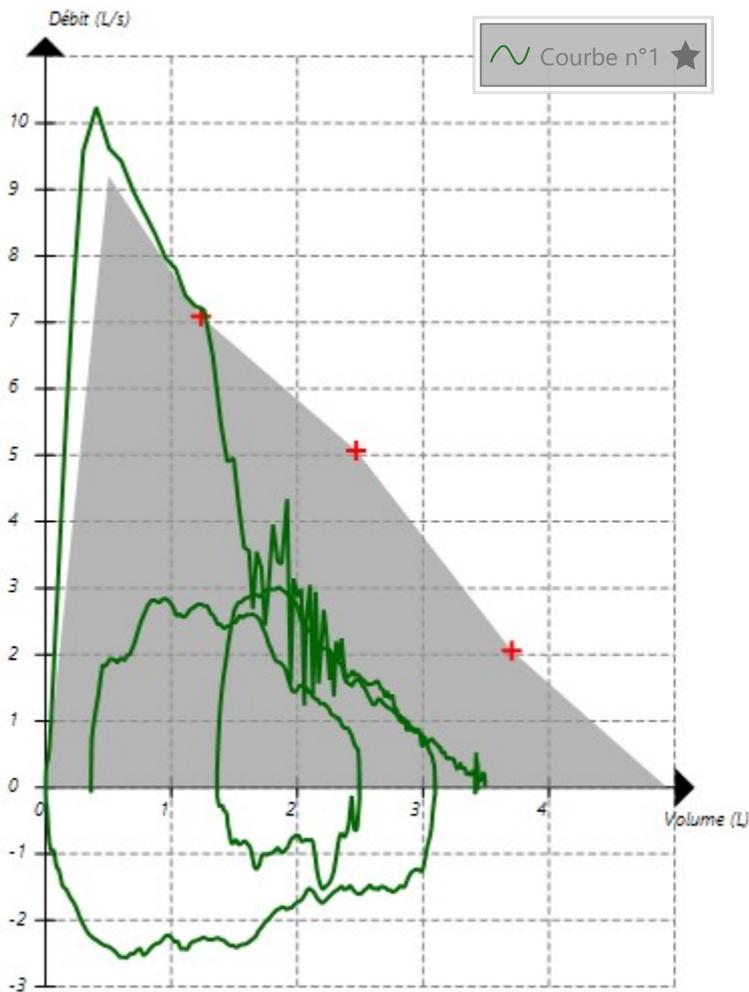

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,50 L	4,94 L	70,85 %
VEMS	2,99 L	4,06 L	73,65 %
DEP	10,40 L/s	9,21 L/s	112,92 %
VEMS/ CVF	85,43 %	82,40 %	103,68 %
Durée d'expiration	2,82 s	-	
DEMM	3,12 L/s	4,24 L/s	73,58 %
DEMM/ CVF	0,89 s-1	0,86 s-1	103,49 %
DE75	8,39 L/s	7,09 L/s	118,34 %
DE50	2,79 L/s	5,07 L/s	55,03 %
DE25	1,57 L/s	2,06 L/s	76,21 %