



<b>Nom</b> NINAMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DIDI ELOI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1970	<b>Profession</b> FORMATEUR RESP T
<b>Age</b> 54 Ans	<b>Entreprise</b> SMFG
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 15	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> MARIAMA DALANDA KEITA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,8 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 92,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 44 %

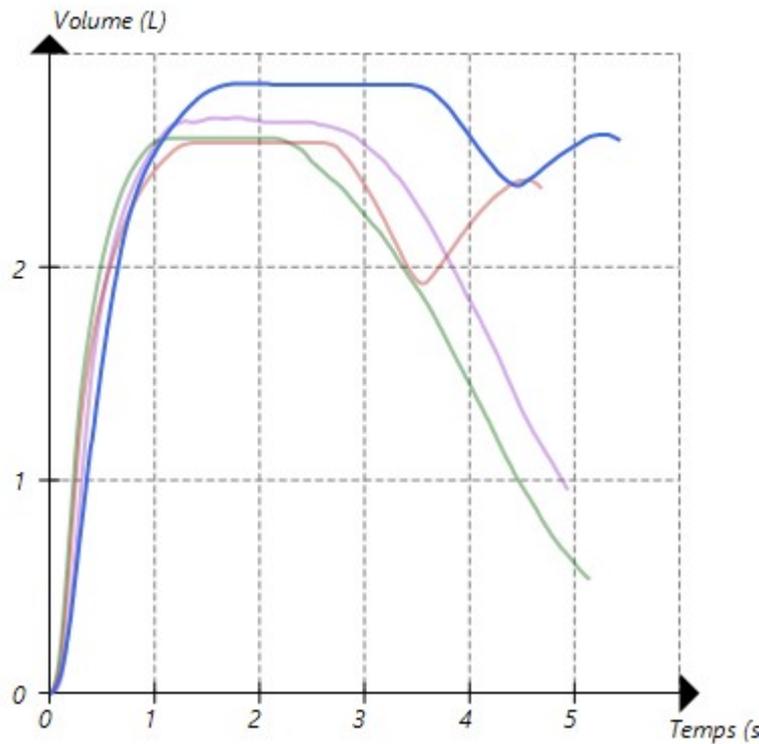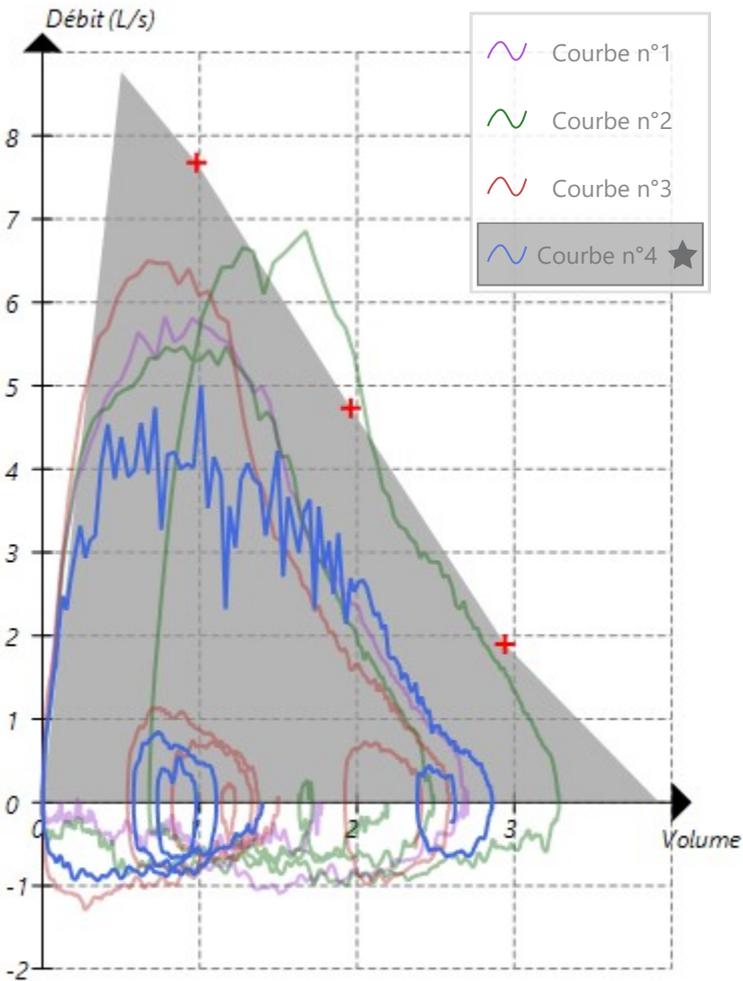

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,70 L	2,61 L	2,58 L	2,86 L	3,92 L	72,96 %
VEMS	2,65 L	2,60 L	2,51 L	2,63 L	3,13 L	84,03 %
DEP	6,04 L/s	6,94 L/s	6,70 L/s	5,45 L/s	8,77 L/s	62,14 %
VEMS/ CVF	98,15 %	99,62 %	97,29 %	91,96 %	77,54 %	118,60 %
Durée d'expiration	1,78 s	1,32 s	1,41 s	1,75 s	-	
DEMM	4,16 L/s	4,43 L/s	3,77 L/s	3,37 L/s	3,84 L/s	87,76 %
DEMM/ CVF	1,54 s-1	1,70 s-1	1,46 s-1	1,18 s-1	0,85 s-1	138,82 %
DE75	5,74 L/s	6,74 L/s	6,33 L/s	5,35 L/s	7,68 L/s	69,66 %
DE50	5,00 L/s	5,32 L/s	4,36 L/s	3,03 L/s	4,73 L/s	64,06 %
DE25	2,24 L/s	2,28 L/s	1,85 L/s	2,17 L/s	1,90 L/s	114,21 %