

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom TRAORE                      | Adresse                           |
| Prénom IBRAHIMA                 | Exposition                        |
| Né le 26/02/1980                | Profession SERVEUR                |
| Age 44 Ans                      | Entreprise ADEN                   |
| Genre Masculin                  | Service                           |
| ID 06                           | Fumeur Non fumeur                 |
| Taille 180 cm                   | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 115 kg                    | Prescripteur:                     |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal  | Smoking Pack Years : 0            |
| Opérateur MARIAMA DALANDA KEITA |                                   |



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00


Température ambiante : 30,9 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 92,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Humidité : 43 %

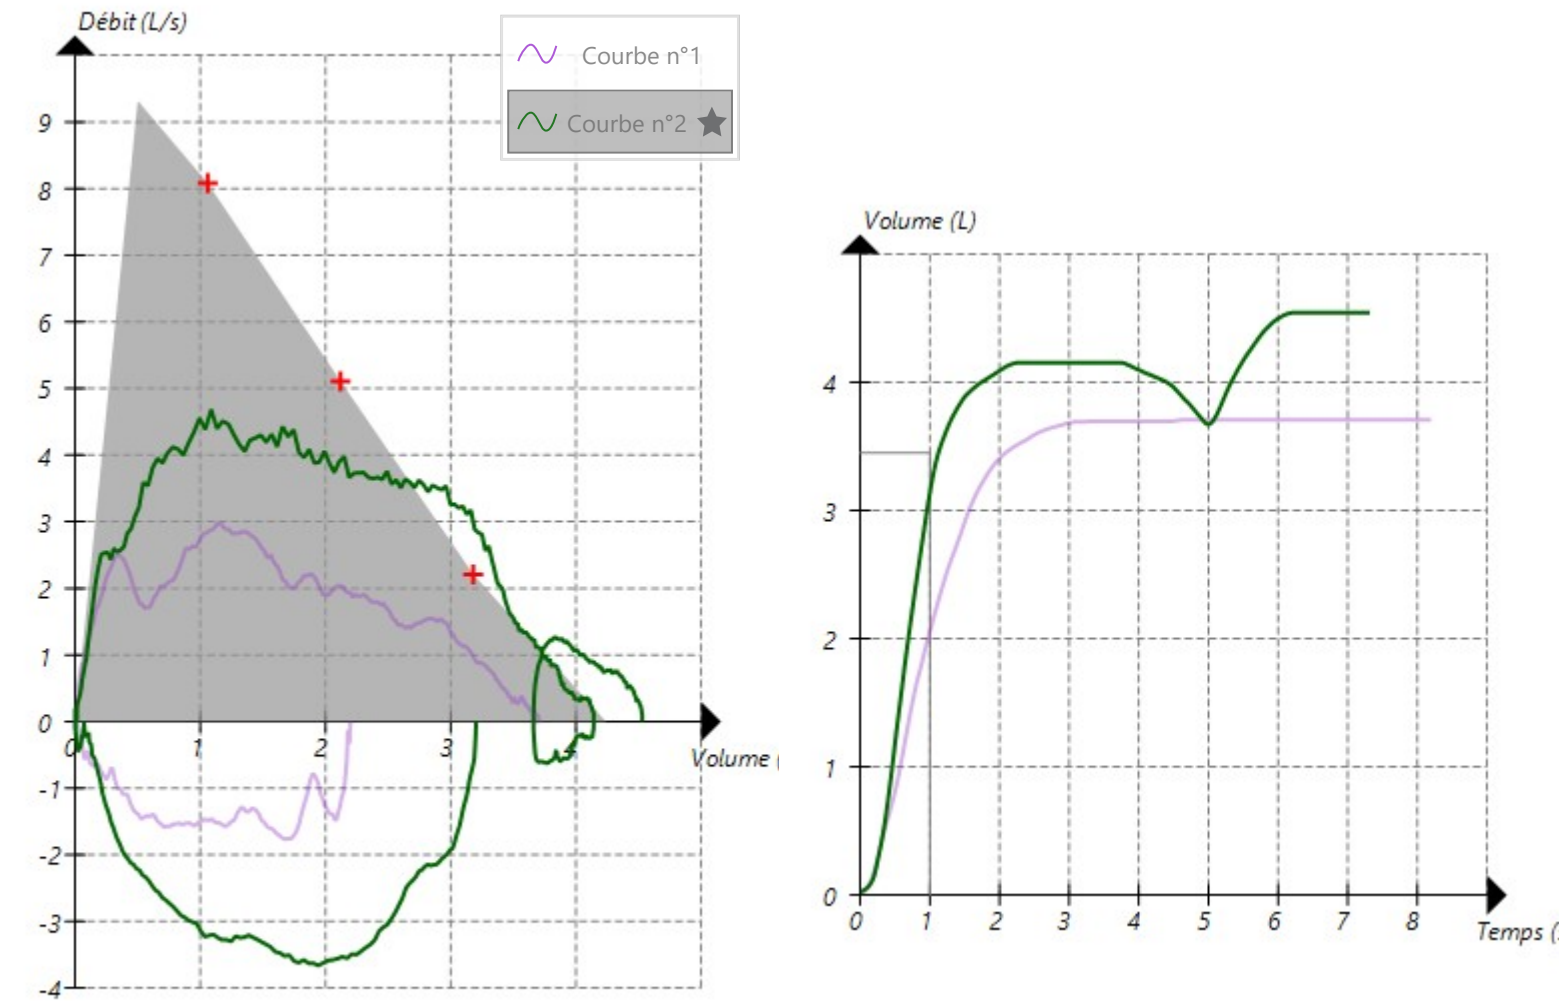

| Nom                | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,70 L     | 4,14 L               | 4,24 L   | 97,64 %   |
| VEMS               | 2,50 L     | 3,61 L               | 3,45 L   | 104,64 %  |
| DEP                | 3,03 L/s   | 4,85 L/s             | 9,32 L/s | 52,04 %   |
| VEMS/CVF           | 67,57 %    | 87,20 %              | 79,33 %  | 109,92 %  |
| Durée d'expiration | 4,69 s     | 2,45 s               | -        |           |
| DEMM               | 2,13 L/s   | 3,95 L/s             | 4,31 L/s | 91,65 %   |
| DEMM/CVF           | 0,58 s-1   | 0,95 s-1             | 0,89 s-1 | 106,74 %  |
| DE75               | 2,63 L/s   | 4,26 L/s             | 8,08 L/s | 52,72 %   |
| DE50               | 2,17 L/s   | 3,89 L/s             | 5,11 L/s | 76,13 %   |
| DE25               | 1,50 L/s   | 3,35 L/s             | 2,21 L/s | 151,58 %  |