

MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 15:44:59

Durée: 5mn 02s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAORO PAULINE	
Date de naissance	01/01/1985
Age	40
Société	EGAS
ID	25011115423854758

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

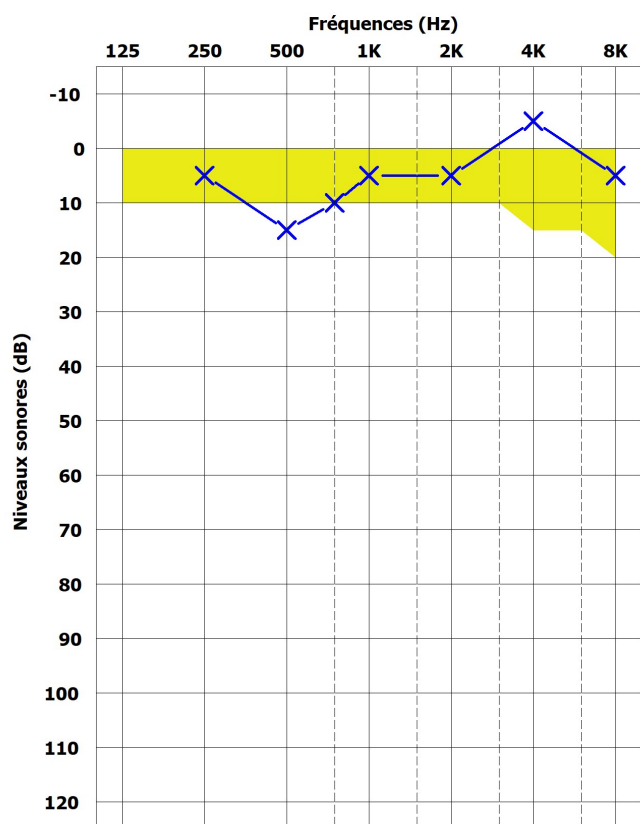

Oreille Gauche

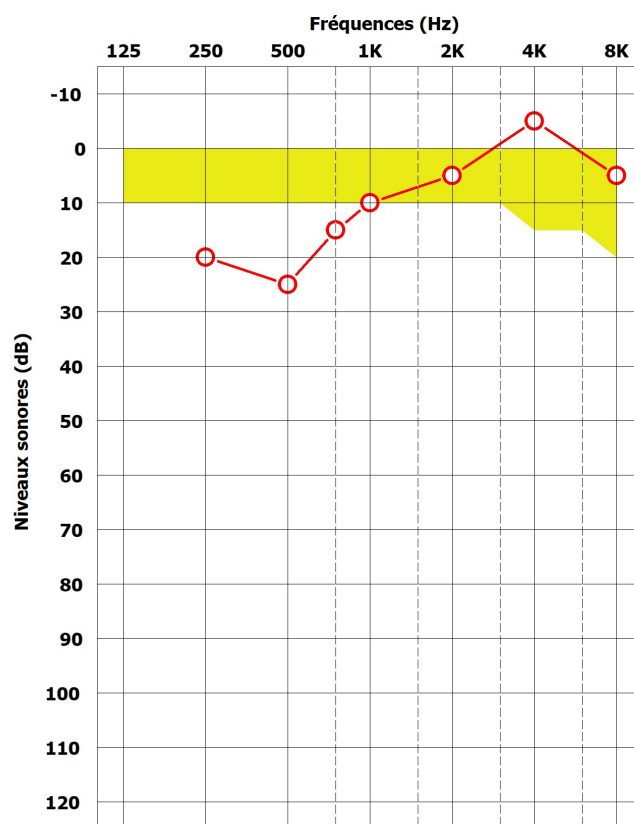

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	10	5		5		-5		5
CA Droit		20	25	15	10		5		-5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes