

<b>Nom DORE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom PLOAN</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1992</b>	<b>Profession FEMME DE CHAMBRE</b>
<b>Age 33 Ans</b>	<b>Entreprise EGAS</b>
<b>Genre Féminin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 12</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 150 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur MARIAMA DALANDA KEITA</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 26,2 °C  
 Pression atmosphérique : 92,6 kPa  
 Humidité : 39 %

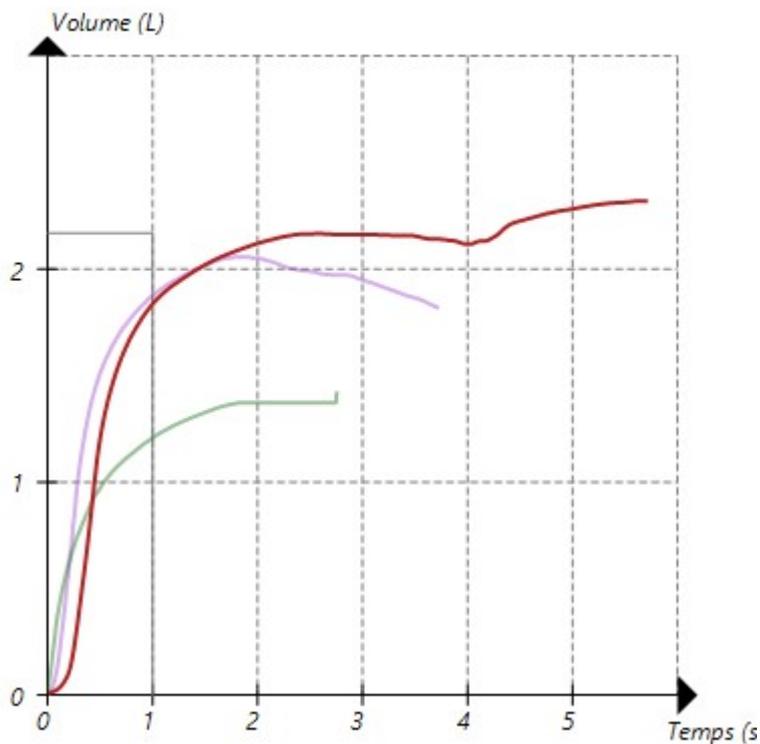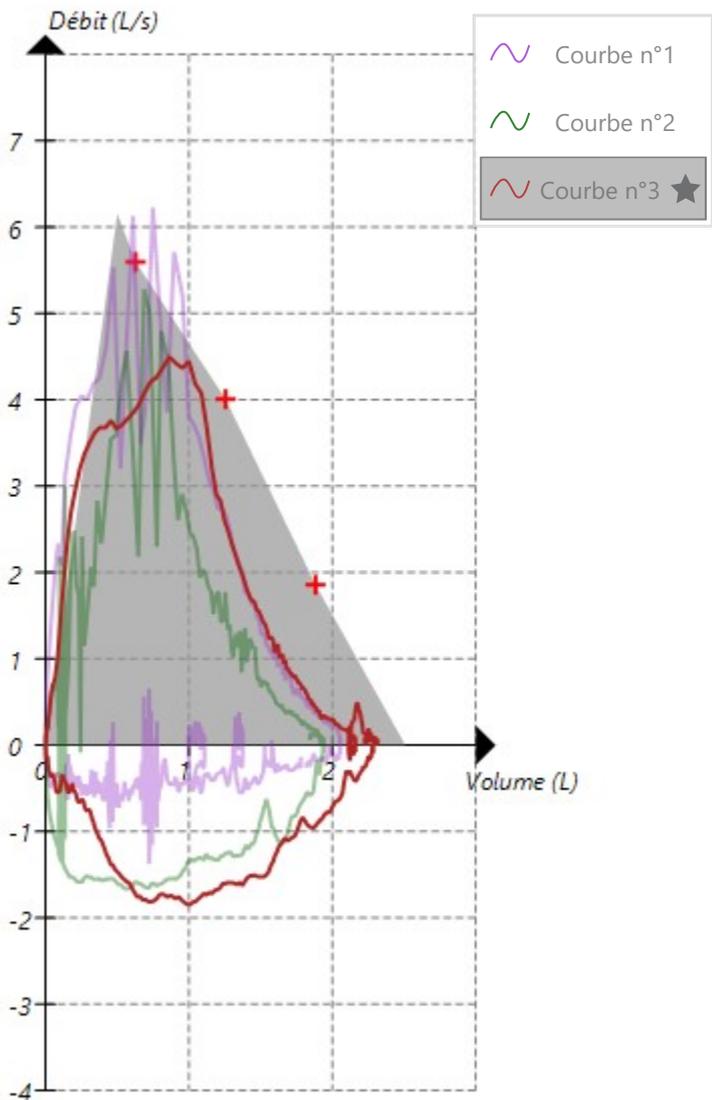

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,06 L	1,37 L	2,16 L	2,51 L	86,06 %
VEMS	1,91 L	1,21 L	1,93 L	2,17 L	88,94 %
DEP	6,61 L/s	7,77 L/s	4,55 L/s	6,16 L/s	73,86 %
VEMS/CVF	92,72 %	88,32 %	89,35 %	82,76 %	107,96 %
Durée d'expiration	1,81 s	1,82 s	2,66 s	-	
DEMM	3,00 L/s	1,38 L/s	2,71 L/s	3,68 L/s	73,64 %
DEMM/CVF	1,46 s-1	1,01 s-1	1,25 s-1	1,27 s-1	98,43 %
DE75	4,76 L/s	3,29 L/s	3,71 L/s	5,60 L/s	66,25 %
DE50	3,64 L/s	1,32 L/s	4,11 L/s	4,01 L/s	102,49 %
DE25	1,13 L/s	0,63 L/s	1,13 L/s	1,86 L/s	60,75 %