

<b>Nom</b> SOUMAH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED LAMINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 09/06/1993	<b>Profession</b> MACON
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CREPC23
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 51	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 31,3 °C  
 Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Humidité : 58 %

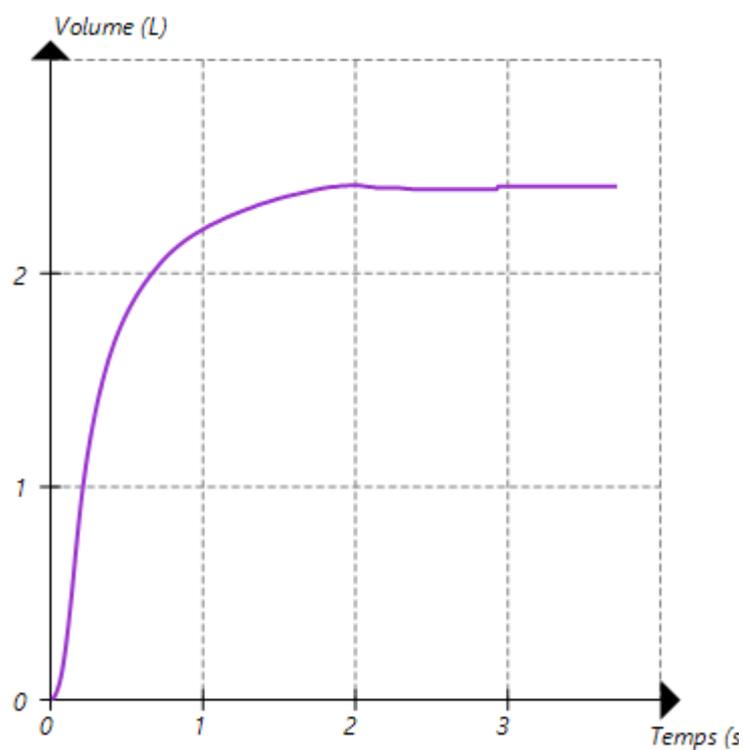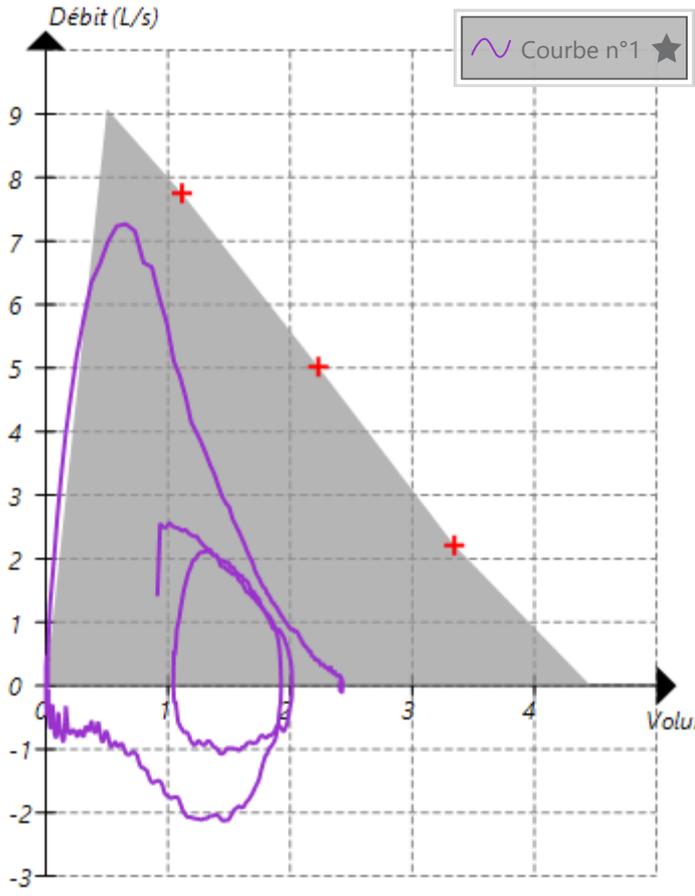

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,41 L	4,46 L	54,04 %
VEMS	2,23 L	3,79 L	58,84 %
DÉP	7,33 L/s	9,08 L/s	80,73 %
VEMS/CVF	92,53 %	81,66 %	113,31 %
Durée d'expiration	1,97 s	-	
DEMM	3,50 L/s	4,61 L/s	75,92 %
DEMM/CVF	1,45 s <sup>-1</sup>	1,03 s <sup>-1</sup>	140,78 %
DE75	7,20 L/s	7,75 L/s	92,90 %
DE50	3,96 L/s	5,02 L/s	78,88 %
DE25	1,43 L/s	2,21 L/s	64,71 %