



<b>Nom</b> KOLIE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FASSOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 27/11/1990	<b>Profession</b> MACON
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CREPC23
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 54	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 30,9 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 100,8 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 53 %

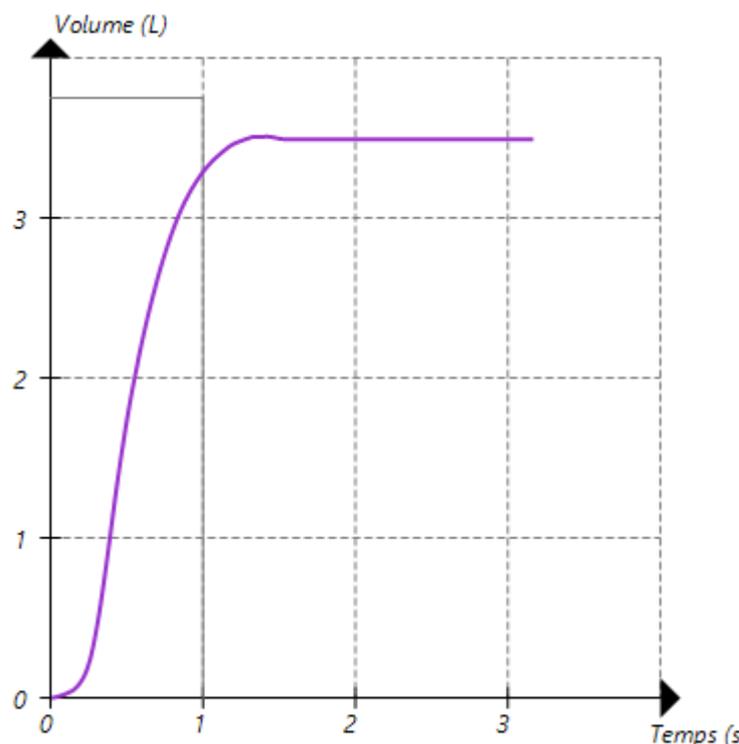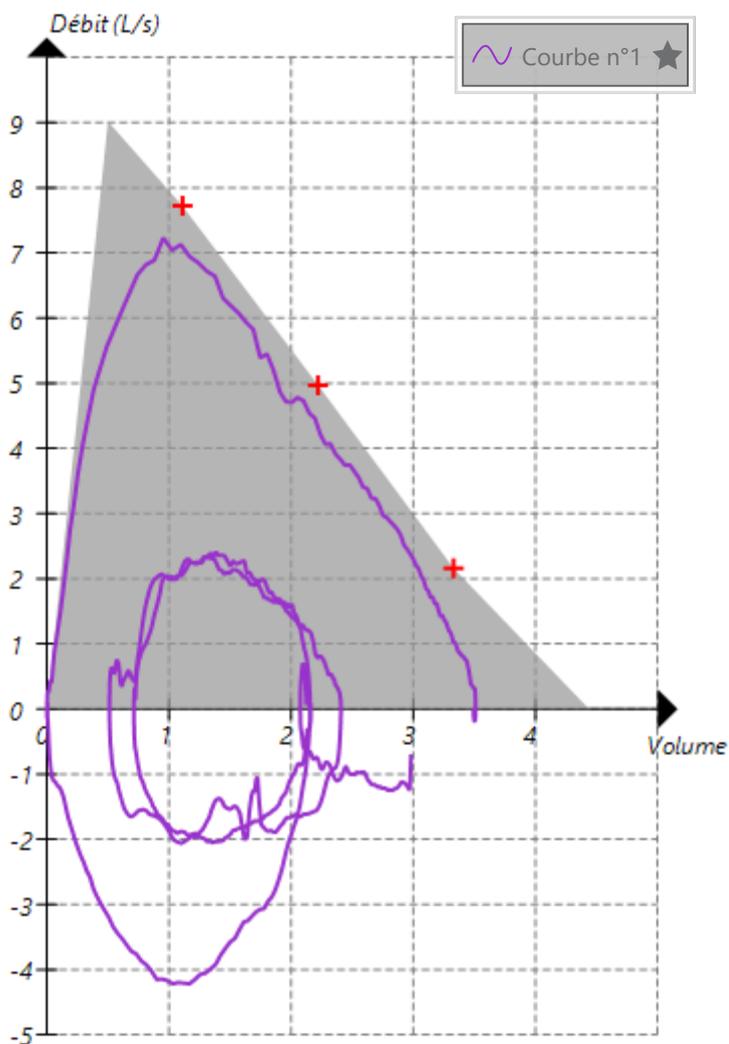

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,51 L	4,44 L	79,05 %
VEMS	3,48 L	3,75 L	92,80 %
DÉP	7,31 L/s	9,02 L/s	81,04 %
VEMS/CVF	99,15 %	81,12 %	122,23 %
Durée d'expiration	1,42 s	-	
DEMM	5,27 L/s	4,50 L/s	117,11 %
DEMM/CVF	1,50 s <sup>-1</sup>	1,01 s <sup>-1</sup>	148,51 %
DE75	6,90 L/s	7,72 L/s	89,38 %
DE50	5,22 L/s	4,97 L/s	105,03 %
DE25	3,38 L/s	2,16 L/s	156,48 %