

**Nom** CAMARA  
**Prénom** MAMOUDOU  
**Né le** 01/01/1995  
**Age** 30 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 178  
**Taille** 174 cm  
**Poids** 62 kg  
**Valeurs prédictes** Eccs/Zapletal  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession**  
**Entreprise** EPC 2 ET 3  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**



Fim medical

51 rue Primat

+33 (0)4 72 34 89 89

+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27,6 °C

Numéro de série : 253562

Pression atmosphérique : 100,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 54 %

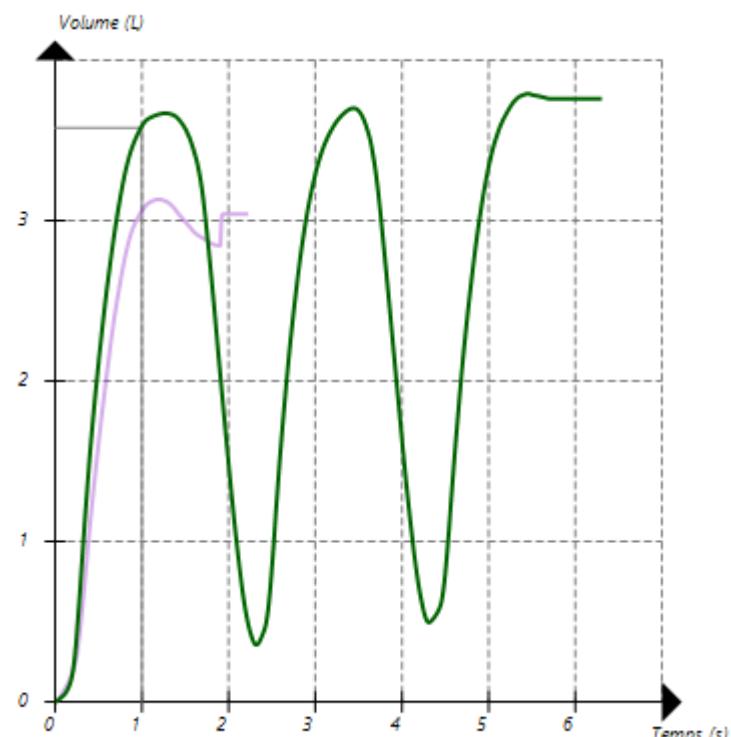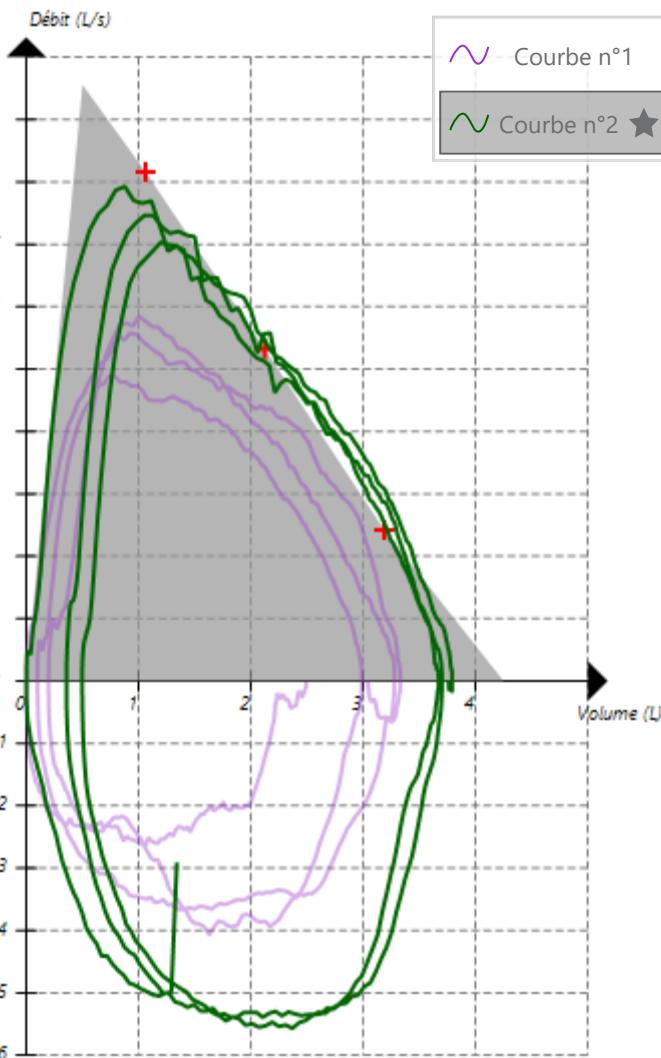

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,13 L	3,67 L	4,25 L	86,35 %
VEMS	3,13 L	3,66 L	3,58 L	102,23 %
DEP	5,87 L/s	7,99 L/s	9,56 L/s	83,58 %
VEMS/CVF	100,00 %	99,73 %	81,84 %	121,86 %
Durée d'expiration	1,18 s	1,27 s	-	
DEMM	4,85 L/s	5,65 L/s	4,79 L/s	117,95 %
DEMM/CVF	1,55 s <sup>-1</sup>	1,54 s <sup>-1</sup>	0,98 s <sup>-1</sup>	157,14 %
DE75	5,81 L/s	7,88 L/s	8,16 L/s	96,57 %
DE50	4,67 L/s	5,70 L/s	5,32 L/s	107,14 %
DE25	3,66 L/s	3,89 L/s	2,42 L/s	160,74 %