

<b>Nom</b> Manning	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> Jason Robert	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 22/11/1985	<b>Profession</b> MANAGER
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> SUSTAINABILITY
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 11	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Autre
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
Numéro de série : 253566  
Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Température ambiante : 26,4 °C  
Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
Humidité : 62 %

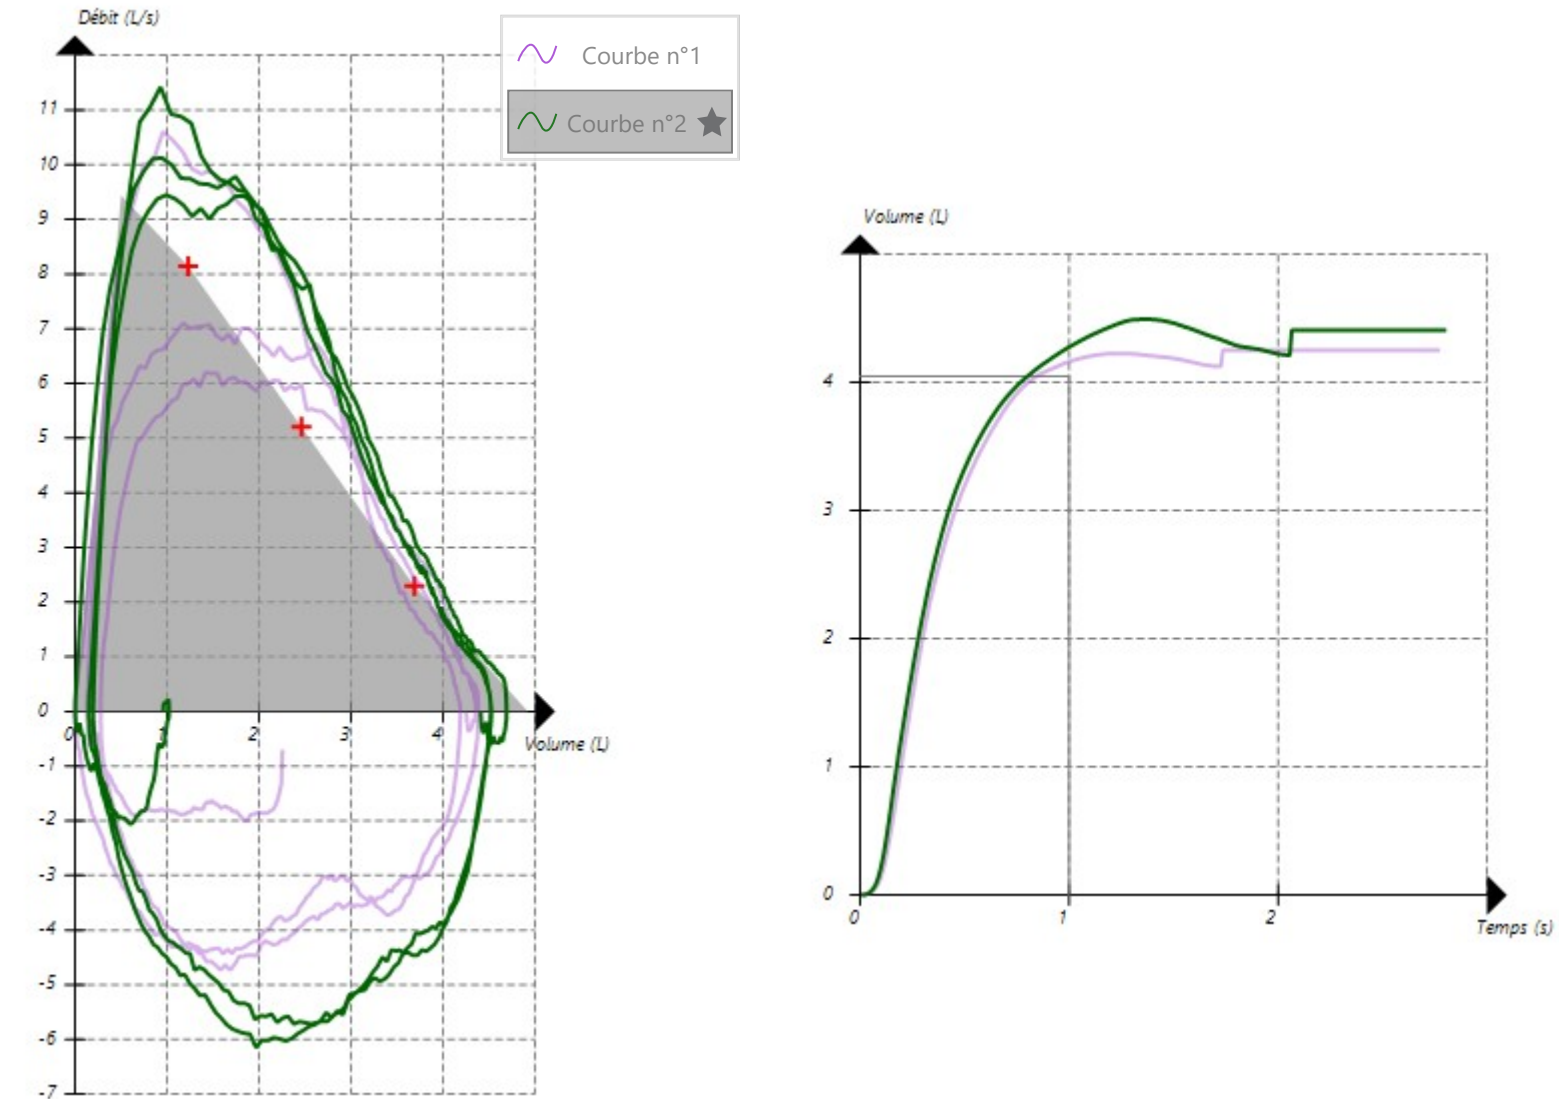

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,23 L	4,49 L	4,92 L	91,26 %
VEMS	4,20 L	4,35 L	4,05 L	107,41 %
DEP	10,79 L/s	11,65 L/s	9,44 L/s	123,41 %
VEMS/CVF	99,29 %	96,88 %	80,05 %	121,02 %
Durée d'expiration	1,21 s	1,35 s	-	
DEMM	7,21 L/s	6,91 L/s	4,46 L/s	154,93 %
DEMM/CVF	1,70 s-1	1,54 s-1	0,91 s-1	169,23 %
DE75	10,26 L/s	10,24 L/s	8,14 L/s	125,80 %
DE50	8,20 L/s	7,89 L/s	5,20 L/s	151,73 %
DE25	3,82 L/s	3,50 L/s	2,29 L/s	152,84 %