

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b> CHAUFFEUR VL
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> MED VIE
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 16	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 57 %

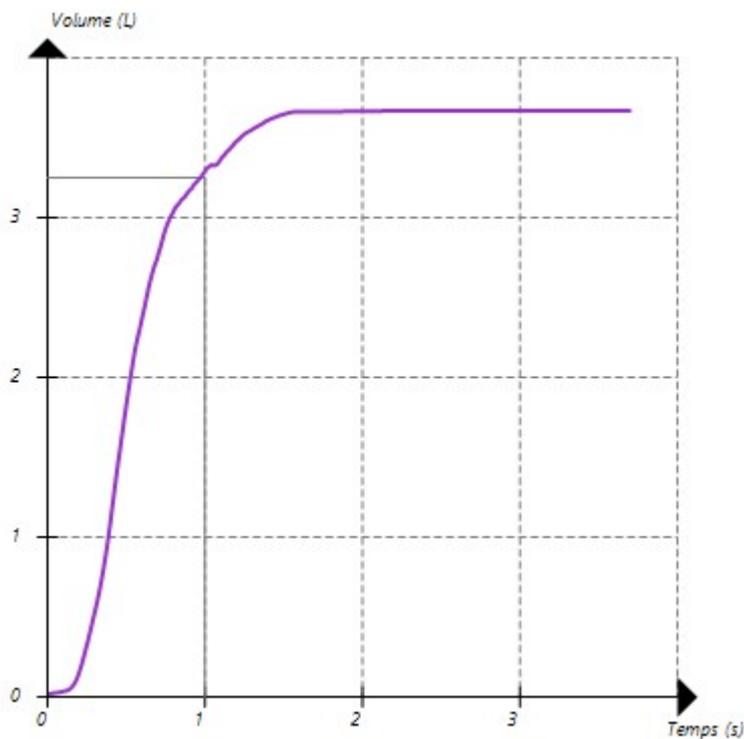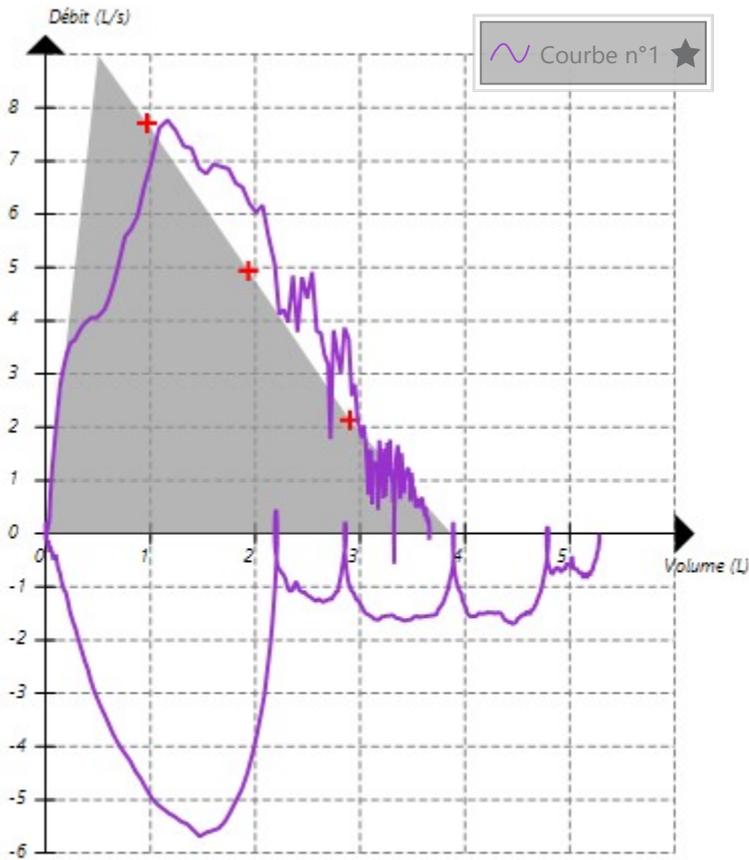

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,66 L	3,87 L	94,57 %
VEMS	3,51 L	3,25 L	108,00 %
DEP	7,85 L/s	8,99 L/s	87,32 %
VEMS/ CVF	95,90 %	80,77 %	118,73 %
Durée d'expiration	2,23 s	-	
DEMM	5,66 L/s	4,44 L/s	127,48 %
DEMM/ CVF	1,55 s-1	1,00 s-1	155,00 %
DE75	6,38 L/s	7,71 L/s	82,75 %
DE50	6,59 L/s	4,94 L/s	133,40 %
DE25	4,07 L/s	2,13 L/s	191,08 %