



<b>Nom</b> KALISSA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MABINTY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> CUISINE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> MEDVIE
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 22	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 83 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,3 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 48 %

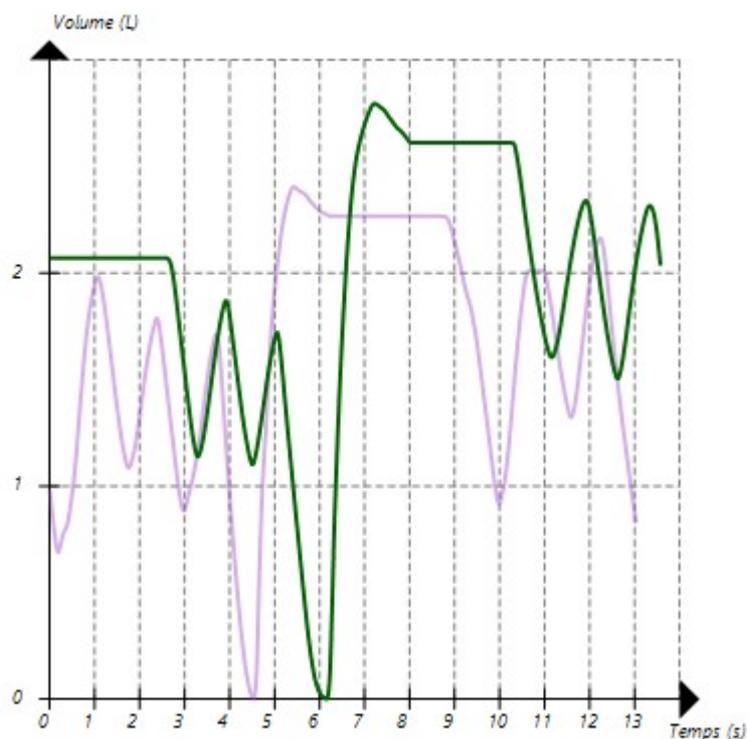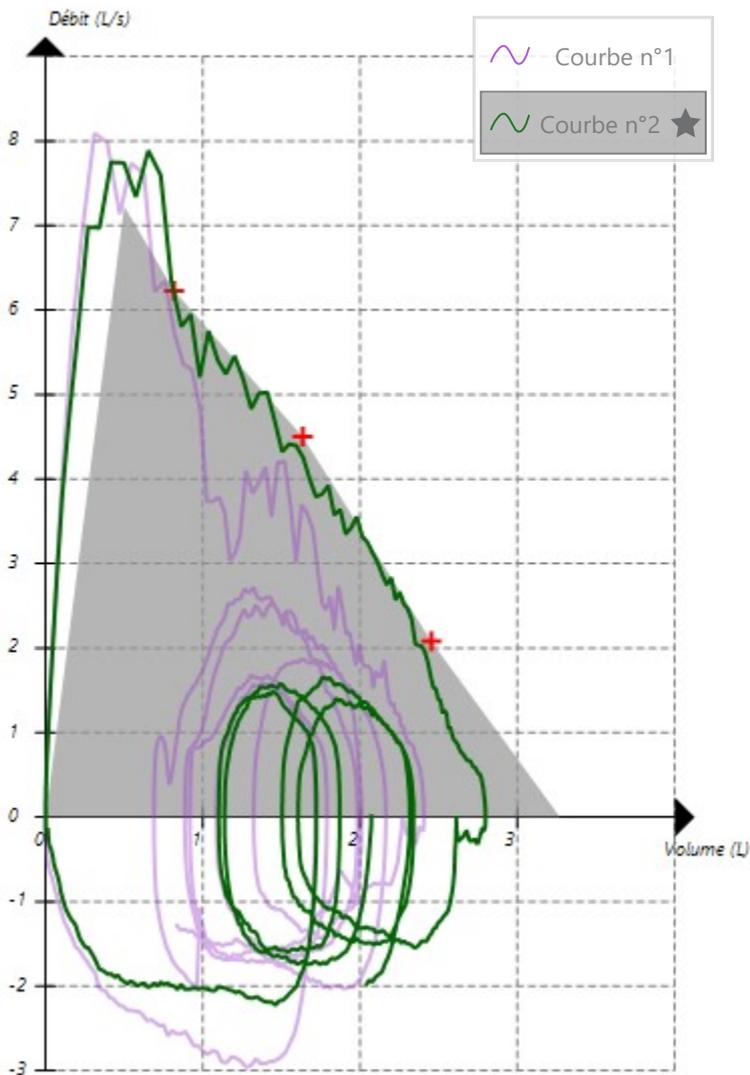

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,40 L	2,80 L	3,27 L	85,63 %
VEMS	2,40 L	2,80 L	2,85 L	98,25 %
DEP	8,29 L/s	8,38 L/s	7,23 L/s	115,91 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	82,96 %	120,54 %
Durée d'expiration	0,89 s	1,07 s	-	
DEMM	4,15 L/s	4,66 L/s	3,95 L/s	117,97 %
DEMM/CVF	1,73 s-1	1,66 s-1	1,05 s-1	158,10 %
DE75	7,89 L/s	7,79 L/s	6,23 L/s	125,04 %
DE50	3,21 L/s	4,91 L/s	4,50 L/s	109,11 %
DE25	2,76 L/s	3,06 L/s	2,08 L/s	147,12 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: