



<b>Nom</b> SOUMAORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY 2	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/05/1983	<b>Profession</b> AGENT HYDRO SEEDER
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> FEG sarl
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 09	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire obstructif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 35 %

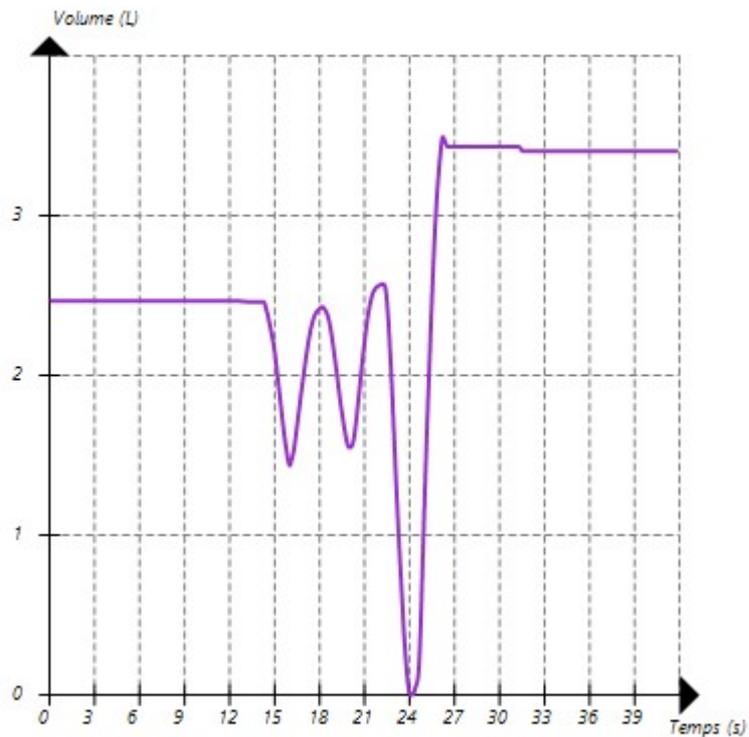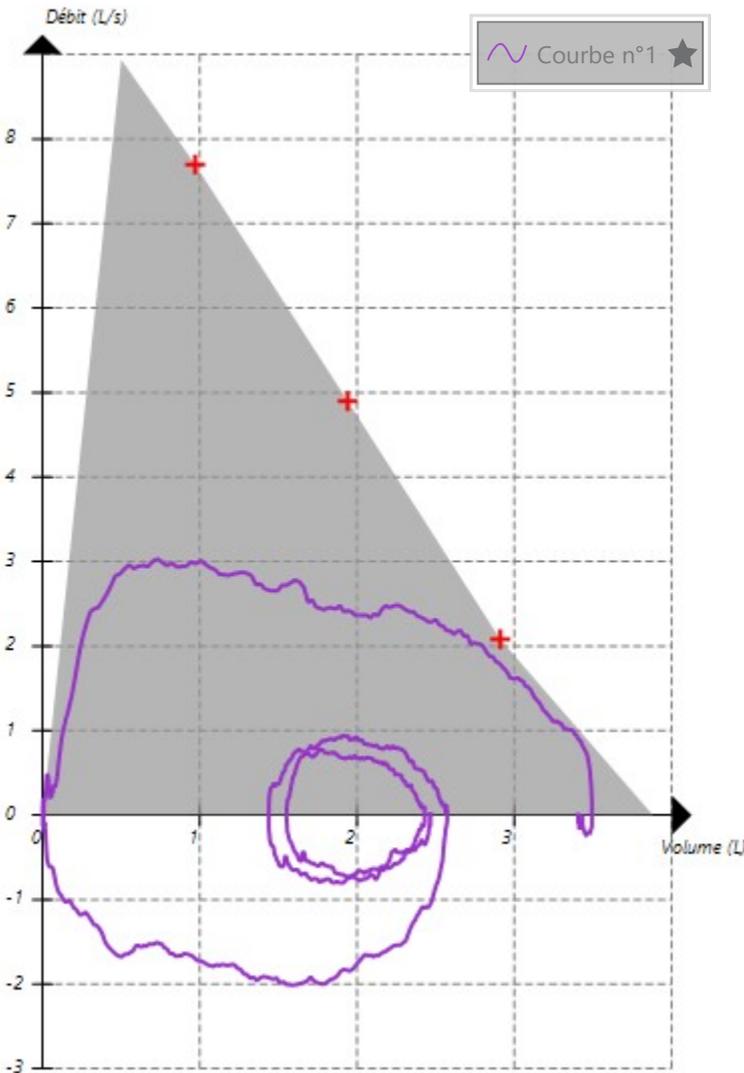

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,49 L	3,88 L	89,95 %
VEMS	2,72 L	3,22 L	84,47 %
DEP	3,05 L/s	8,94 L/s	34,12 %
VEMS/ CVF	77,94 %	80,05 %	97,36 %
Durée d'expiration	1,98 s	-	
DEMM	2,62 L/s	4,30 L/s	60,93 %
DEMM/ CVF	0,75 s-1	0,96 s-1	78,12 %
DE75	2,93 L/s	7,70 L/s	38,05 %
DE50	2,47 L/s	4,90 L/s	50,41 %
DE25	2,14 L/s	2,08 L/s	102,88 %