



<b>Nom</b> BERETE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AMADOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 21/01/1993	<b>Profession</b> HYDR0 SEEDER
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> FEG sarl
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 06	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 183 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 79 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 33 %

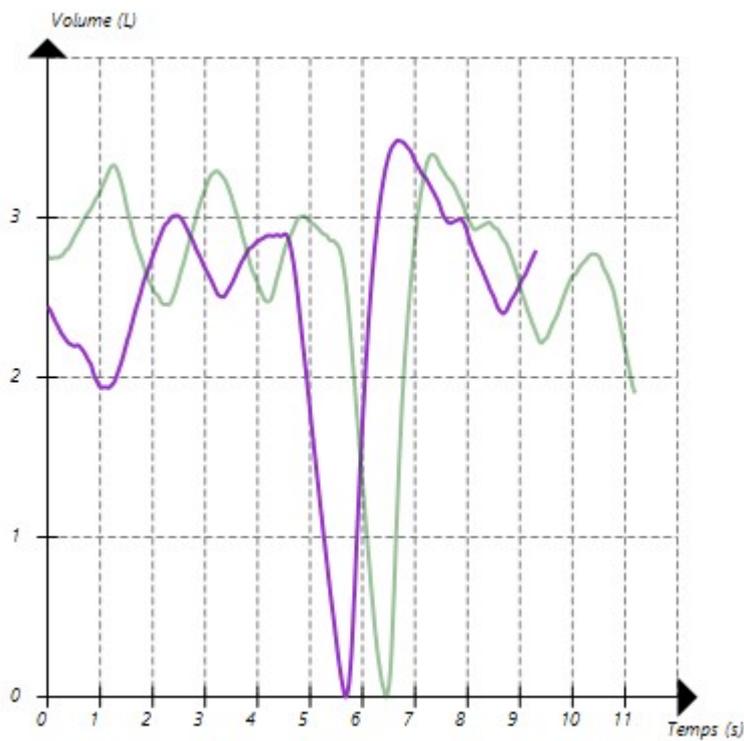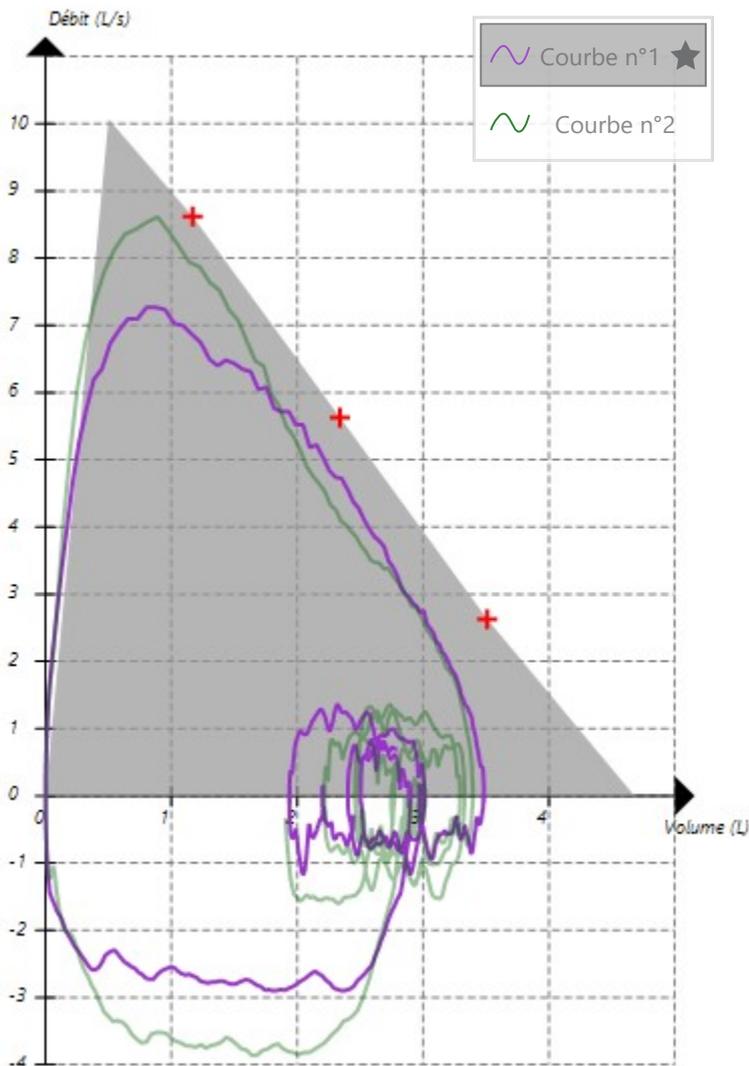

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,48 L	3,40 L	4,68 L	74,36 %
VEMS	3,48 L	3,40 L	3,90 L	89,23 %
DEP	7,36 L/s	8,66 L/s	10,07 L/s	73,09 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	81,66 %	122,46 %
Durée d'expiration	0,98 s	0,87 s	-	
DEMM	5,79 L/s	5,96 L/s	4,92 L/s	117,68 %
DEMM/CVF	1,66 s-1	1,75 s-1	0,91 s-1	182,42 %
DE75	7,21 L/s	8,66 L/s	8,62 L/s	83,64 %
DE50	6,14 L/s	6,27 L/s	5,63 L/s	109,06 %
DE25	3,83 L/s	3,61 L/s	2,63 L/s	145,63 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: