



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINE SARAN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/06/1994	<b>Profession</b> AGENT HYDRO SEEDER
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> FEG sarl
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 08	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 32 %

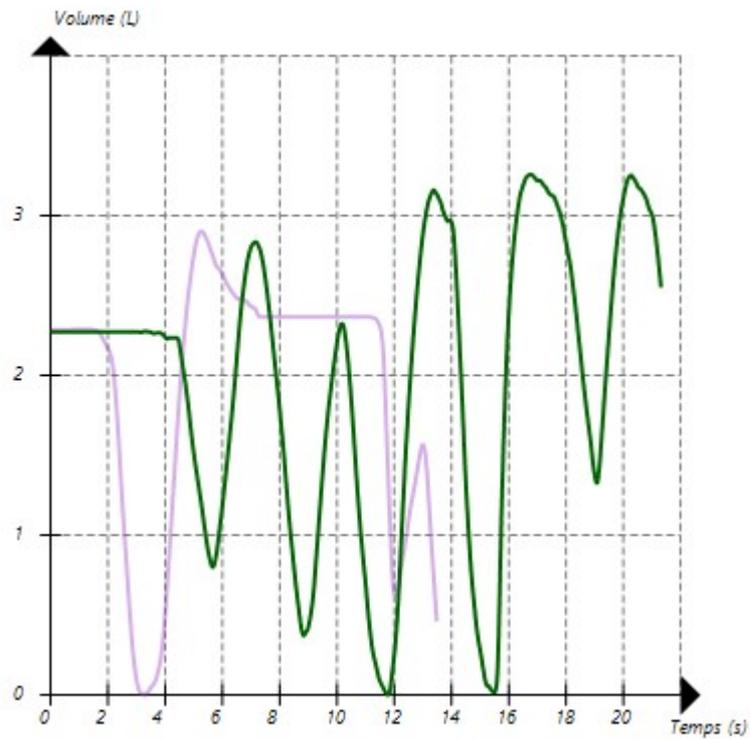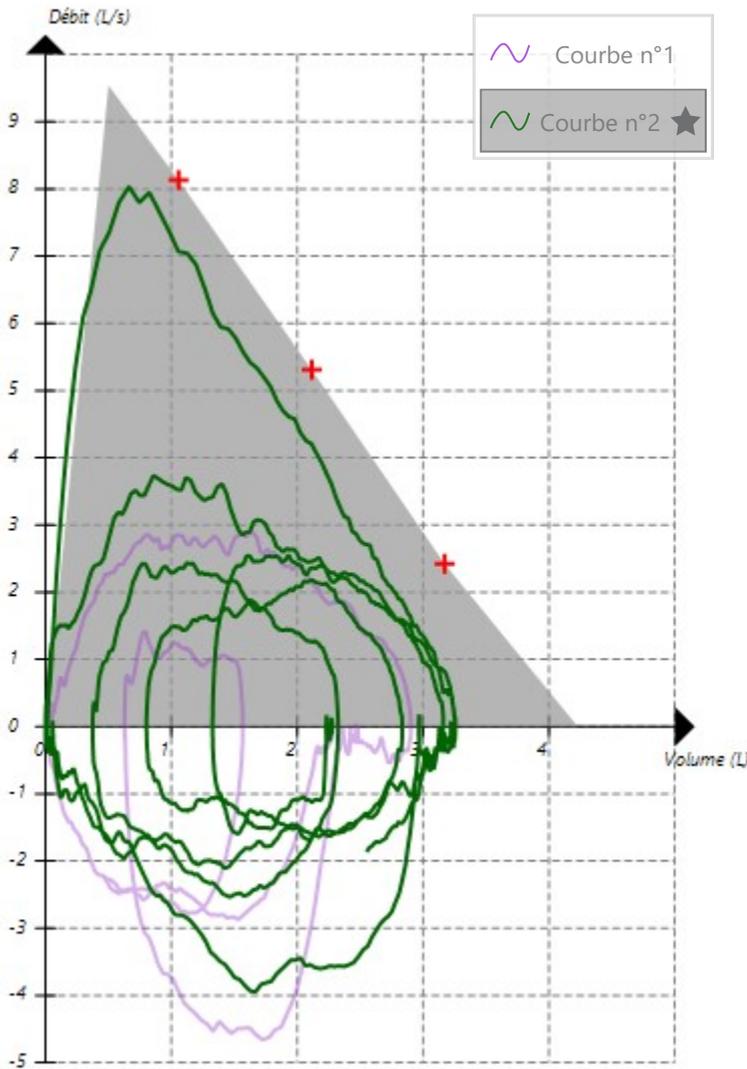

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,89 L	3,24 L	4,23 L	76,60 %
VEMS	2,55 L	3,22 L	3,58 L	89,94 %
DEP	2,91 L/s	8,16 L/s	9,54 L/s	85,53 %
VEMS/ CVF	88,24 %	99,38 %	82,02 %	121,17 %
Durée d'expiration	1,89 s	1,25 s	-	
DEMM	2,68 L/s	5,18 L/s	4,82 L/s	107,47 %
DEMM/ CVF	0,93 s-1	1,60 s-1	0,99 s-1	161,62 %
DE75	2,72 L/s	8,03 L/s	8,13 L/s	98,77 %
DE50	2,54 L/s	5,32 L/s	5,31 L/s	100,19 %
DE25	1,97 L/s	2,91 L/s	2,42 L/s	120,25 %