

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Nom BANGOURA                   | Adresse                          |
| Prénom MOHAMED                 | Exposition                       |
| Né le 03/01/1992               | Profession OPERATEUR CITERNE EAU |
| Age 32 Ans                     | Entreprise CHICO                 |
| Genre Masculin                 | Service                          |
| ID 10                          | Fumeur Non fumeur                |
| Taille 164 cm                  | Prescripteur:                    |
| Poids 59 kg                    | Smoking Pack Years : 0           |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal |                                  |
| Opérateur admin admin          |                                  |




MEDVIE  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
Numéro de série : 232803  
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 28,5 °C  
Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
Humidité : 43 %

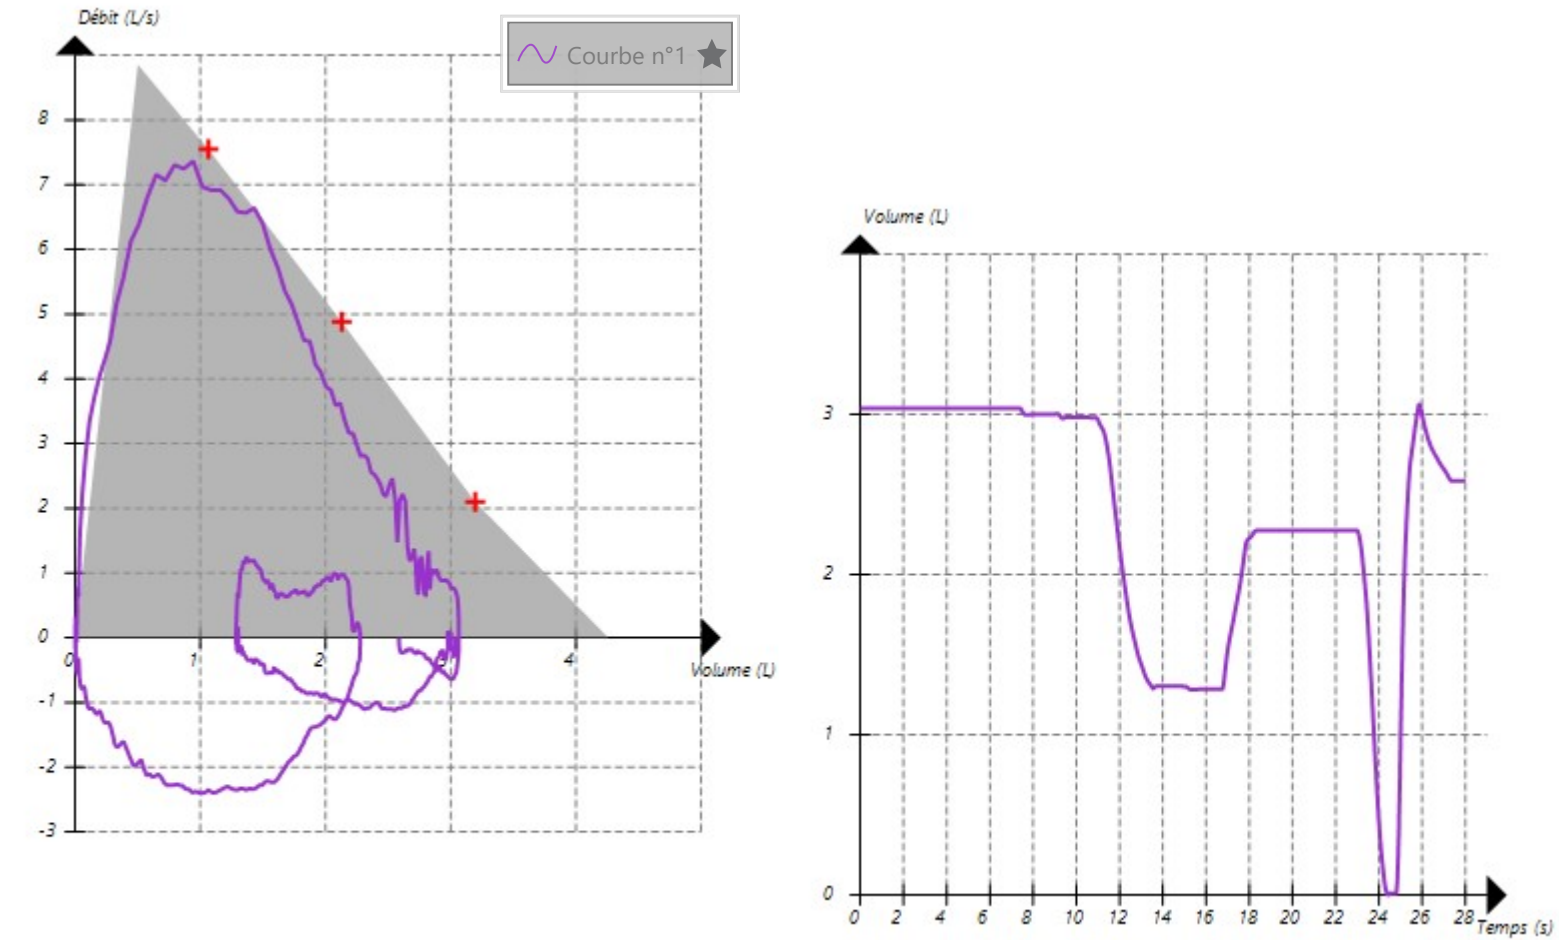

| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,05 L                  | 4,26 L   | 71,60 %   |
| VEMS               | 3,05 L                  | 3,63 L   | 84,02 %   |
| DEP                | 7,43 L/s                | 8,86 L/s | 83,86 %   |
| VEMS/ CVF          | 100,00 %                | 81,48 %  | 122,73 %  |
| Durée d'expiration | 1,10 s                  | -        |           |
| DEMM               | 5,25 L/s                | 4,51 L/s | 116,41 %  |
| DEMM/ CVF          | 1,72 s-1                | 1,06 s-1 | 162,26 %  |
| DE75               | 7,26 L/s                | 7,55 L/s | 96,16 %   |
| DE50               | 6,09 L/s                | 4,88 L/s | 124,80 %  |
| DE25               | 2,83 L/s                | 2,10 L/s | 134,76 %  |