



<b>Nom</b> BAH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 17/11/1999	<b>Profession</b> INTERPRETE
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 338	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 48 %

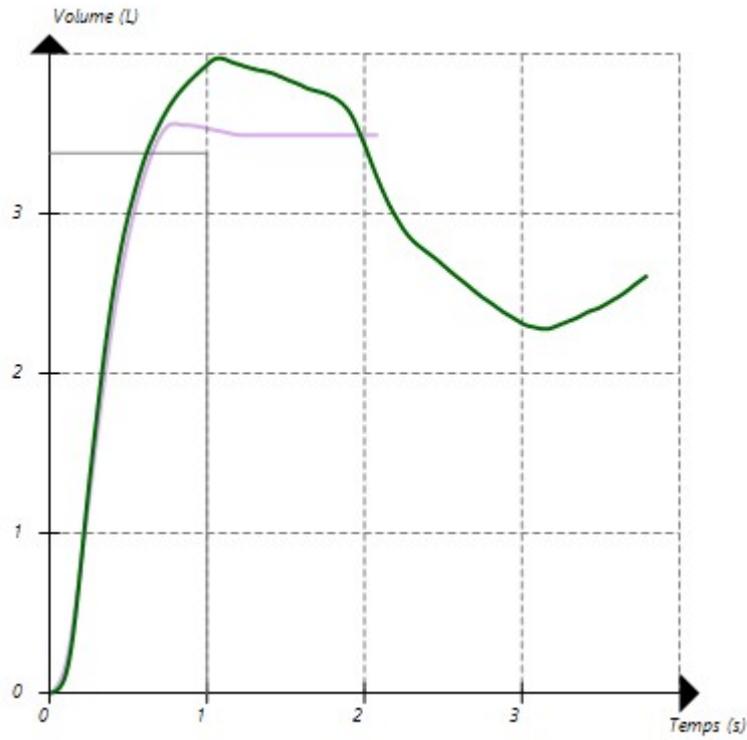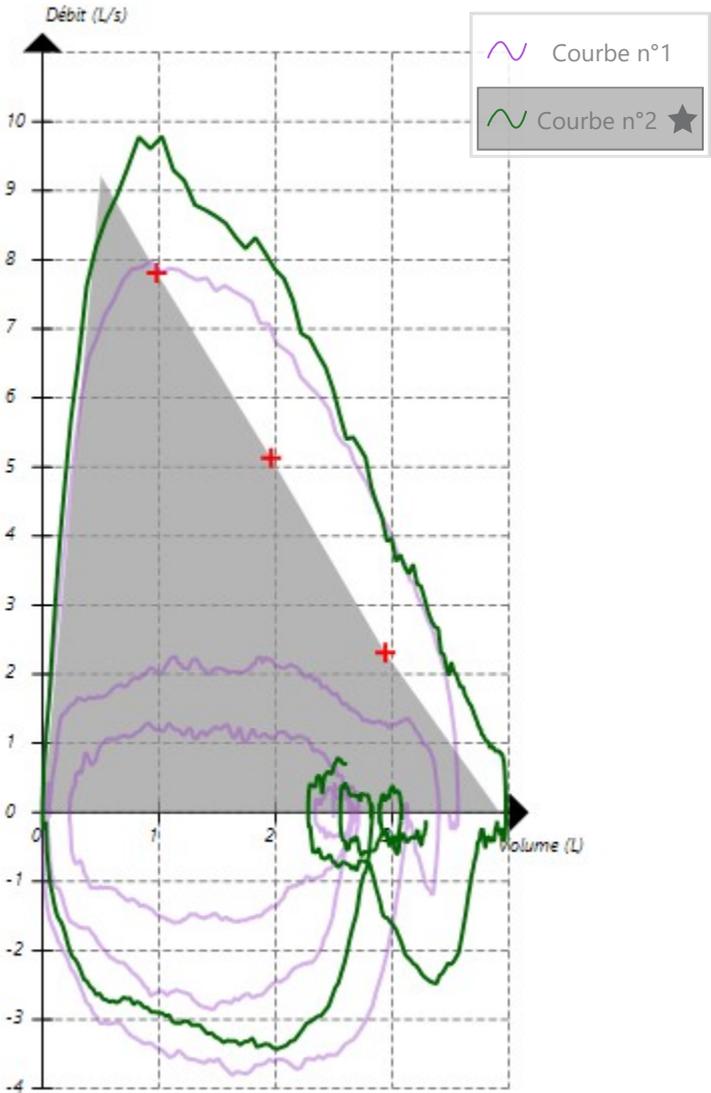

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,56 L	3,97 L	3,92 L	101,28 %
VEMS	3,56 L	3,97 L	3,38 L	117,46 %
DEP	8,05 L/s	10,02 L/s	9,22 L/s	108,68 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,78 s	1,09 s	-	
DEMM	7,01 L/s	7,10 L/s	4,83 L/s	147,00 %
DEMM/ CVF	1,97 s-1	1,79 s-1	1,07 s-1	167,29 %
DE75	7,87 L/s	10,00 L/s	7,81 L/s	128,04 %
DE50	7,41 L/s	7,87 L/s	5,13 L/s	153,41 %
DE25	5,08 L/s	4,00 L/s	2,31 L/s	173,16 %