

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MORY</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1997</b>	<b>Profession MECANICIEN</b>
<b>Age 27 Ans</b>	<b>Entreprise COVEC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 425</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 170 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 92 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 63 %

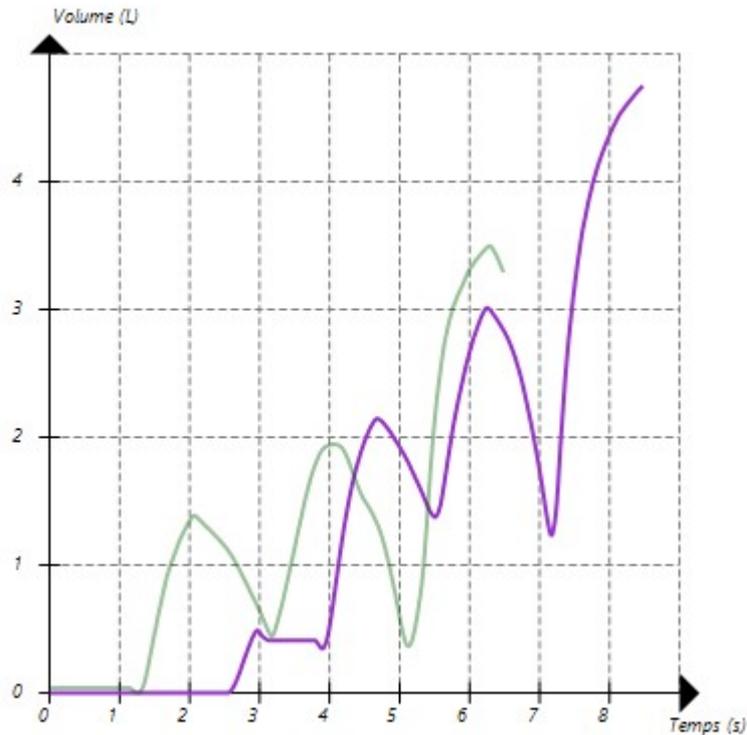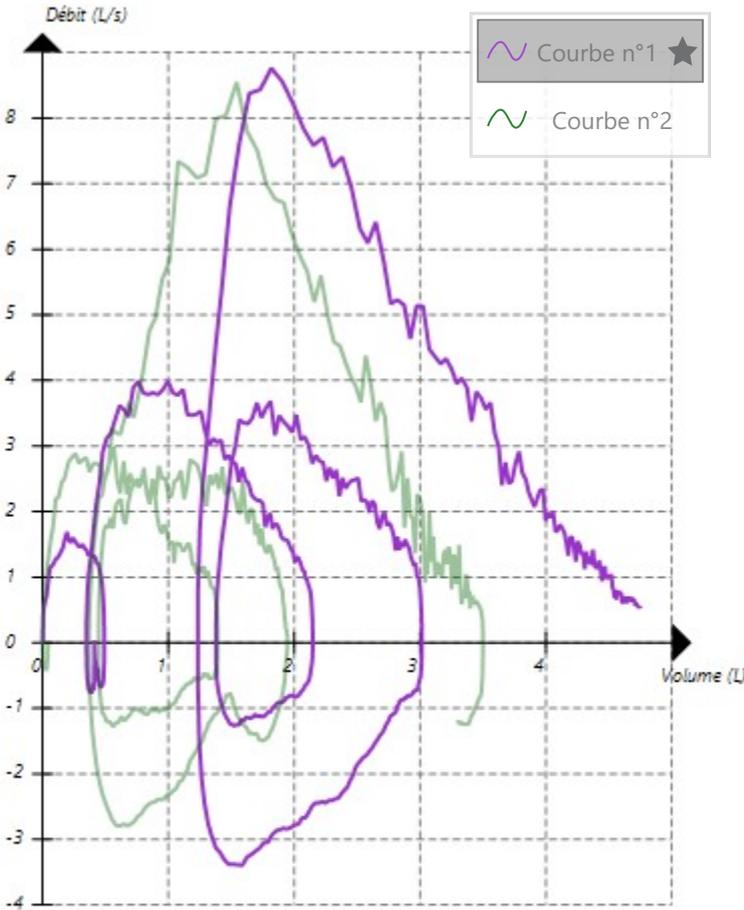

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,52 L	3,13 L	4,17 L	84,41 %
VEMS	3,35 L	3,13 L	3,53 L	94,90 %
DEP	8,93 L/s	8,83 L/s	9,02 L/s	99,00 %
VEMS/ CVF	95,17 %	100,00 %	84,30 %	112,89 %
Durée d'expiration	1,31 s	1,17 s	-	
DEMM	4,53 L/s	5,82 L/s	4,03 L/s	112,41 %
DEMM/ CVF	1,29 s-1	1,86 s-1	0,97 s-1	132,99 %
DE75	7,26 L/s	7,37 L/s	-	
DE50	5,04 L/s	6,61 L/s	-	
DE25	2,30 L/s	3,39 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: