



<b>Nom</b> DIAKITE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> VACE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1984	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 19	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 29,3 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,1 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 40 %

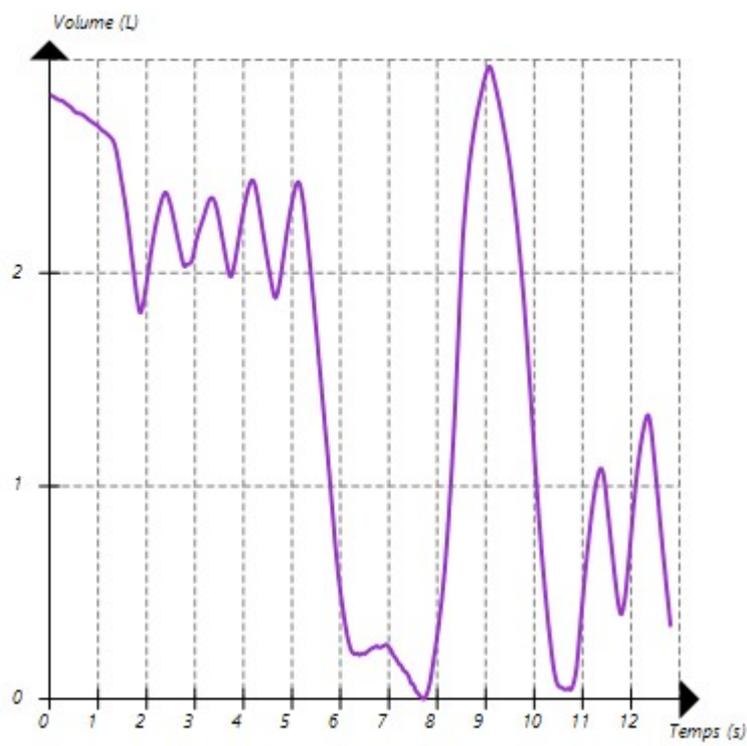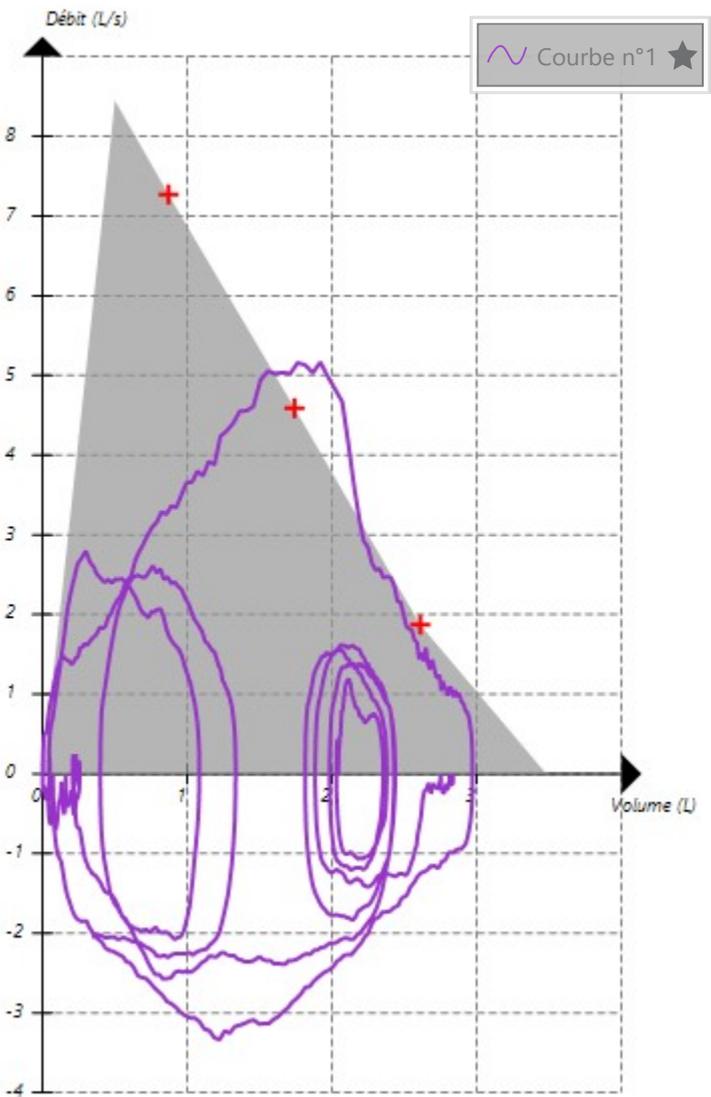

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,97 L	3,48 L	85,34 %
VEMS	2,97 L	2,92 L	101,71 %
DEP	5,41 L/s	8,45 L/s	64,02 %
VEMS/ CVF	100,00 %	80,05 %	124,92 %
Durée d'expiration	1,36 s	-	
DEMM	4,28 L/s	4,15 L/s	103,13 %
DEMM/ CVF	1,44 s-1	1,04 s-1	138,46 %
DE75	3,00 L/s	7,27 L/s	41,27 %
DE50	4,92 L/s	4,59 L/s	107,19 %
DE25	2,85 L/s	1,87 L/s	152,41 %