

<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ADAMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 04/05/1994	<b>Profession</b> OPERATEUR GRADEUR
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 422	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,8 °C


Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 63 %

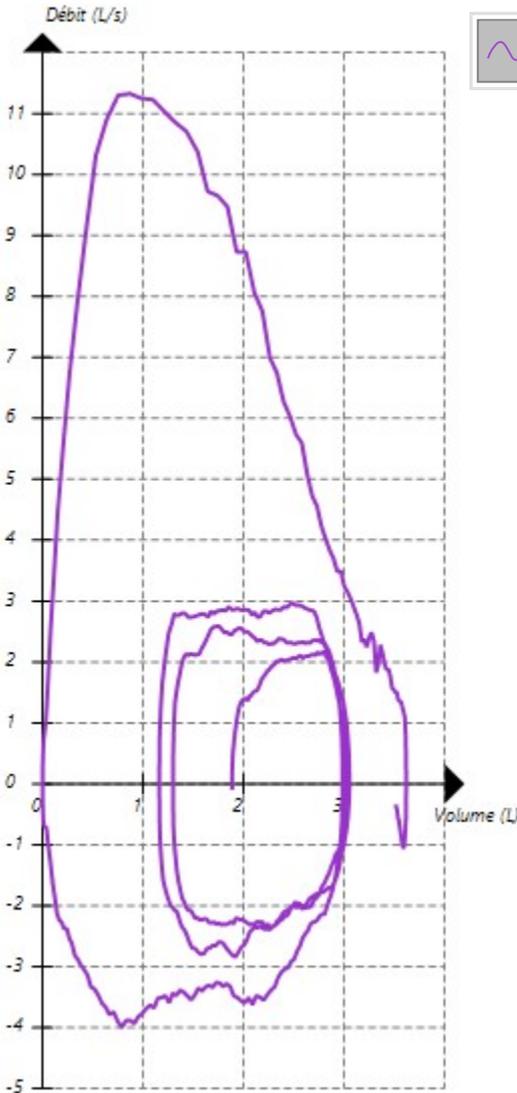

Courbe n°1 ★

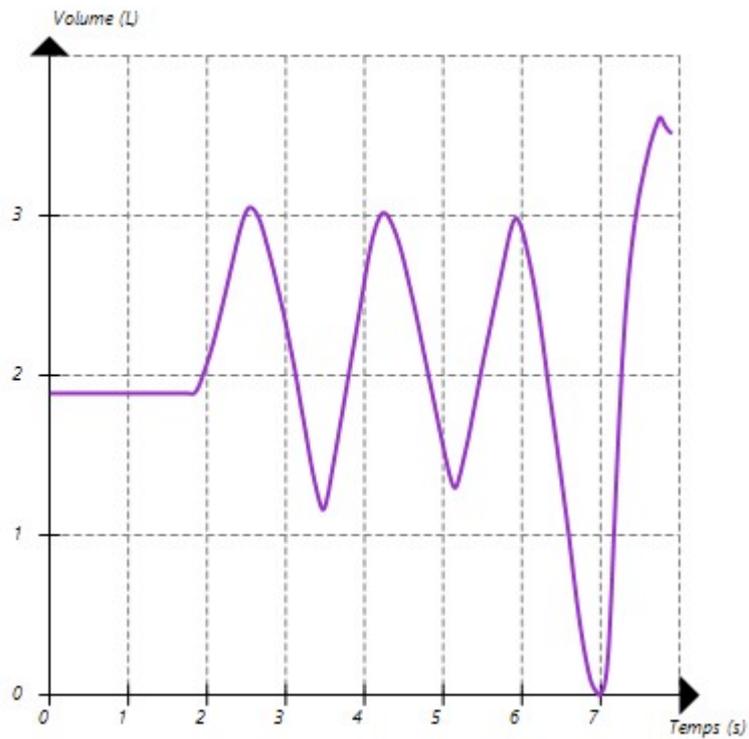

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,62 L	4,17 L	86,81 %
VEMS	3,62 L	3,51 L	103,13 %
DEP	11,59 L/s	8,99 L/s	128,92 %
VEMS/CVF	100,00 %	83,76 %	119,39 %
Durée d'expiration	0,78 s	-	
DEMM	8,45 L/s	3,94 L/s	214,47 %
DEMM/CVF	2,33 s-1	0,94 s-1	247,87 %
DE75	11,40 L/s	-	
DE50	9,61 L/s	-	
DE25	4,56 L/s	-	