

Nom KEITA	Adresse
Prénom SUALIHO	Exposition
Né le 02/06/1995	Profession OPERATEUR EXCAVATEUR
Age 28 Ans	Entreprise COVEC
Genre Masculin	Service
ID 225	Fumeur Non fumeur
Taille 170 cm	Prescripteur:
Poids 59 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	
Opérateur admin admin	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 44 %

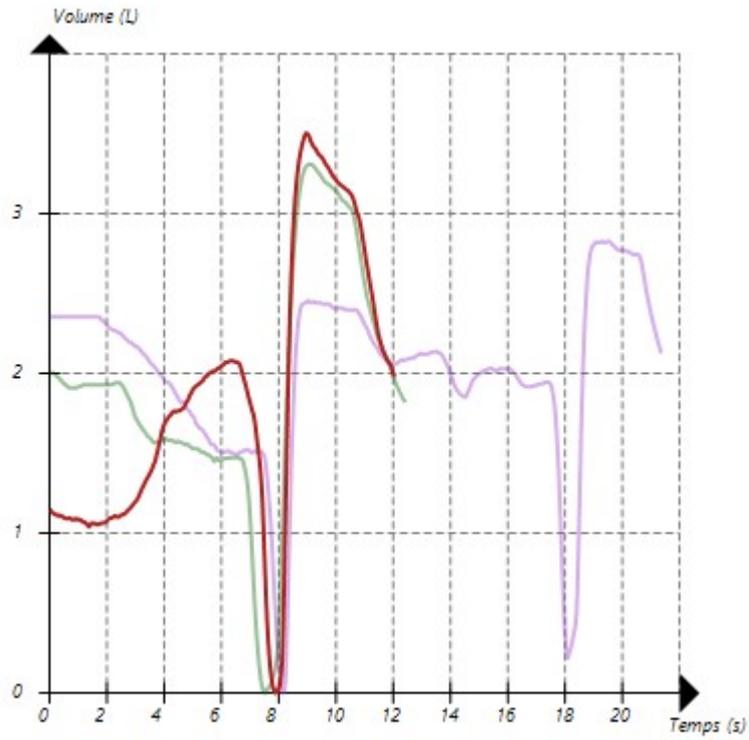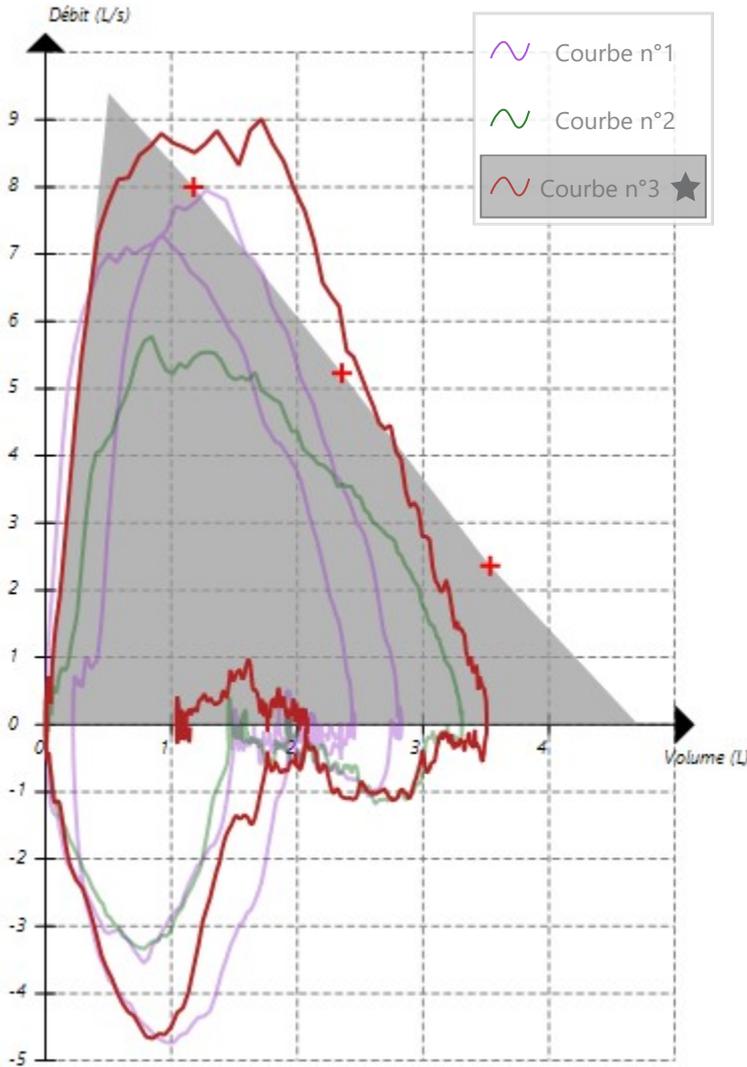

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,61 L	3,29 L	3,50 L	4,71 L	74,31 %
VEMS	2,61 L	3,27 L	3,50 L	4,01 L	87,28 %
DEP	8,09 L/s	5,85 L/s	9,24 L/s	9,40 L/s	98,30 %
VEMS/ CVF	100,00 %	99,39 %	100,00 %	82,20 %	121,65 %
Durée d'expiration	1,20 s	1,44 s	1,01 s	-	
DEMM	6,80 L/s	4,75 L/s	7,61 L/s	4,80 L/s	158,54 %
DEMM/ CVF	2,61 s-1	1,44 s-1	2,17 s-1	1,02 s-1	212,75 %
DE75	7,21 L/s	5,75 L/s	8,80 L/s	8,00 L/s	110,00 %
DE50	7,34 L/s	5,23 L/s	8,92 L/s	5,23 L/s	170,55 %
DE25	4,38 L/s	3,46 L/s	4,74 L/s	2,36 L/s	200,85 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: