

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1976	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 48 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 662	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,2 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 59 %

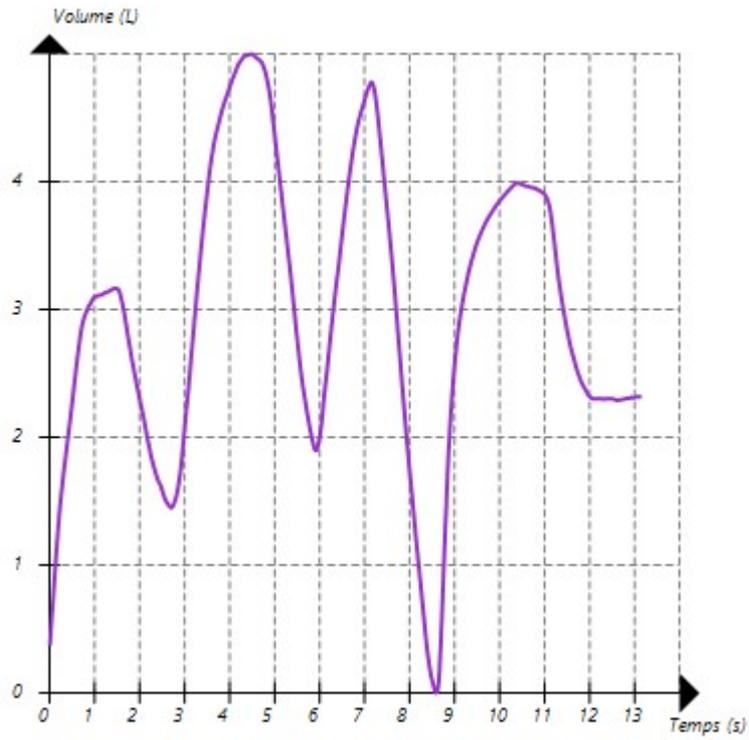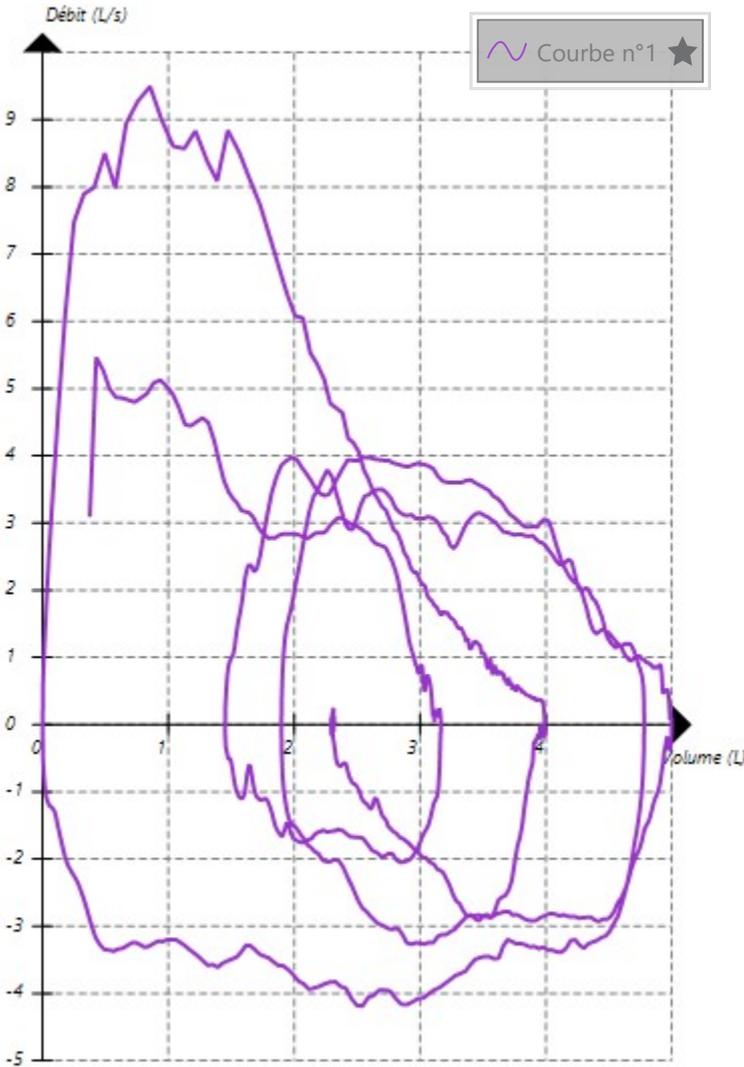

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,99 L	4,25 L	93,88 %
VEMS	3,65 L	3,41 L	107,04 %
DEP	9,73 L/s	8,93 L/s	108,96 %
VEMS/ CVF	91,48 %	80,46 %	113,70 %
Durée d'expiration	1,80 s	-	
DEMM	5,18 L/s	3,43 L/s	151,02 %
DEMM/ CVF	1,30 s-1	0,81 s-1	160,49 %
DE75	8,75 L/s	-	
DE50	6,12 L/s	-	
DE25	2,17 L/s	-	