



<b>Nom</b> CHERIF	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/08/1981	<b>Profession</b> MENUISIER
<b>Age</b> 42 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 184	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 186 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 78 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,3 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 36 %

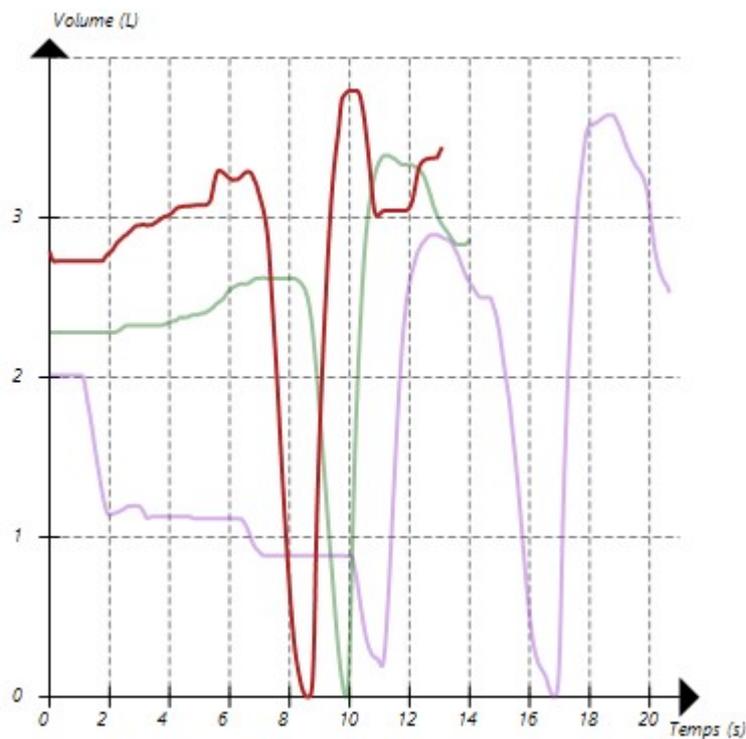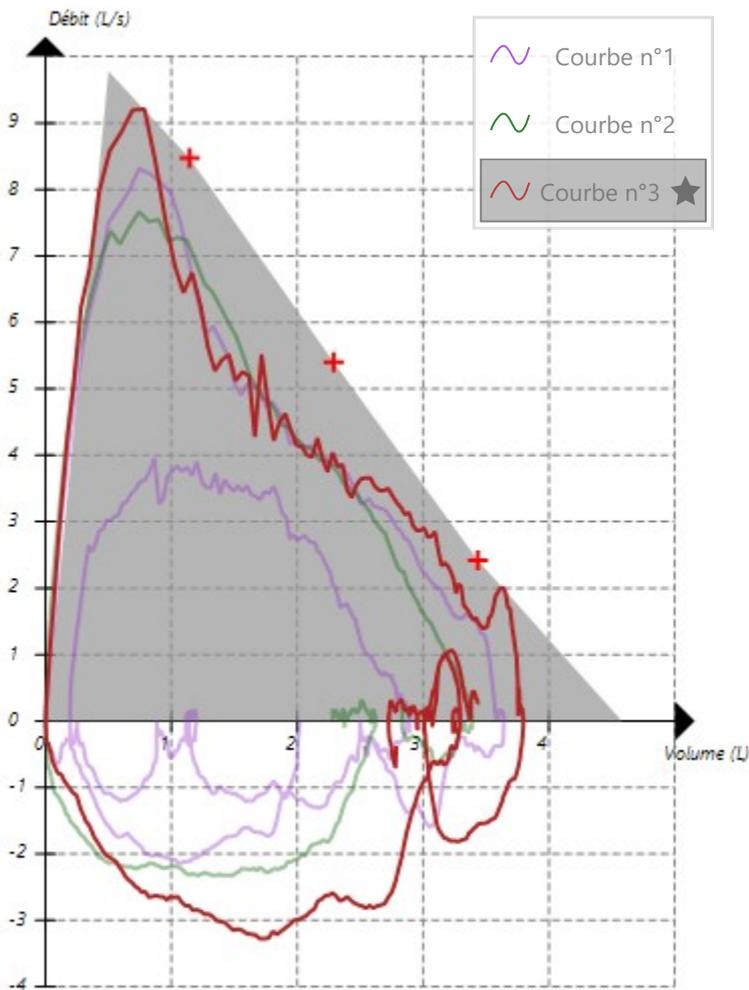

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,64 L	3,39 L	3,80 L	4,58 L	82,97 %
VEMS	3,57 L	3,34 L	3,76 L	3,73 L	100,80 %
DEP	8,48 L/s	7,81 L/s	9,39 L/s	9,78 L/s	96,01 %
VEMS/CVF	98,08 %	98,53 %	98,95 %	79,69 %	124,17 %
Durée d'expiration	1,79 s	1,33 s	1,56 s	-	
DEMM	4,67 L/s	5,03 L/s	4,54 L/s	4,51 L/s	100,67 %
DEMM/CVF	1,28 s-1	1,48 s-1	1,19 s-1	0,86 s-1	138,37 %
DE75	8,06 L/s	7,60 L/s	7,56 L/s	8,47 L/s	89,26 %
DE50	4,91 L/s	4,91 L/s	4,67 L/s	5,40 L/s	86,48 %
DE25	3,10 L/s	3,21 L/s	3,08 L/s	2,42 L/s	127,27 %