



<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORIBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 16/10/1989	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 20	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 88 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 40 %

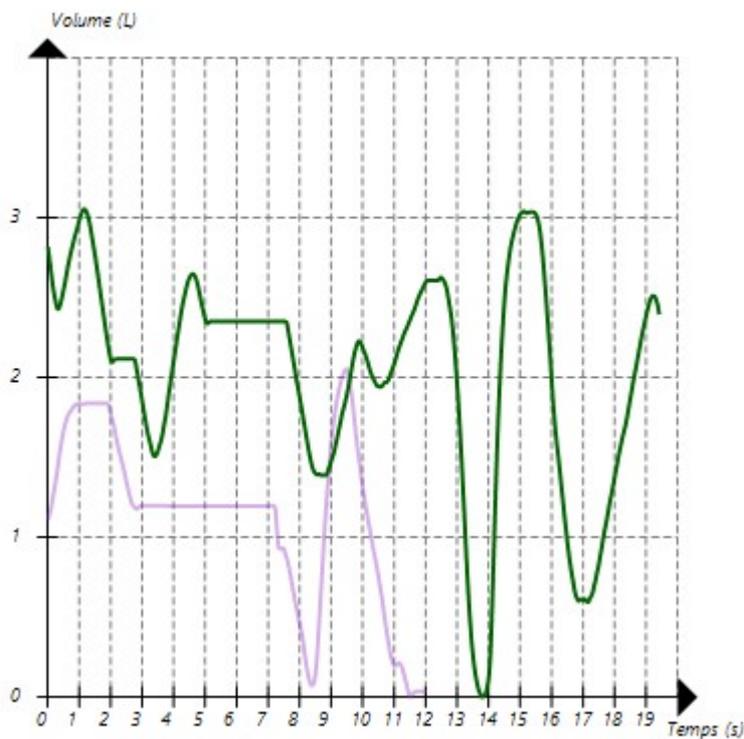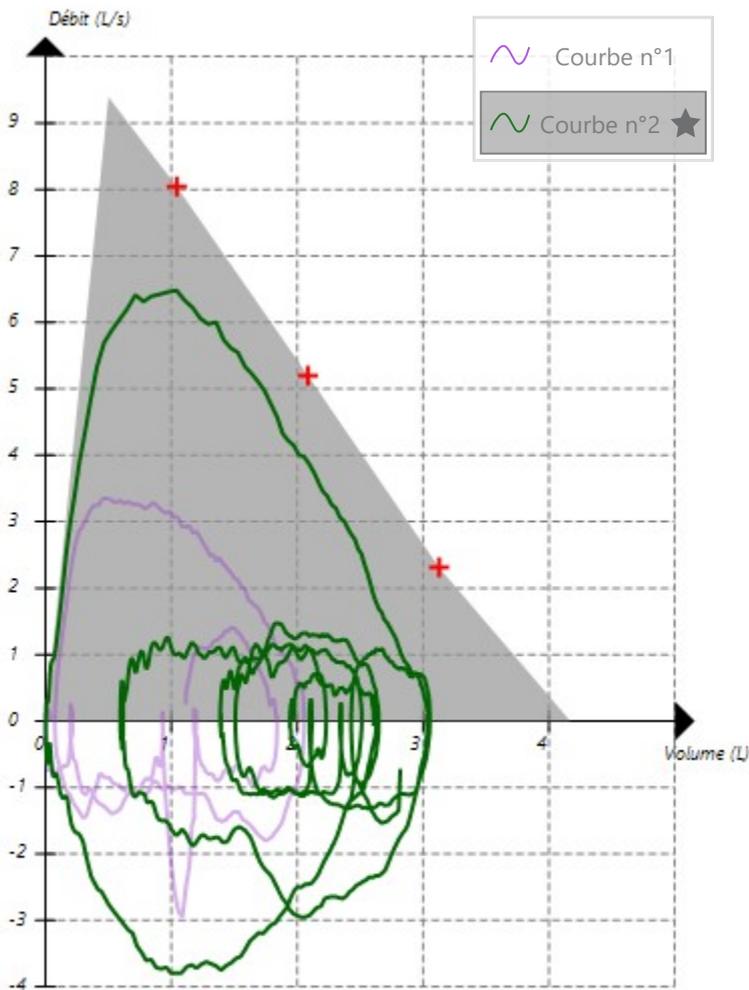

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,98 L	3,04 L	4,17 L	72,90 %
VEMS	1,98 L	3,03 L	3,49 L	86,82 %
DEP	3,44 L/s	6,52 L/s	9,39 L/s	69,44 %
VEMS/CVF	100,00 %	99,67 %	81,12 %	122,87 %
Durée d'expiration	1,09 s	1,34 s	-	
DEMM	2,89 L/s	5,15 L/s	4,62 L/s	111,47 %
DEMM/CVF	1,46 s-1	1,69 s-1	0,96 s-1	176,04 %
DE75	3,34 L/s	6,15 L/s	8,04 L/s	76,49 %
DE50	3,00 L/s	5,62 L/s	5,20 L/s	108,08 %
DE25	2,02 L/s	3,24 L/s	2,31 L/s	140,26 %