



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINE NAMEY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 20/01/1994	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> CHAUFFER
<b>ID</b> 734	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 29,1 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,5 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 65 %

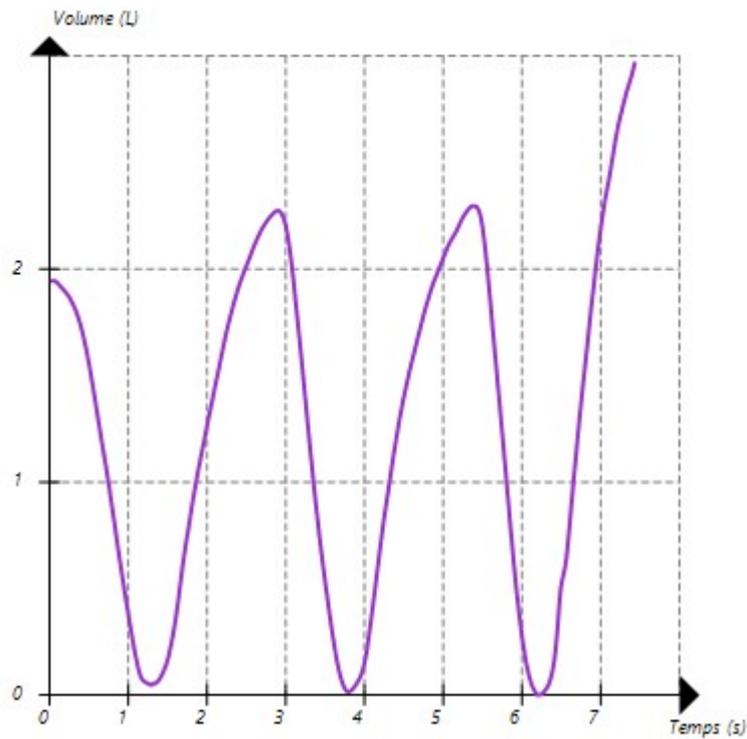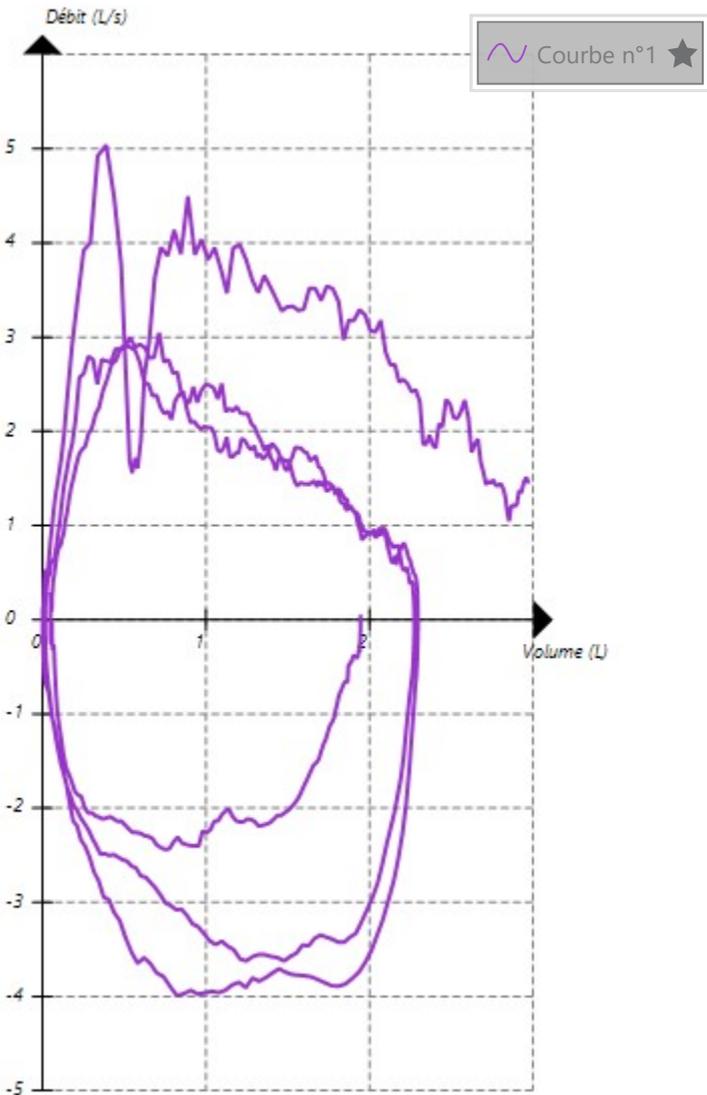

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,99 L	4,00 L	74,75 %
VEMS	2,88 L	3,37 L	85,46 %
DEP	5,59 L/s	8,72 L/s	64,11 %
VEMS/ CVF	96,32 %	83,76 %	115,00 %
Durée d'expiration	1,25 s	-	
DEMM	3,49 L/s	3,83 L/s	91,12 %
DEMM/ CVF	1,17 s-1	0,96 s-1	121,88 %
DE75	4,02 L/s	-	
DE50	3,40 L/s	-	
DE25	2,51 L/s	-	