



<b>Nom</b> BILLIVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ZOUMANA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 60	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 50 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 30 %

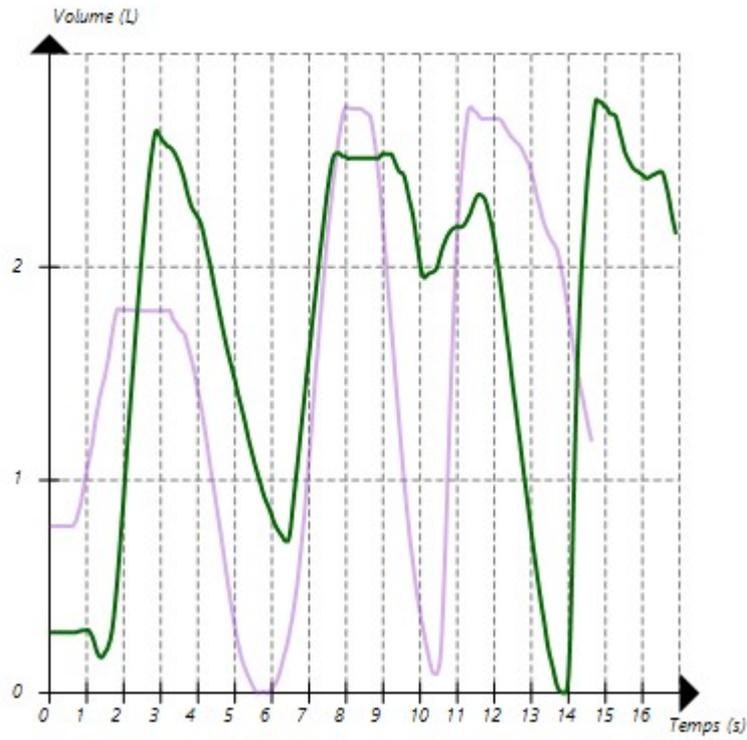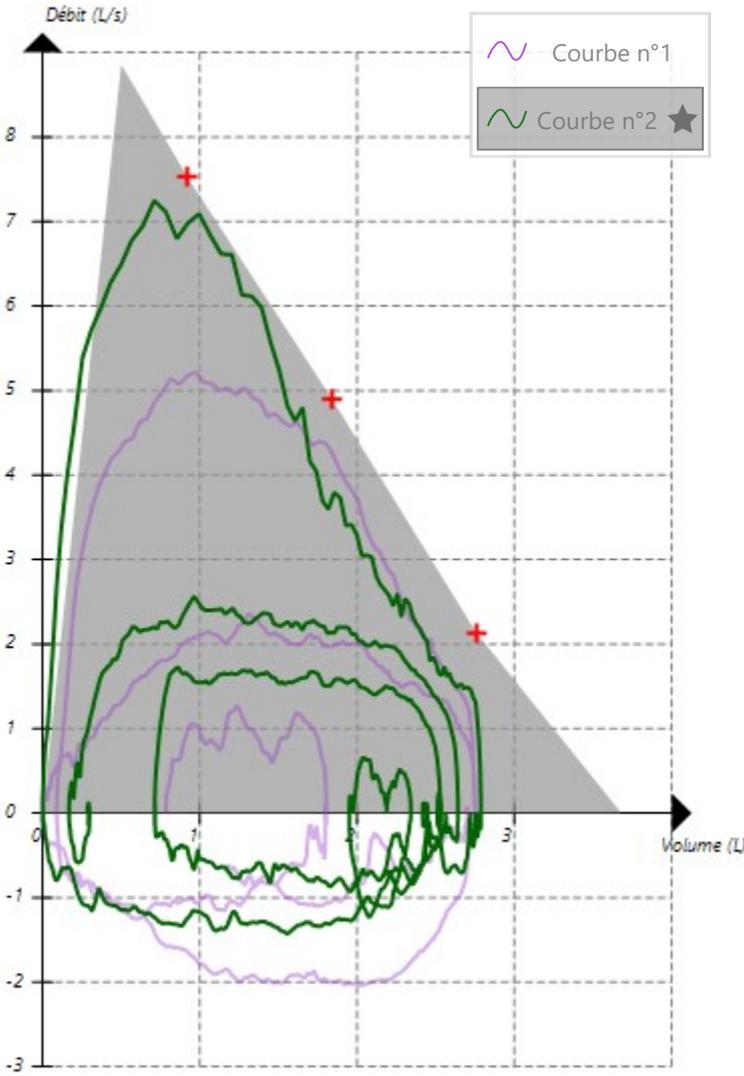

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,66 L	2,79 L	3,68 L	75,82 %
VEMS	2,66 L	2,79 L	3,16 L	88,29 %
DEP	5,26 L/s	7,32 L/s	8,86 L/s	82,62 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,02 %	121,92 %
Durée d'expiration	0,96 s	0,86 s	-	
DEMM	4,67 L/s	5,14 L/s	4,60 L/s	111,74 %
DEMM/ CVF	1,76 s-1	1,84 s-1	1,09 s-1	168,81 %
DE75	5,00 L/s	7,24 L/s	7,53 L/s	96,15 %
DE50	4,73 L/s	6,12 L/s	4,90 L/s	124,90 %
DE25	3,20 L/s	3,17 L/s	2,13 L/s	148,83 %