



<b>Nom</b> SANGARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/07/1994	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 210	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 55 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	

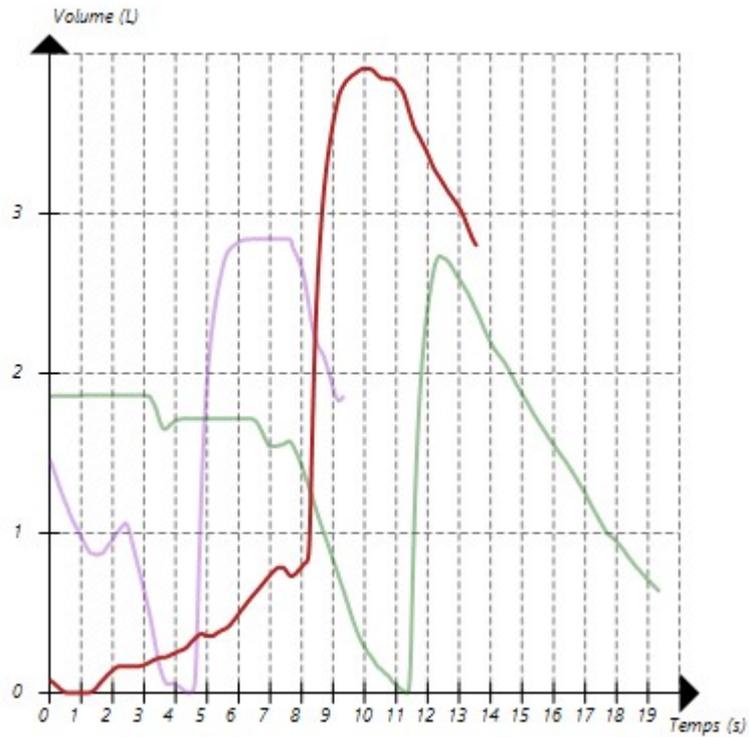

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,7 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 42 %

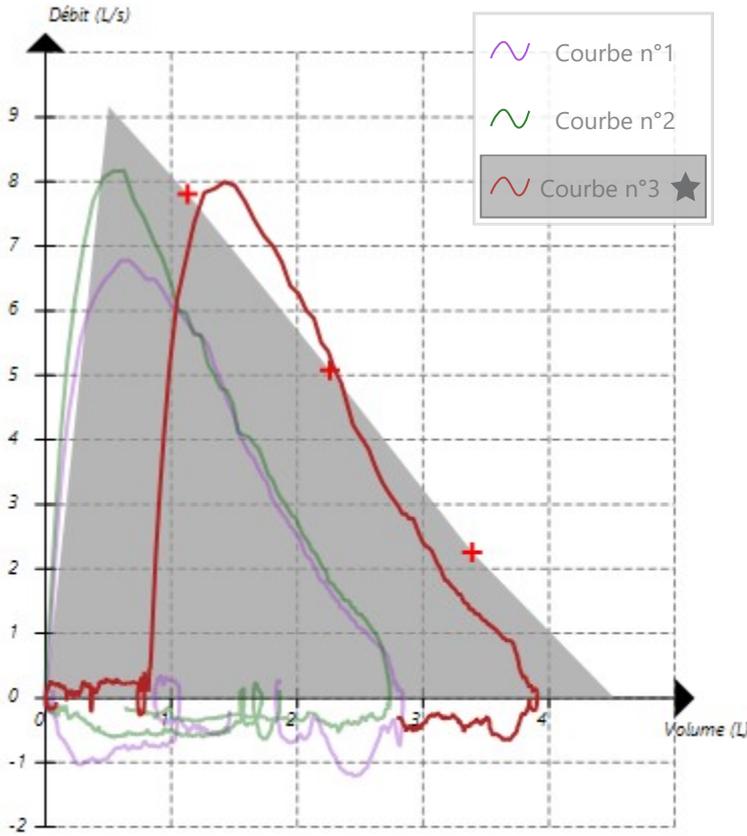

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,84 L	2,73 L	3,18 L	4,52 L	70,35 %
VEMS	2,75 L	2,73 L	3,03 L	3,85 L	78,70 %
DEP	6,82 L/s	8,32 L/s	8,14 L/s	9,17 L/s	88,77 %
VEMS/ CVF	96,83 %	100,00 %	95,28 %	82,02 %	116,17 %
Durée d'expiration	2,00 s	1,03 s	2,27 s	-	
DEMM	4,13 L/s	4,62 L/s	4,33 L/s	4,70 L/s	92,13 %
DEMM/ CVF	1,45 s-1	1,69 s-1	1,36 s-1	1,04 s-1	130,77 %
DE75	6,72 L/s	7,83 L/s	7,77 L/s	7,81 L/s	99,49 %
DE50	4,73 L/s	4,72 L/s	4,93 L/s	5,08 L/s	97,05 %
DE25	2,06 L/s	2,51 L/s	2,09 L/s	2,26 L/s	92,48 %