



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DJIBRIL	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> Maçon
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 288	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 106 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 10
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 57 %

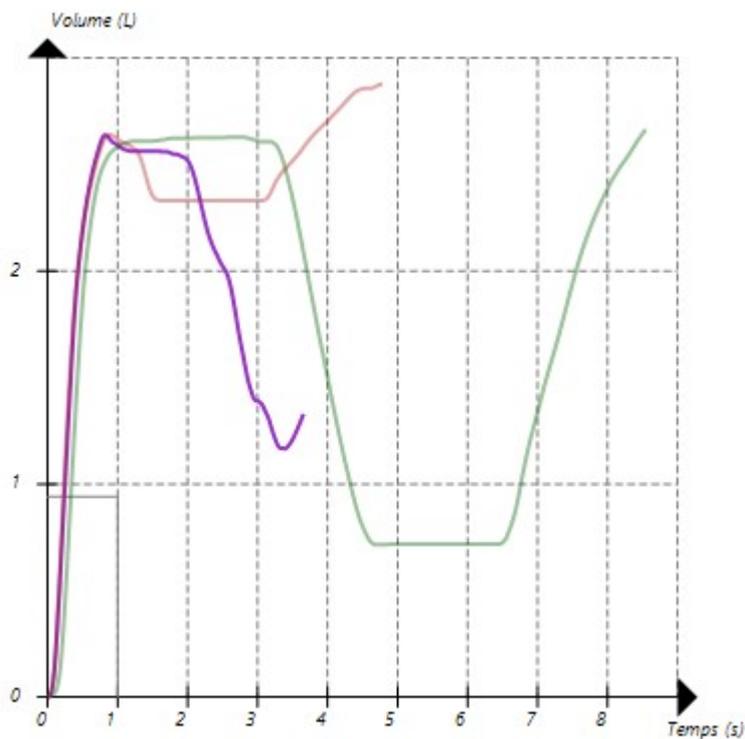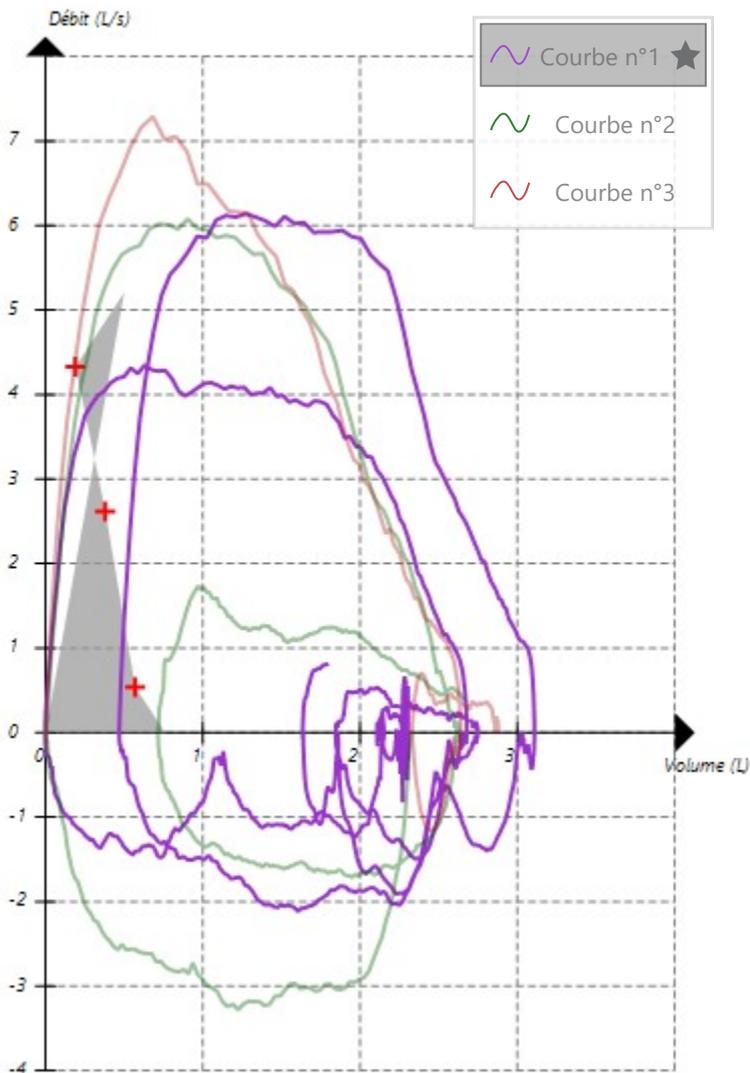

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,64 L	2,63 L	2,64 L	0,76 L	347,37 %
VEMS	2,64 L	2,61 L	2,64 L	0,94 L	280,85 %
DEP	6,25 L/s	6,14 L/s	7,36 L/s	5,21 L/s	119,96 %
VEMS/ CVF	100,00 %	99,24 %	100,00 %	81,12 %	123,27 %
Durée d'expiration	0,84 s	2,55 s	0,90 s	-	
DEMM	5,64 L/s	5,43 L/s	5,52 L/s	3,30 L/s	170,91 %
DEMM/ CVF	2,14 s-1	2,06 s-1	2,09 s-1	3,79 s-1	56,46 %
DE75	6,20 L/s	6,02 L/s	7,25 L/s	4,33 L/s	143,19 %
DE50	5,97 L/s	5,60 L/s	5,85 L/s	2,62 L/s	227,86 %
DE25	3,37 L/s	3,45 L/s	3,22 L/s	0,54 L/s	624,07 %