



<b>Nom</b> CHERIF <b>Prénom</b> MOUSSA <b>Né le</b> 24/06/1990 <b>Age</b> 34 Ans <b>Genre</b> Masculin <b>ID</b> 424 <b>Taille</b> 171 cm <b>Poids</b> 60 kg <b>Valeurs prédites</b> NHANES III <b>Opérateur</b> admin admin	<b>Adresse</b> <b>Exposition</b> <b>Profession</b> MECANICIEN <b>Entreprise</b> COVEC <b>Service</b> <b>Fumeur</b> Non fumeur <b>Groupe ethnique</b> Origine africaine <b>Prescripteur:</b> <b>Smoking Pack Years</b> : 0
---	---



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 63 %

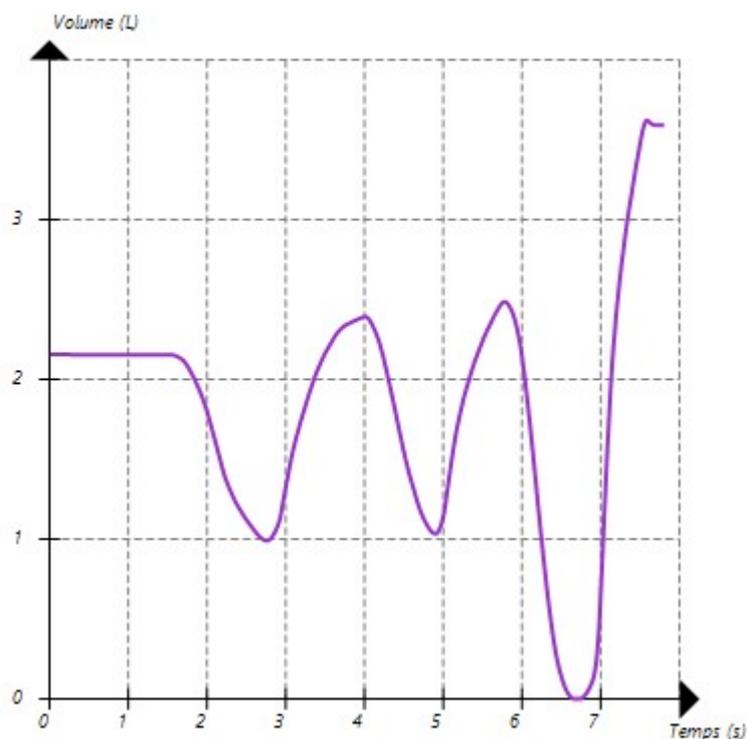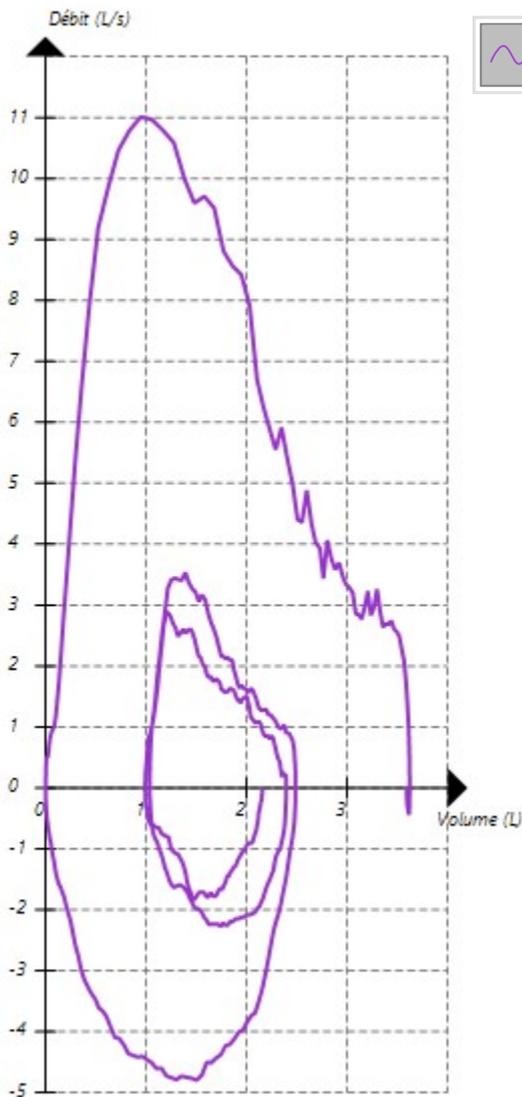

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,62 L	4,10 L	88,29 %
VEMS	3,62 L	3,41 L	106,16 %
DEP	11,15 L/s	8,83 L/s	126,27 %
VEMS/ CVF	100,00 %	83,02 %	120,45 %
Durée d'expiration	0,84 s	-	
DEMM	7,55 L/s	3,77 L/s	200,27 %
DEMM/ CVF	2,09 s-1	0,92 s-1	227,17 %
DE75	10,95 L/s	-	
DE50	8,79 L/s	-	
DE25	4,45 L/s	-	