

<b>Nom</b> KOMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KEMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 08/01/1977	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 47 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 42	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 185 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 78 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 39 %

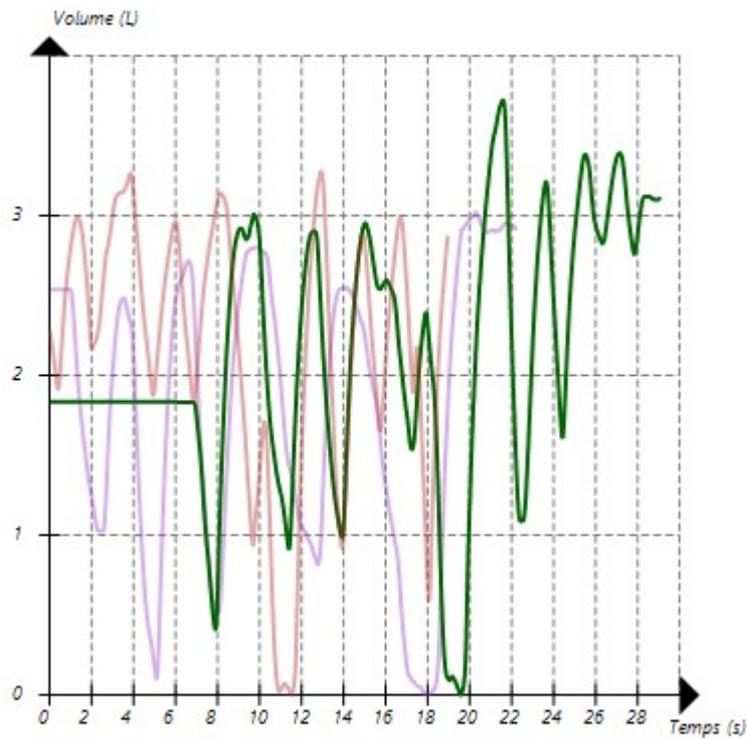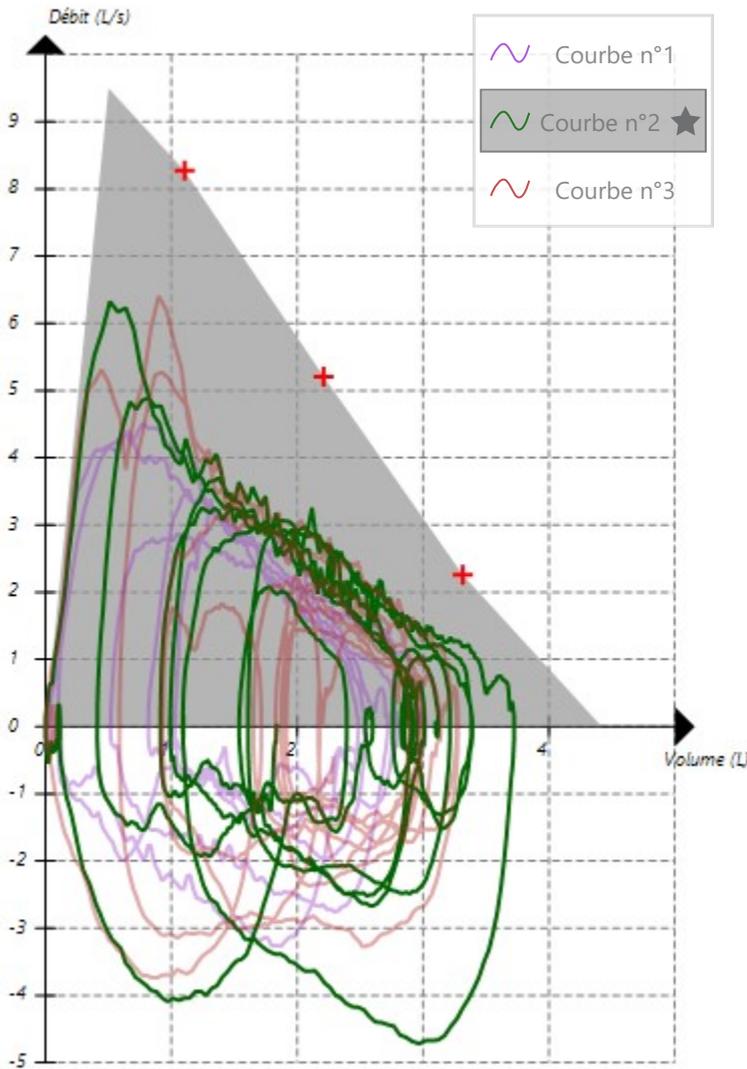

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,02 L	3,72 L	3,28 L	4,42 L	84,16 %
VEMS	2,77 L	3,06 L	3,12 L	3,57 L	85,71 %
DEP	4,65 L/s	6,42 L/s	6,66 L/s	9,50 L/s	67,58 %
VEMS/ CVF	91,72 %	82,26 %	95,12 %	78,80 %	104,39 %
Durée d'expiration	2,27 s	2,02 s	1,43 s	-	
DEMM	2,98 L/s	2,83 L/s	3,46 L/s	4,27 L/s	66,28 %
DEMM/ CVF	0,99 s-1	0,76 s-1	1,05 s-1	0,84 s-1	90,48 %
DE75	4,56 L/s	3,98 L/s	5,90 L/s	8,27 L/s	48,13 %
DE50	2,80 L/s	2,83 L/s	3,07 L/s	5,21 L/s	54,32 %
DE25	1,86 L/s	1,75 L/s	2,34 L/s	2,26 L/s	77,43 %