

<b>Nom</b> ZHANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> WEIHUA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/07/1979	<b>Profession</b> DIRECTEUR GENERAL DE LA CON...
<b>Age</b> 45 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 390	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 161 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 25,9 °C  
 Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Humidité : 59 %

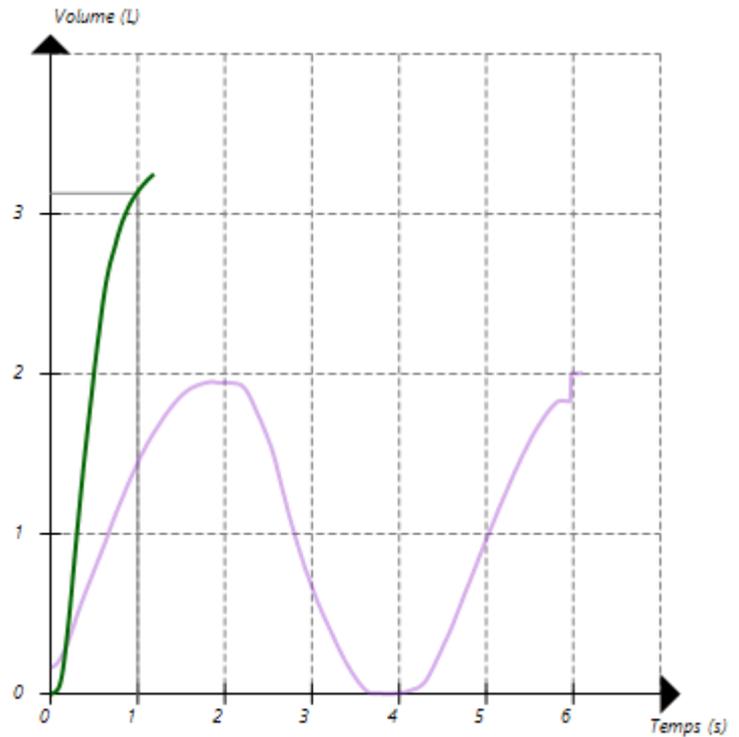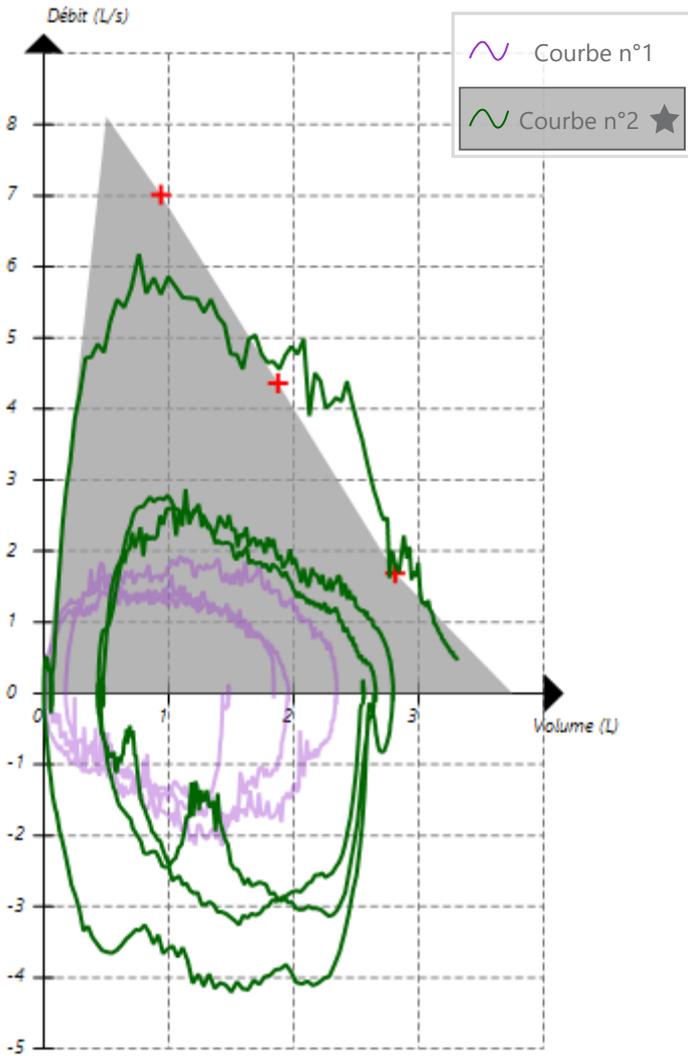

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,78 L	3,25 L	3,75 L	86,67 %
VEMS	1,39 L	3,22 L	3,13 L	102,88 %
DÉP	2,18 L/s	6,50 L/s	8,11 L/s	80,15 %
VEMS/CVF	78,09 %	99,08 %	79,16 %	125,16 %
Durée d'expiration	1,93 s	1,20 s	-	
DEMM	1,33 L/s	4,94 L/s	3,89 L/s	126,99 %
DEMM/CVF	0,75 s-1	1,52 s-1	1,04 s-1	146,15 %
DE75	1,69 L/s	5,76 L/s	7,01 L/s	82,17 %
DE50	1,45 L/s	5,18 L/s	4,36 L/s	118,81 %
DE25	1,03 L/s	3,93 L/s	1,69 L/s	232,54 %