



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1966	<b>Profession</b> OPERATEUR PICK UP
<b>Age</b> 58 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 479	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 182 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 59 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 59 %

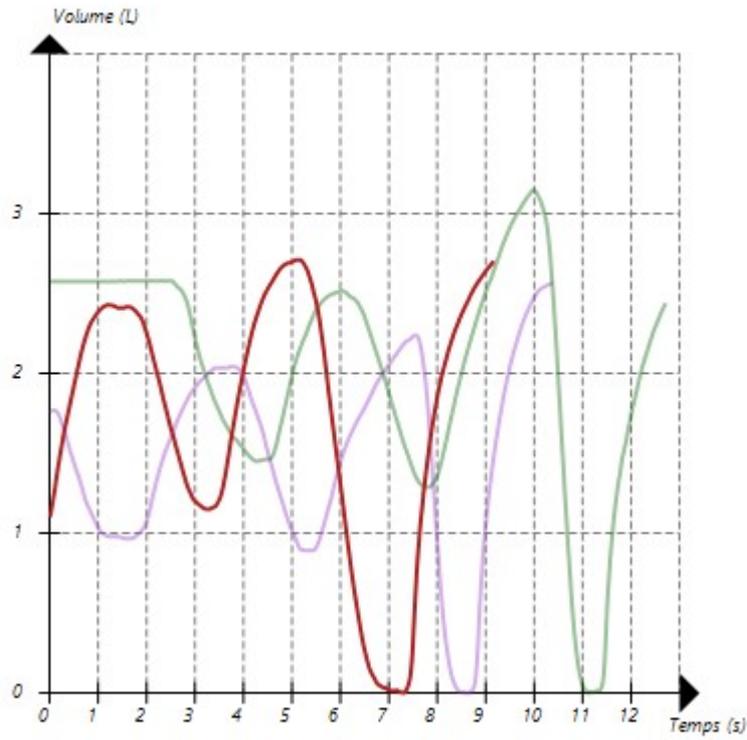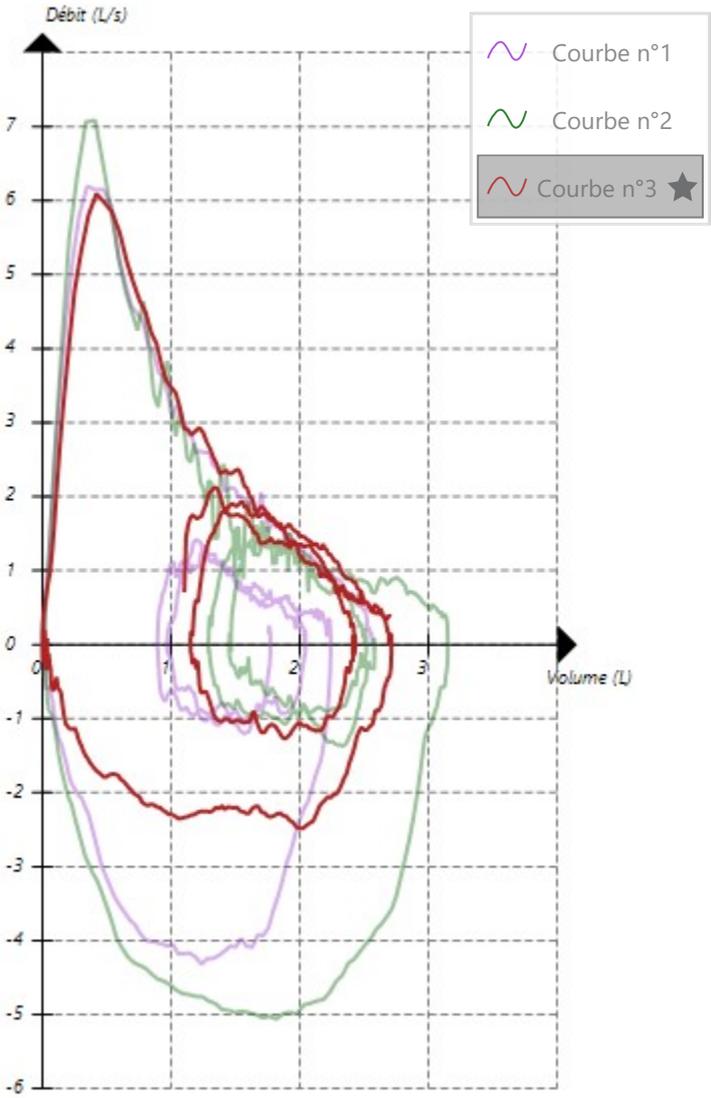

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,56 L	2,44 L	2,71 L	4,30 L	63,02 %
VEMS	2,33 L	2,21 L	2,33 L	3,37 L	69,14 %
DEP	6,24 L/s	7,26 L/s	6,14 L/s	8,91 L/s	68,91 %
VEMS/ CVF	91,02 %	90,57 %	85,98 %	78,64 %	109,33 %
Durée d'expiration	1,75 s	1,39 s	1,86 s	-	
DEMM	2,48 L/s	2,19 L/s	2,38 L/s	3,15 L/s	75,56 %
DEMM/ CVF	0,97 s-1	0,90 s-1	0,88 s-1	0,73 s-1	120,55 %
DE75	4,81 L/s	4,91 L/s	5,02 L/s	-	
DE50	2,65 L/s	2,48 L/s	2,49 L/s	-	
DE25	1,42 L/s	1,51 L/s	1,10 L/s	-	