

<b>Nom</b> KANTE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSTAPHA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1986	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 587	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 158 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,8 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 59 %

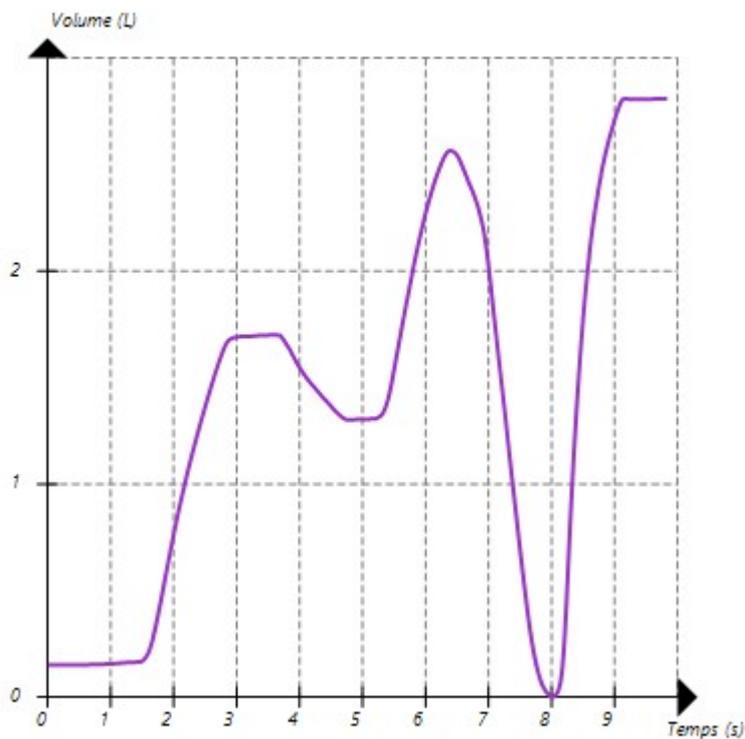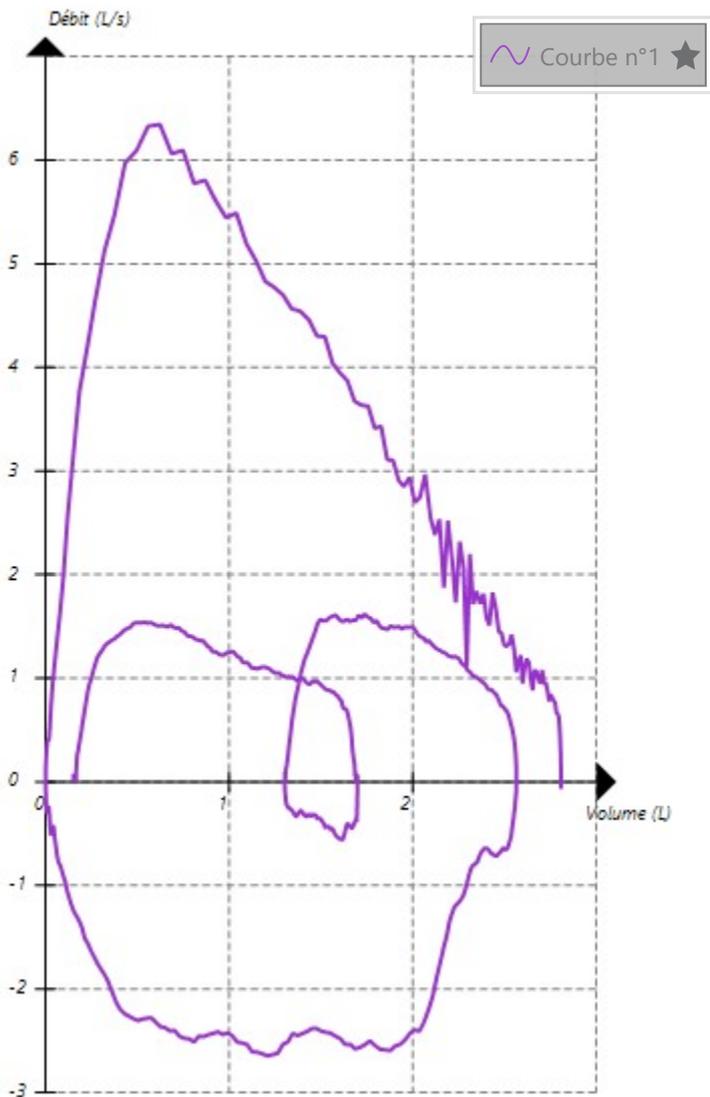

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,81 L	3,31 L	84,89 %
VEMS	2,81 L	2,76 L	101,81 %
DEP	6,43 L/s	7,50 L/s	85,73 %
VEMS/CVF	100,00 %	82,29 %	121,52 %
Durée d'expiration	1,14 s	-	
DEMM	4,24 L/s	3,15 L/s	134,60 %
DEMM/CVF	1,51 s-1	0,95 s-1	158,95 %
DE75	6,13 L/s	-	
DE50	4,32 L/s	-	
DE25	2,30 L/s	-	