



<b>Nom</b> DOPAVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> WOLOBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1982	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 42 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 162	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 36 %

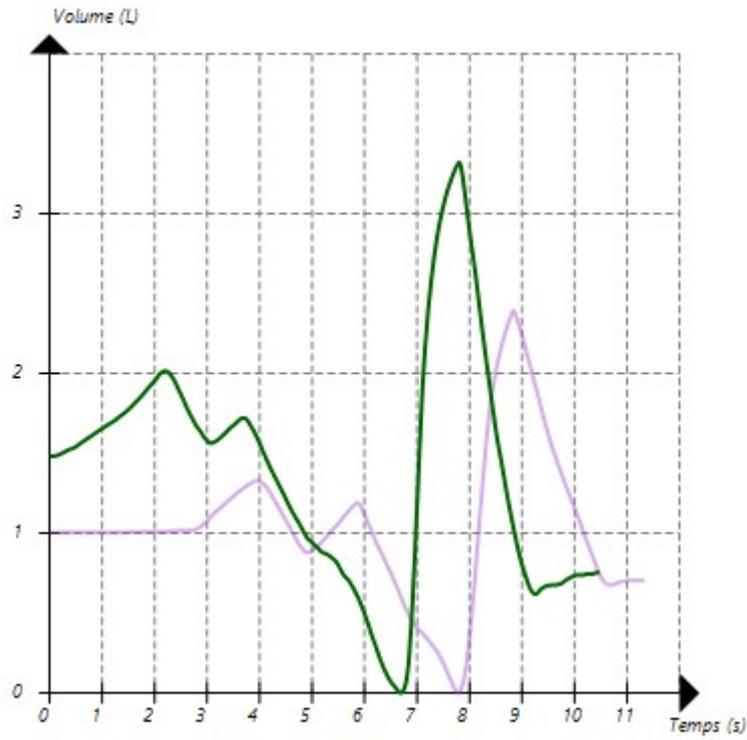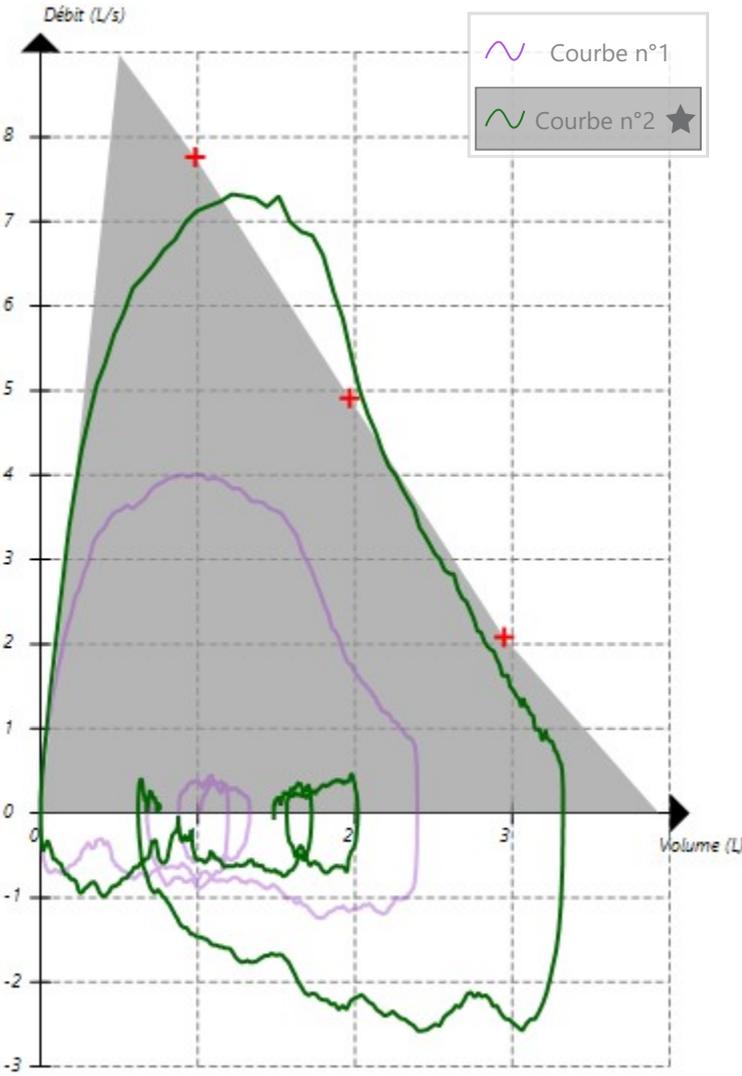

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,40 L	3,32 L	3,93 L	84,48 %
VEMS	2,40 L	3,32 L	3,25 L	102,15 %
DEP	4,04 L/s	7,43 L/s	8,98 L/s	82,74 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	79,69 %	125,49 %
Durée d'expiration	1,06 s	1,12 s	-	
DEMM	3,71 L/s	5,77 L/s	4,26 L/s	135,45 %
DEMM/CVF	1,55 s-1	1,74 s-1	0,94 s-1	185,11 %
DE75	3,63 L/s	6,89 L/s	7,76 L/s	88,79 %
DE50	3,91 L/s	6,92 L/s	4,91 L/s	140,94 %
DE25	2,46 L/s	3,08 L/s	2,08 L/s	148,08 %